

ПОСТАВИТЬ НА БОРТ АНАЛИЗАТОРА ПРОМЫВОЧНЫЙ И ЧИСТЯЩИЙ РАСТВОРЫ




ВКЛЮЧЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ РАБОТЫ ПРИБОРА

- НАЖАТЬ НА ТУМБЛЕР РАСПОЛОЖЕННЫЙ СЗАДИ АНАЛИЗАТОРА



- ЧЕРЕЗ 3-5 МИНУТ НА ДИСПЛЕЕ ПРИБОРА ПОЯВИТЬСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ОКНО


- НАЖАТЬ НА КНОПКУ ОК

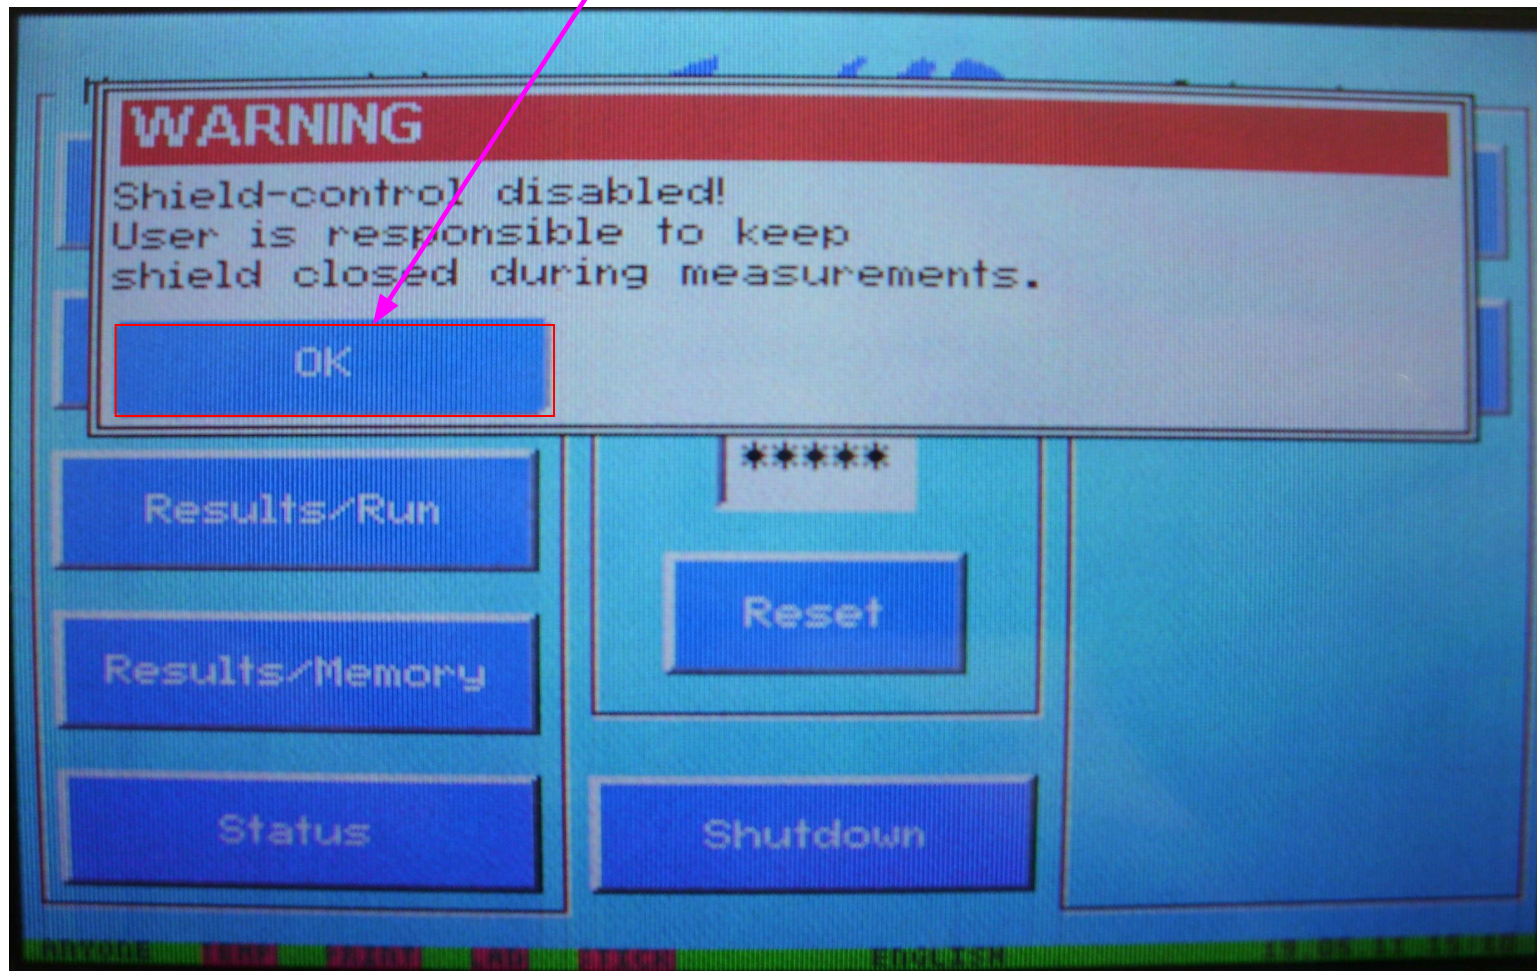

**В ТЕЧЕНИЕ 30 СЕКУНД НА ДИСПЛЕЕ ПРИБОРА
ПОЯВИТЬСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ОКНО**




**ЗАТЕМ, АВТОМАТИЧЕСКИ НА ДИСПЛЕЕ ПРИБОРА ПОЯВИТЬСЯ ОКНО
С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЮВЕТАХ**

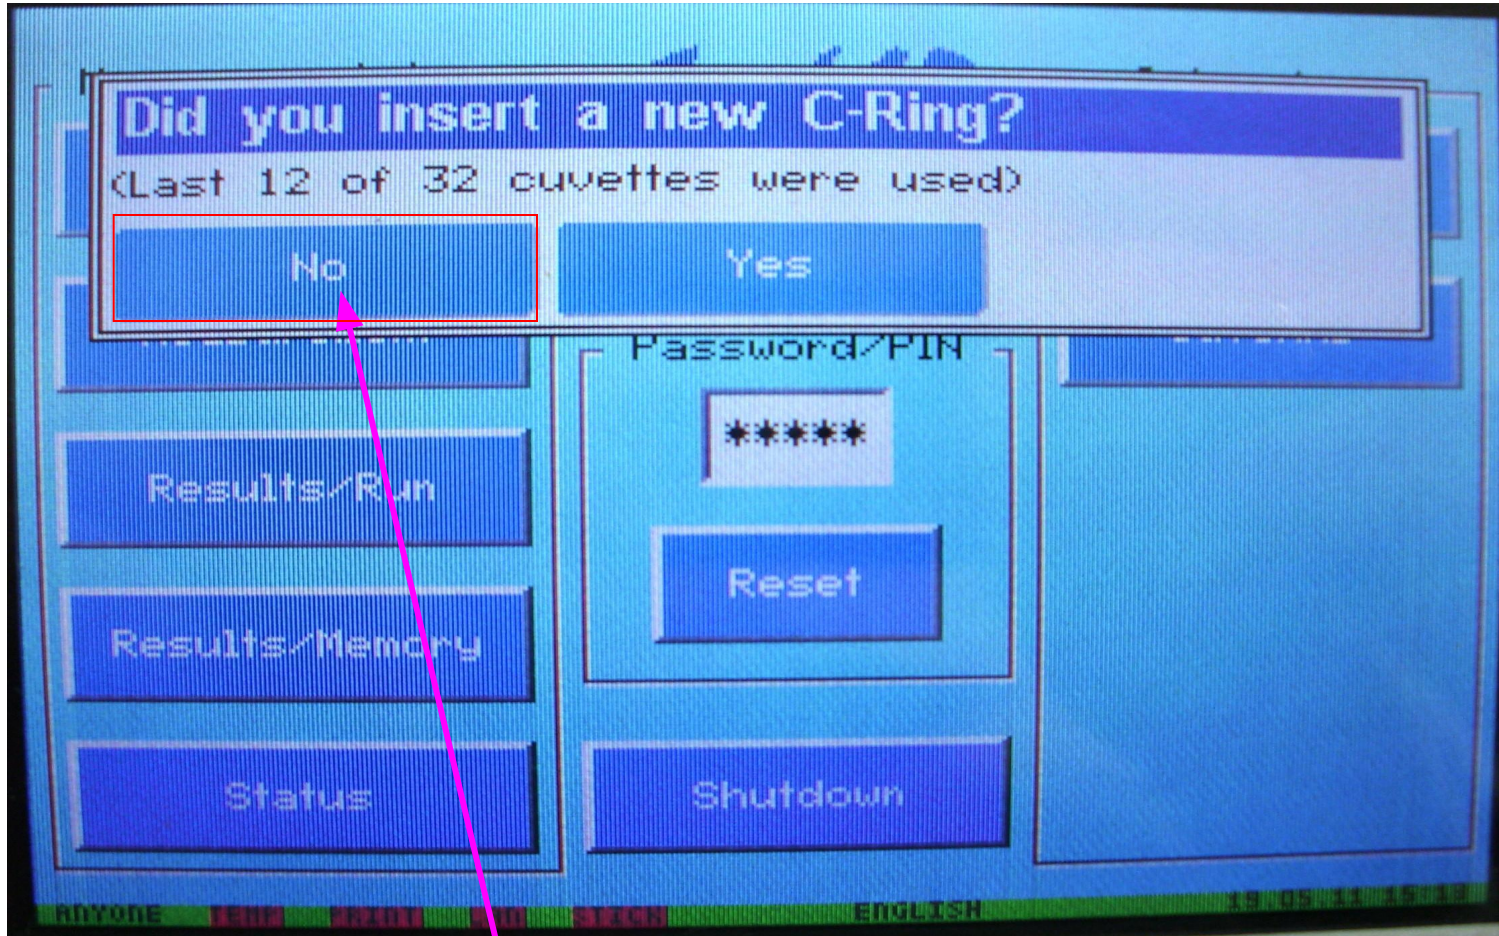


- **НАЖАТЬ НА КНОПКУ NO** - Если Вы решили не менять кюветное кольцо
- **НАЖАТЬ НА КНОПКУ YES** – Если Вы решили заменить кюветное кольцо

НА ДИСПЛЕЕ ПРИБОРА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПОЯВЛЯТЬСЯ ОКНА
ИНФОРМИРУЮЩЕЕ О ТЕКУЩЕМ ПРОЦЕССЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОМПЫ
И УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В НЕЙ

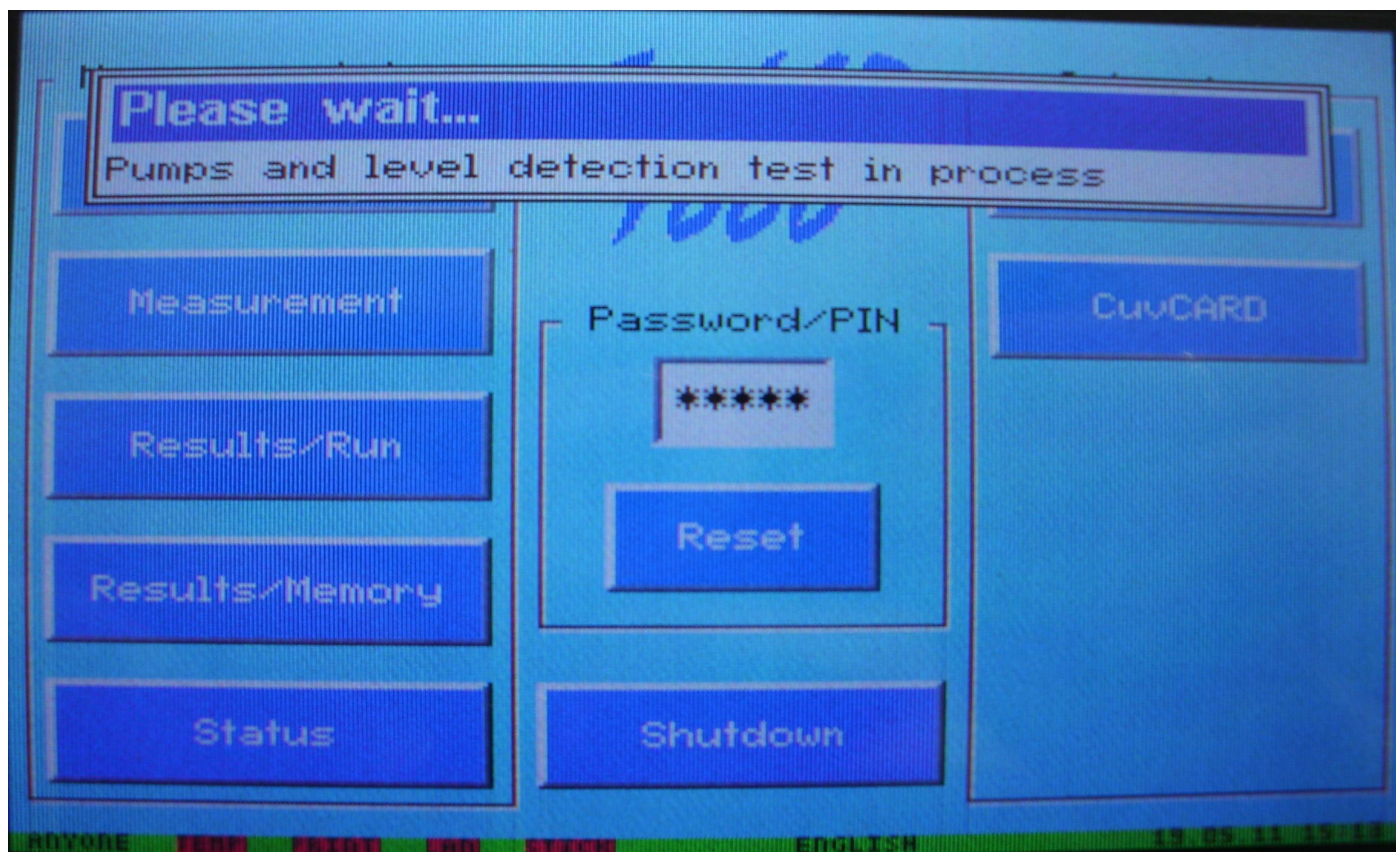


ЗАТЕМ, АВТОМАТИЧЕСКИ НА ДИСПЛЕЕ ПРИБОРА ПОЯВИТЬСЯ ОКНО ГЛАВНОГО МЕНЮ АНАЛИЗАТОРА

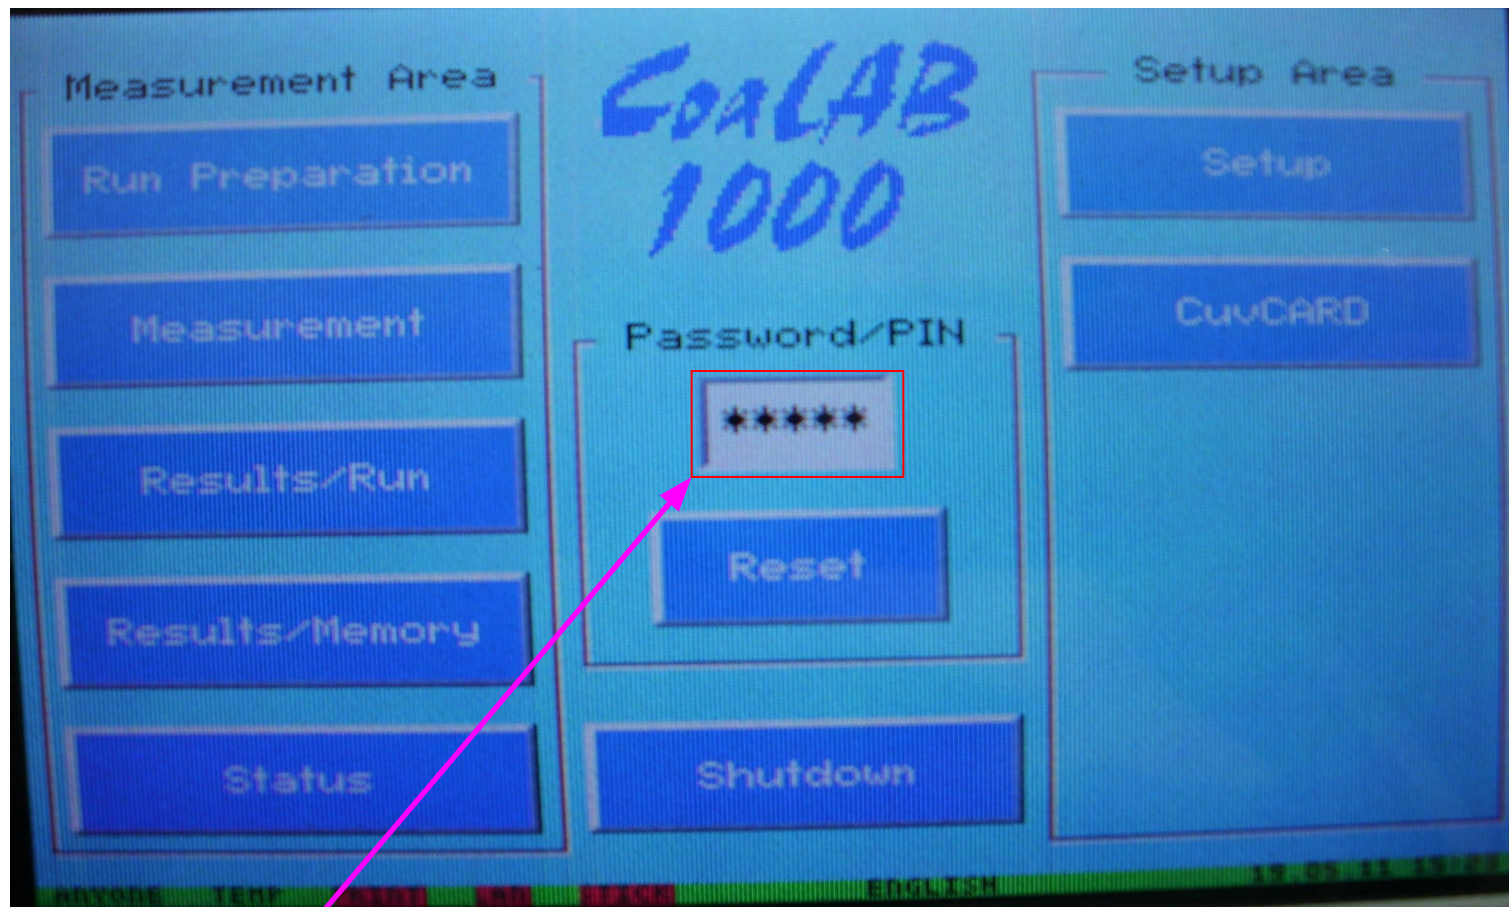

- ДОТРОНЬТЕСЬ ДО ПОЛЯ ВВОДА ПАРОЛЯ

НА ДИСПЛЕЕ ПРИБОРА ПОЯВИТЬСЯ ОКНО ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЫ

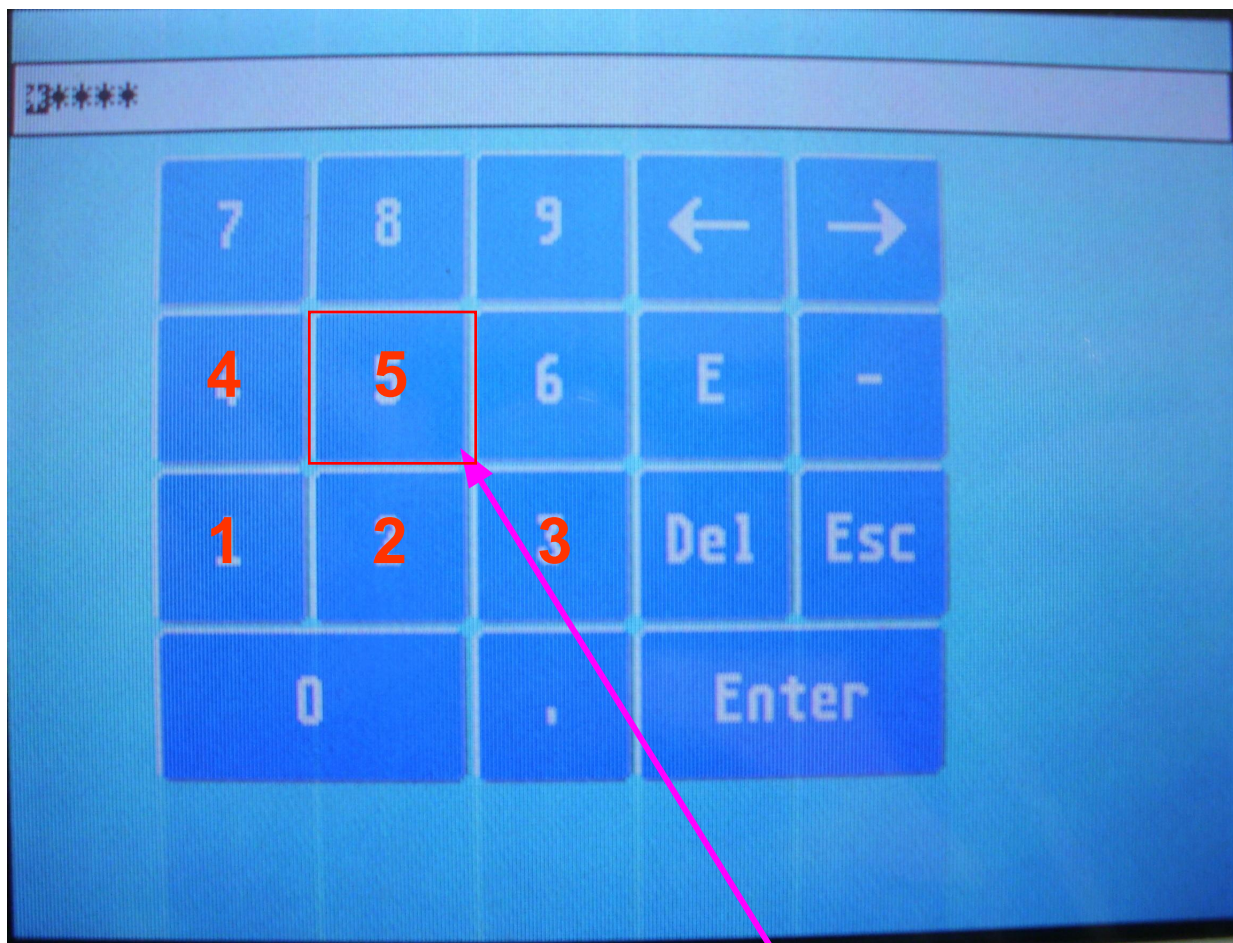

- ПРИ ПОМОЩИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО НАЖАТИЯ КЛАВИШ **12345** ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ

НА ДИСПЛЕЕ ПРИБОРА СНОВА ПОЯВИТЬСЯ ОКНО ГЛАВНОГО МЕНЮ АНАЛИЗАТОРА



АНАЛИЗАТОР ГОТОВ К РАБОТЕ