BIOMEDI

Прибор биорезонансной мультичастотной синхронизации ТРИНИТИ

Режимы работы

Врач высшей категории дерматолог аллерголог иммунолог ВРТ - диагност ***Зеленская Елена Викторовна***

БИОМЕДИС –
это физиотерапевтические аппараты
для восстановления и поддержания здоровья

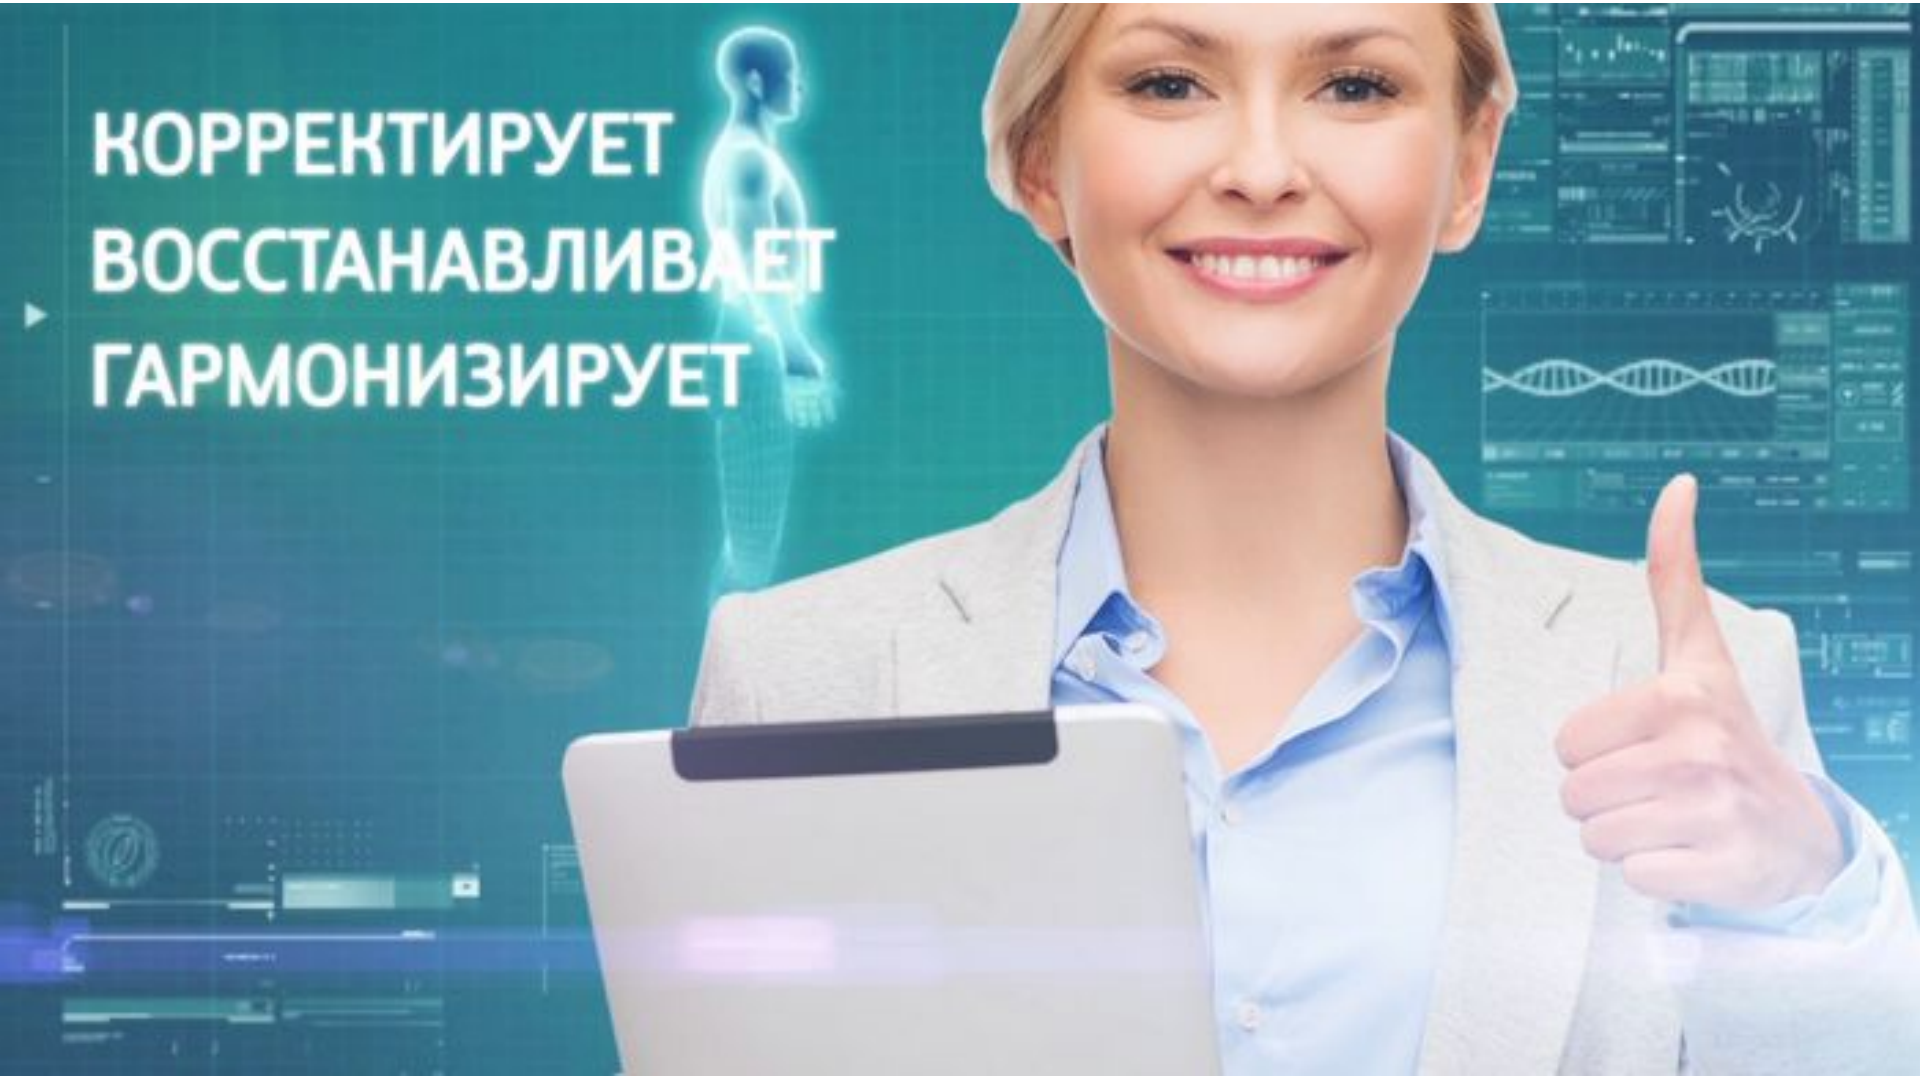

БИОМЕДИС ТРИНИТИ

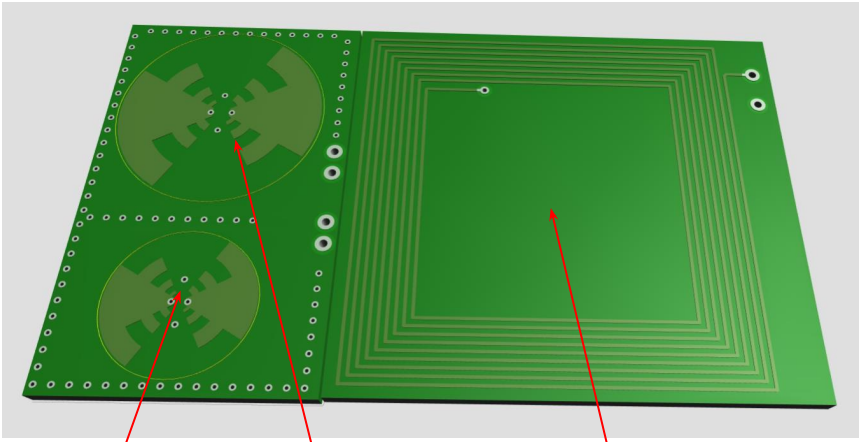

fн.3 ~ 22-26 ГГц х n

fн.2 ~ 17-19 ГГц х n

fн.1=24 МГц

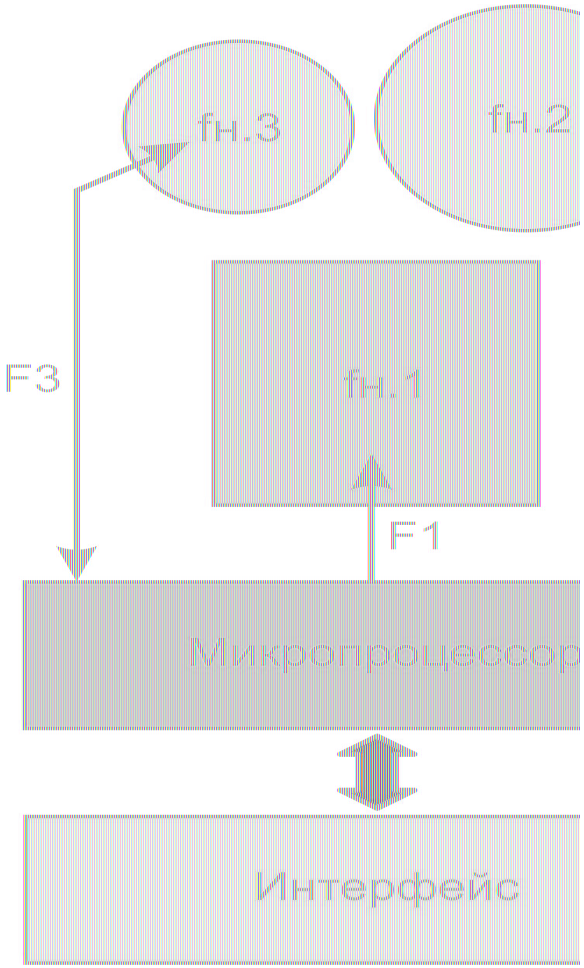

Устройство прибора

ТРИНИТИ РЕЖИМ № 1

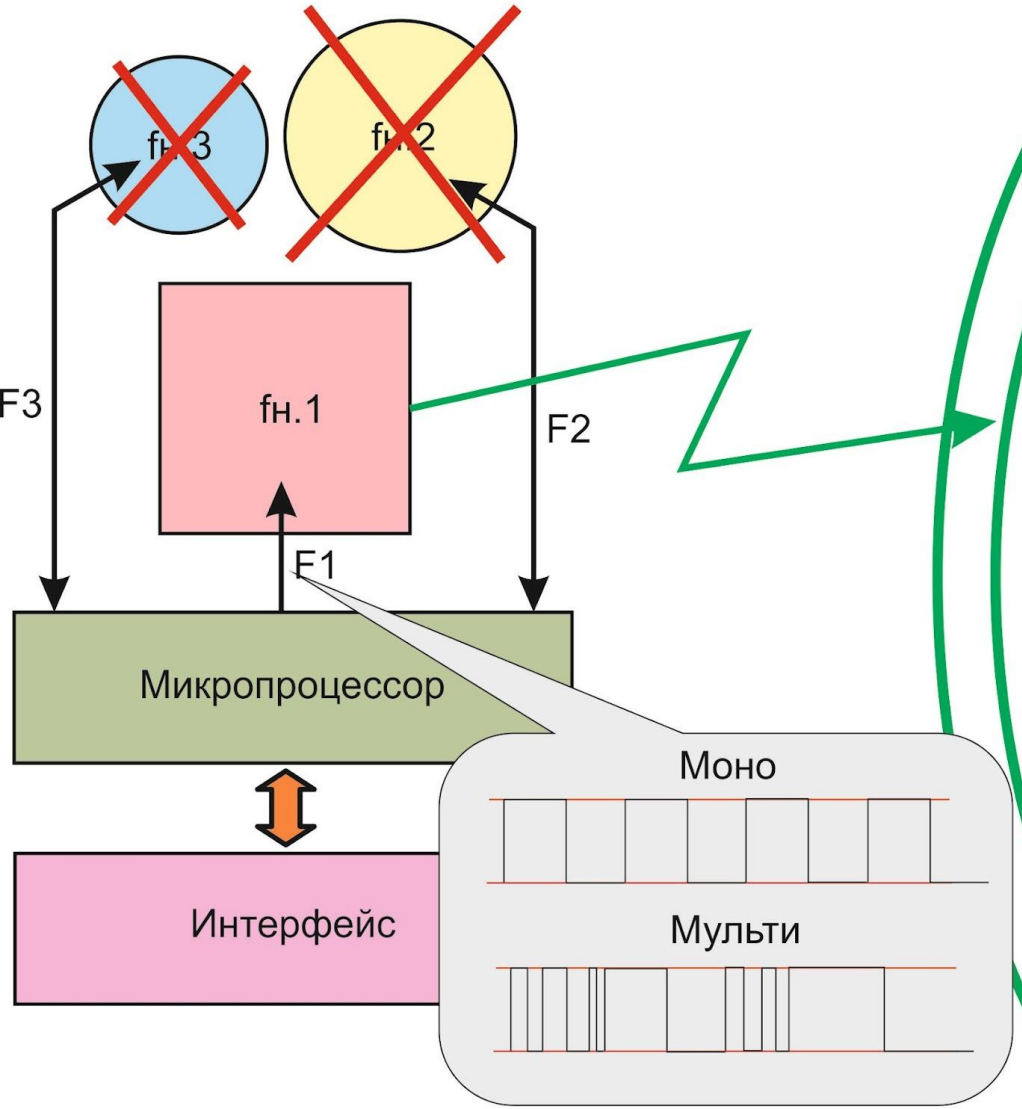

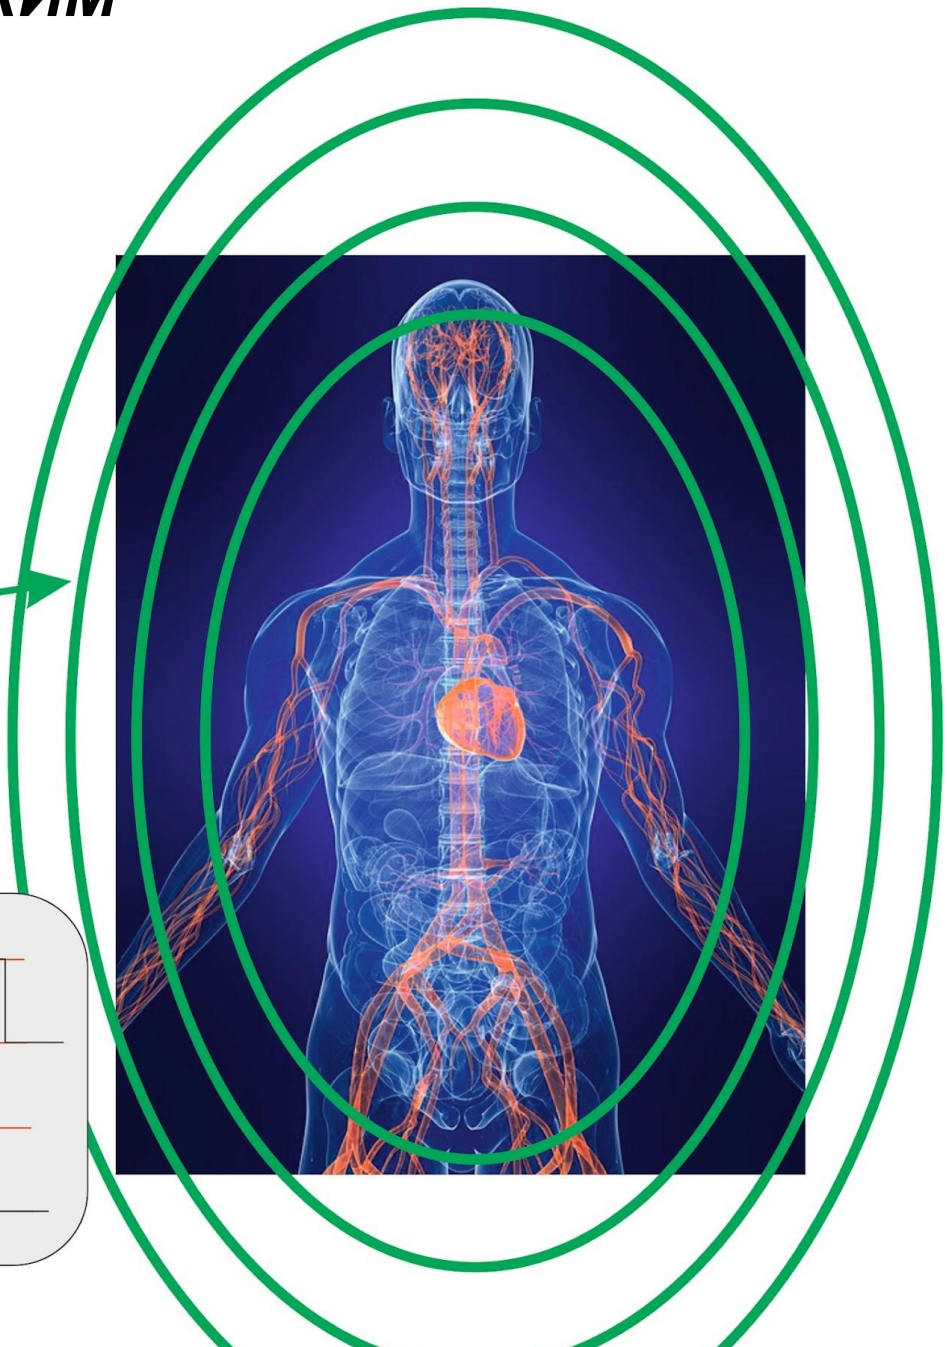

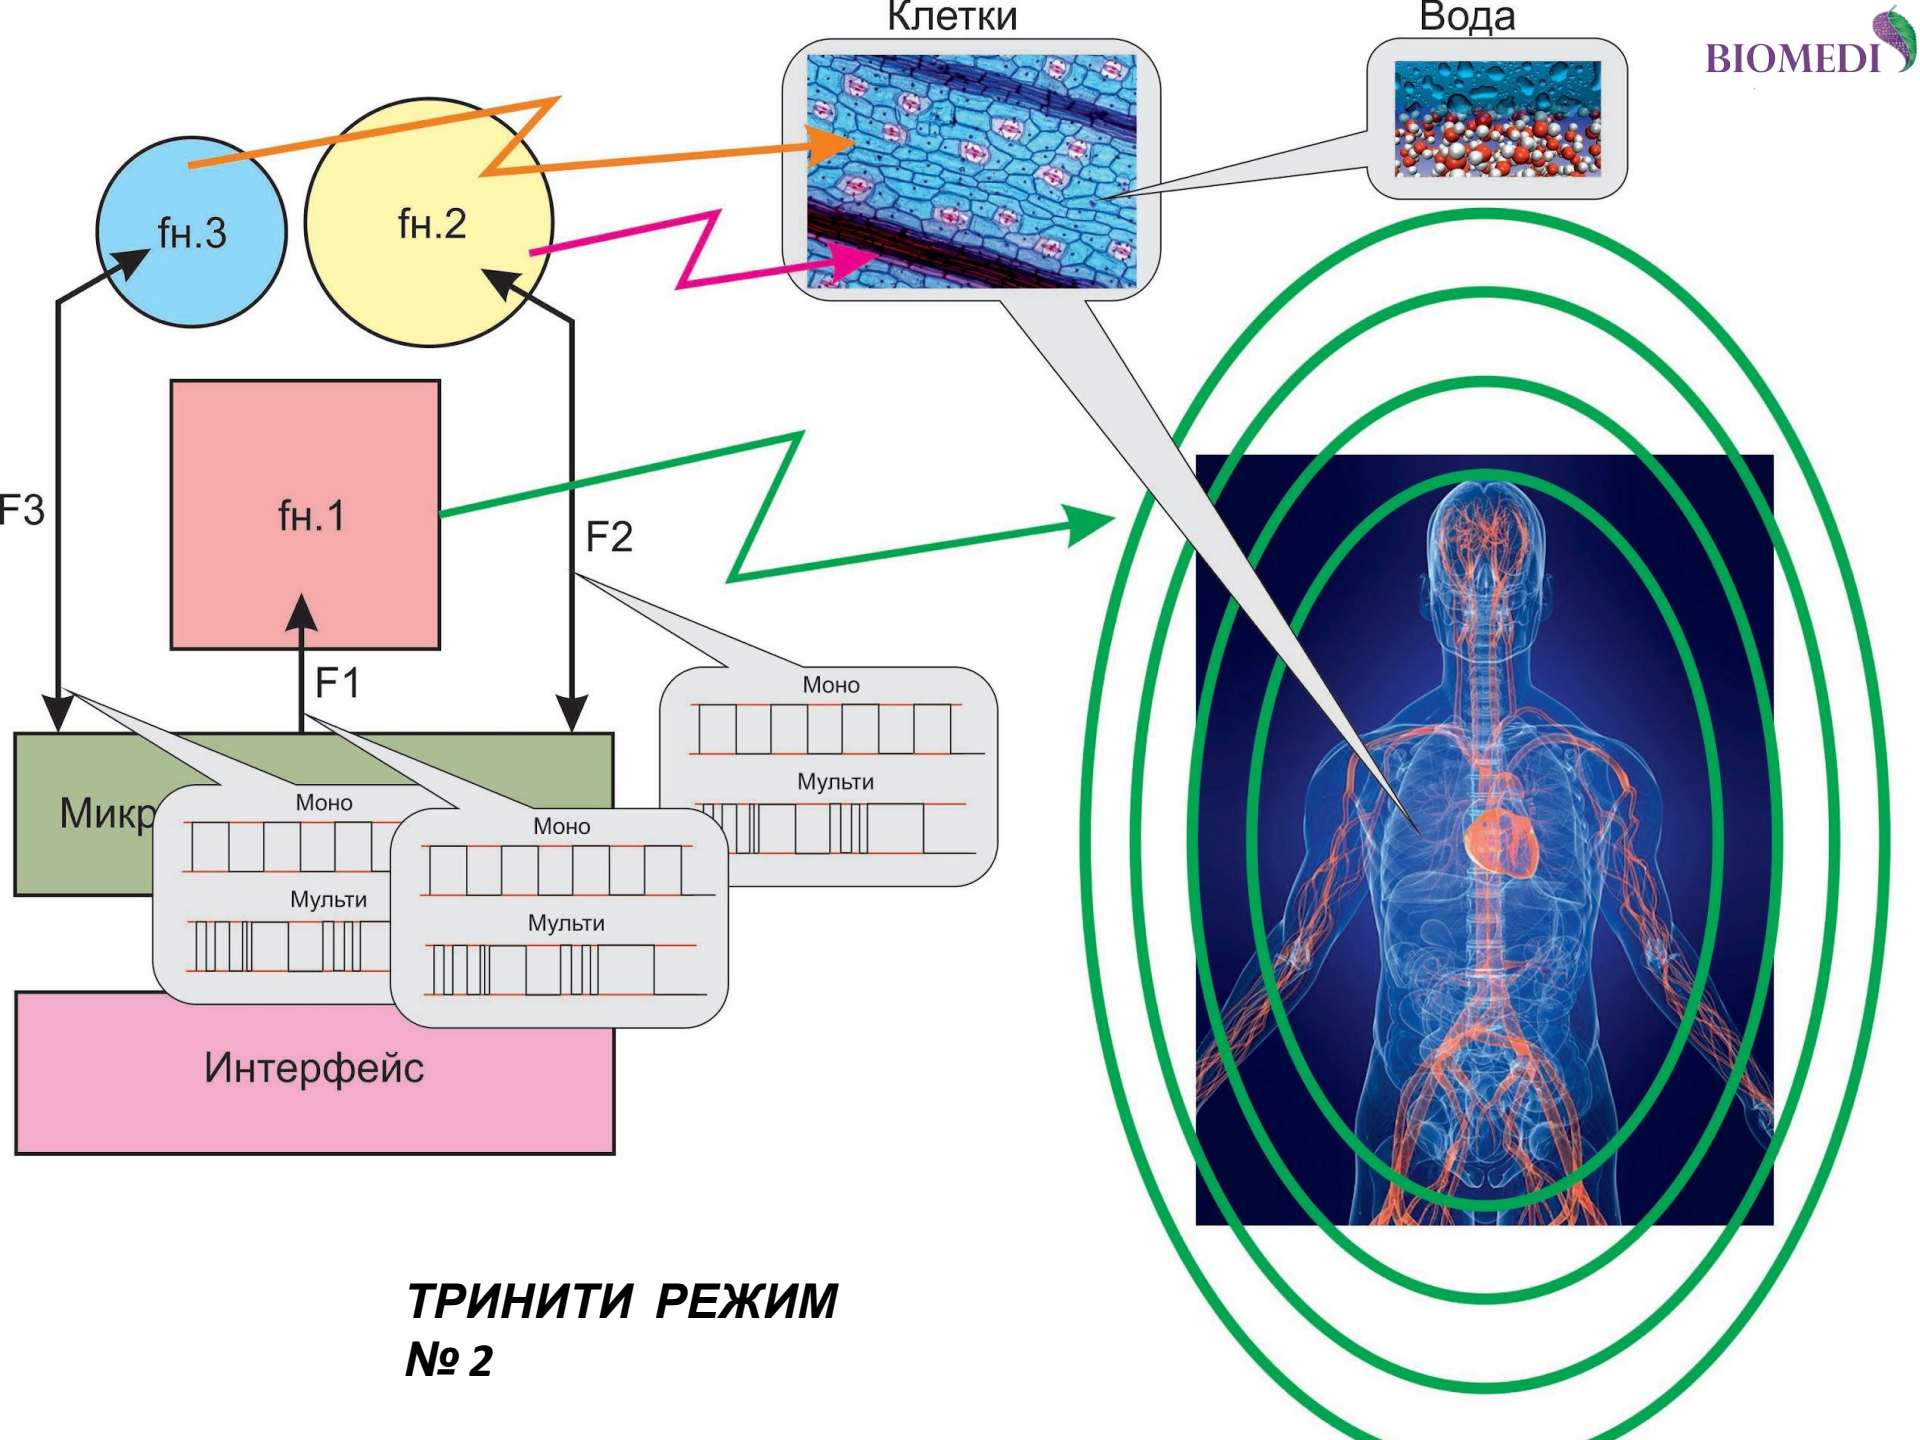

ТРИНИТИ РЕЖИМ
№ 2

Режим № 2 «Суперпрограмма-1»

BIOMEDI

Frequency (Hz) - Frequency F1	Frequency (Hz) - Frequency F2	Frequency (Hz) - Frequency F3
12681.22	8454.14	5636.10
6340.61	4227.07	2818.05
3170.30	2113.54	1409.02
1585.15	1056.77	704.51
792.58	528.38	352.26
396.29	264.19	176.13
198.14	132.10	88.06
99.07	66.05	44.03
49.54	33.02	22.02
24.77	16.51	11.01
12.38	8.26	5.50
6.19	4.13	2.75
3.10	2.06	1.38
1.55	1.03	0.69
0.77	0.52	0.34

1. Частотная характеристика				2. Эффекты структурно-резонансного воздействия
интегральная частота 0,0108Гц (период 93 секунды)				
x2				
0,0215Гц				МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ
x2 ↙		↘ x3		
0,0430		0,0645	2^{0}(=1)	ЖЕЛУДОК, НИСХОДЯЩАЯ КИШКА
x2		x2		
0,0860		0,1290	2^{1}	ПОПЕРЕЧНО-ОБОДОЧНАЯ, ВОСХОДЯЩАЯ КИШКА
x2		x2		
0,1720		0,2580	2^{2}	БРОХОЛЕГ. СИСТЕМА, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ТОНК КИШЕЧНИК
x2	x3	x2 x3		
0,344	0,516	0,774		
0,688	1,032	1,548	2^{4}	
1,376	2,064	3,096	2^{5}	СИМПАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
2,752	4,128	6,192	2^{6}	
5,504	8,256	12,384	2^{7}	
11,008	16,512	24,768	2^{8}	ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
22,016	33,024	49,536	2^{9}	
44,032	66,048	99,072	2^{10}	
88,064	132,096	198,144	2^{11}	ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МУСКУЛАТУРА
176,128	264,192	396,288	2^{12}	
352,256	528,384	792,576	2^{13}	
704,512	1056,768	1585,152	2^{14}	
1409,024	2113,536	3170,304	2^{15}	
2818,048	4227,072	6340,608	2^{16}	
5636,096	8454,144	12681,22	2^{17}	МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЙ
11272,19	16908,29	25362,43	2^{18}	
22544,38	33816,58	50724,86	2^{19}	КЛЕТОЧНЫЙ
45088,77	67633,15	101449,7	2^{20}	СУБКЛЕТОЧНЫЙ

Режим № 2 «Суперпрограмма-1»

BIOMEDI

Frequency (Hz) - Frequency F1	Frequency (Hz) - Frequency F2	Frequency (Hz) - Frequency F3
12681.22	8454.14	5636.10
6340.61	4227.07	2818.05
3170.30	2113.54	1409.02
1585.15	1056.77	704.51
792.58	528.38	352.26
396.29	264.19	176.13
198.14	132.10	88.06
99.07	66.05	44.03
49.54	33.02	22.02
24.77	16.51	11.01
12.38	8.26	5.50
6.19	4.13	2.75
3.10	2.06	1.38
1.55	1.03	0.69
0.77	0.52	0.34

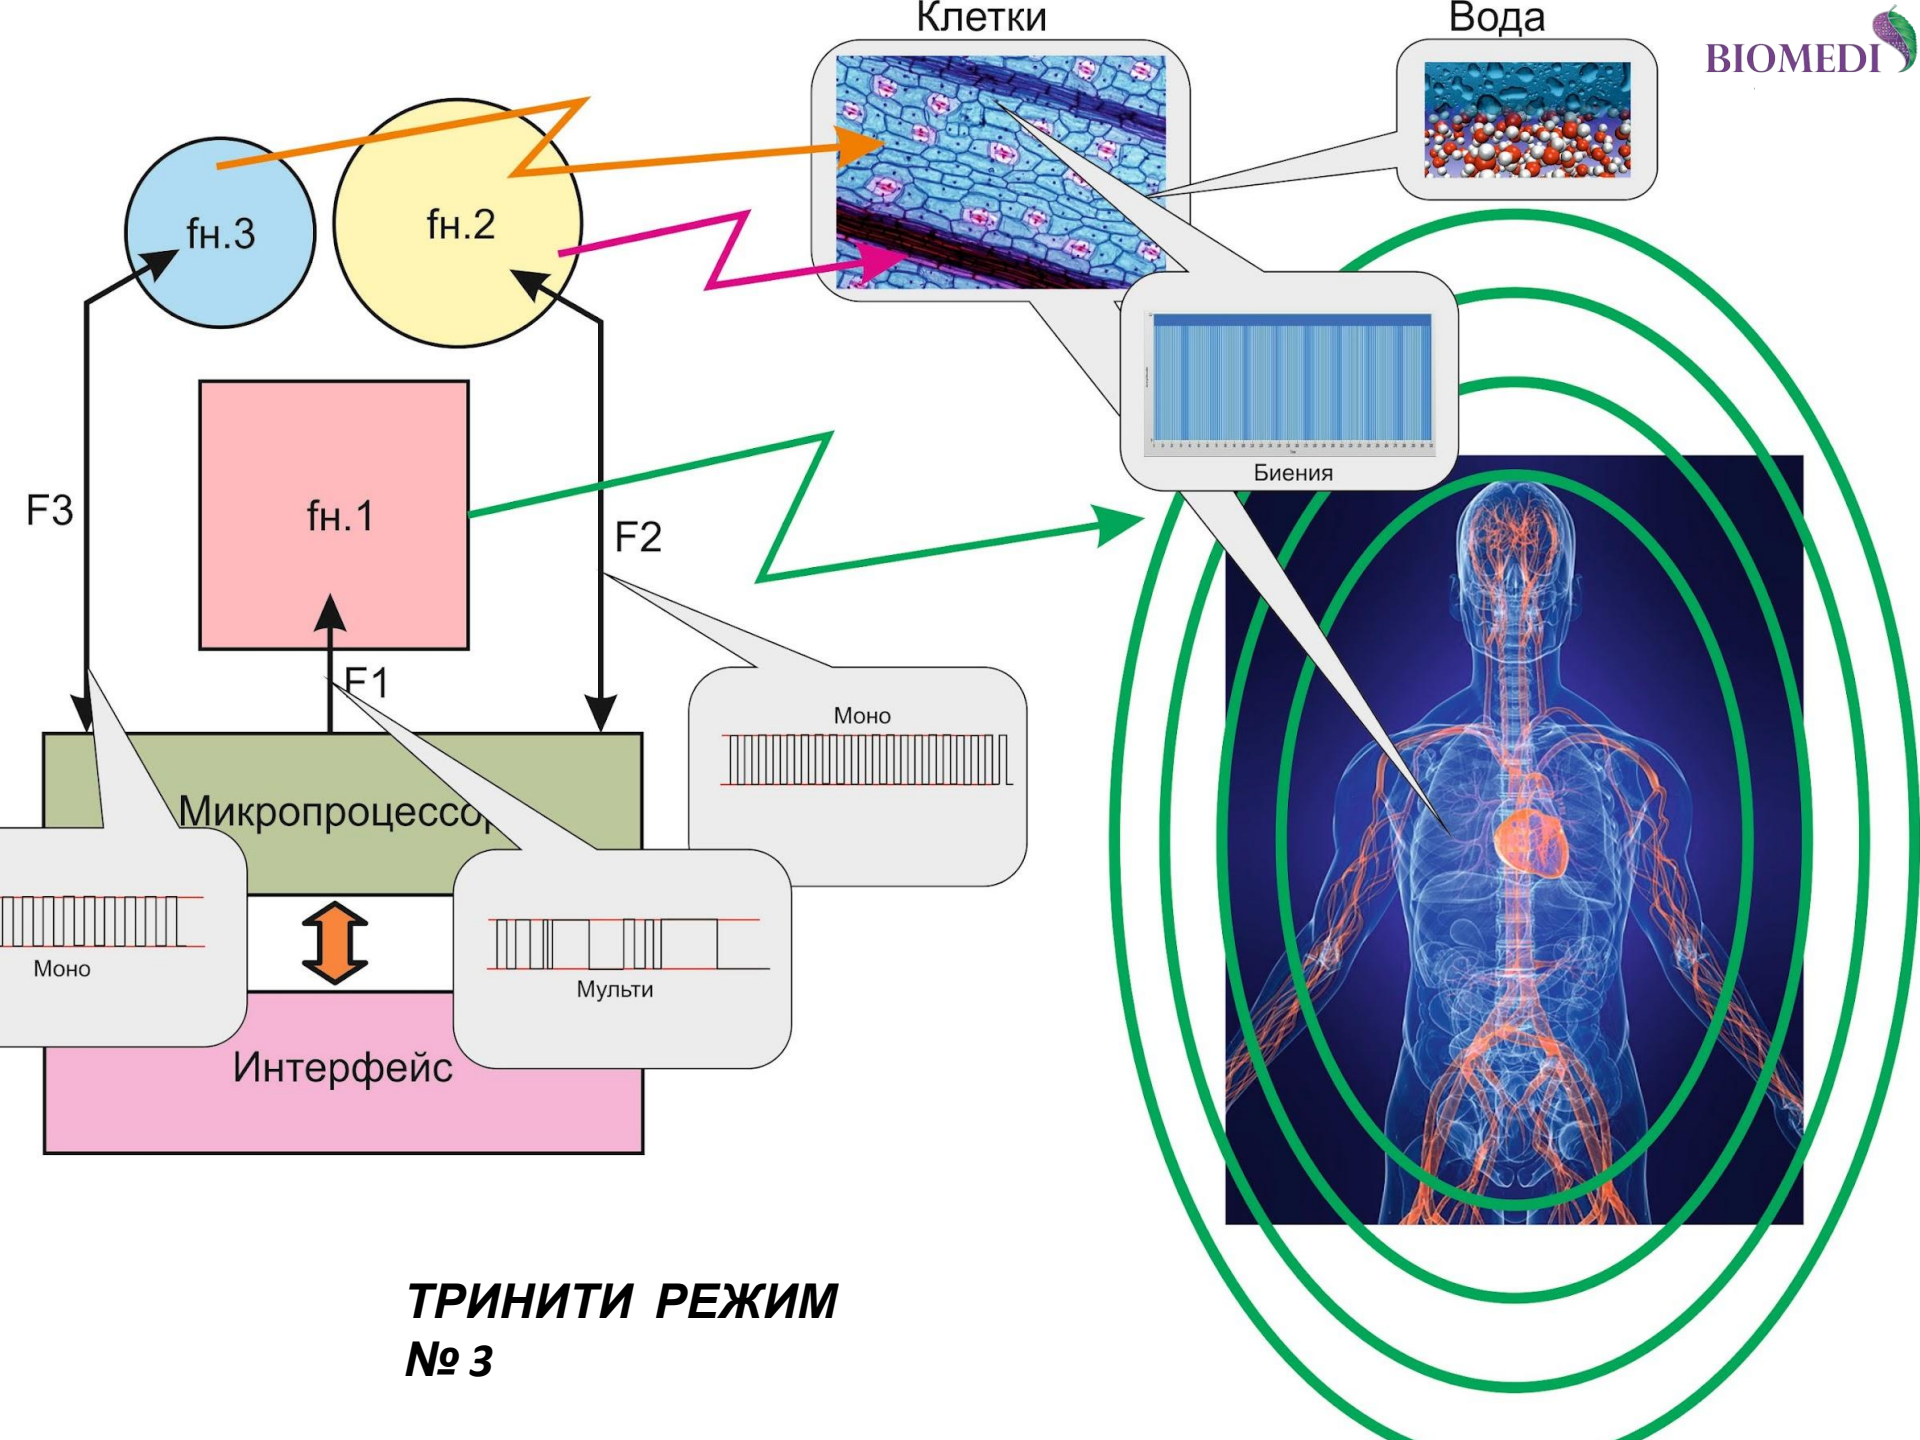

ТРИНИТИ РЕЖИМ
№ 3

Режим № 3 «Суперпрограмма-3»

Frequency (Hz) - Frequency F1	Frequency (Hz) - Frequency F2	Frequency (Hz) - Frequency F3
12681.22	8454.14	5636.10
5636.10	8454.14	12681.22
8454.14	5636.10	12681.22
6340.61	4227.07	2818.05
2818.05	4227.07	6340.61
4227.07	2818.05	6340.61
3170.30	2113.54	1409.02
1409.02	2113.54	3170.30
2113.54	1409.02	3170.30
1585.15	1056.77	704.51
704.51	1056.77	1585.15
1056.77	704.51	1585.15
792.58	528.38	352.26
352.26	528.38	792.58
528.38	352.26	792.58
396.29	264.19	176.13
176.13	264.19	396.29
264.19	176.13	396.29
198.14	132.10	88.06

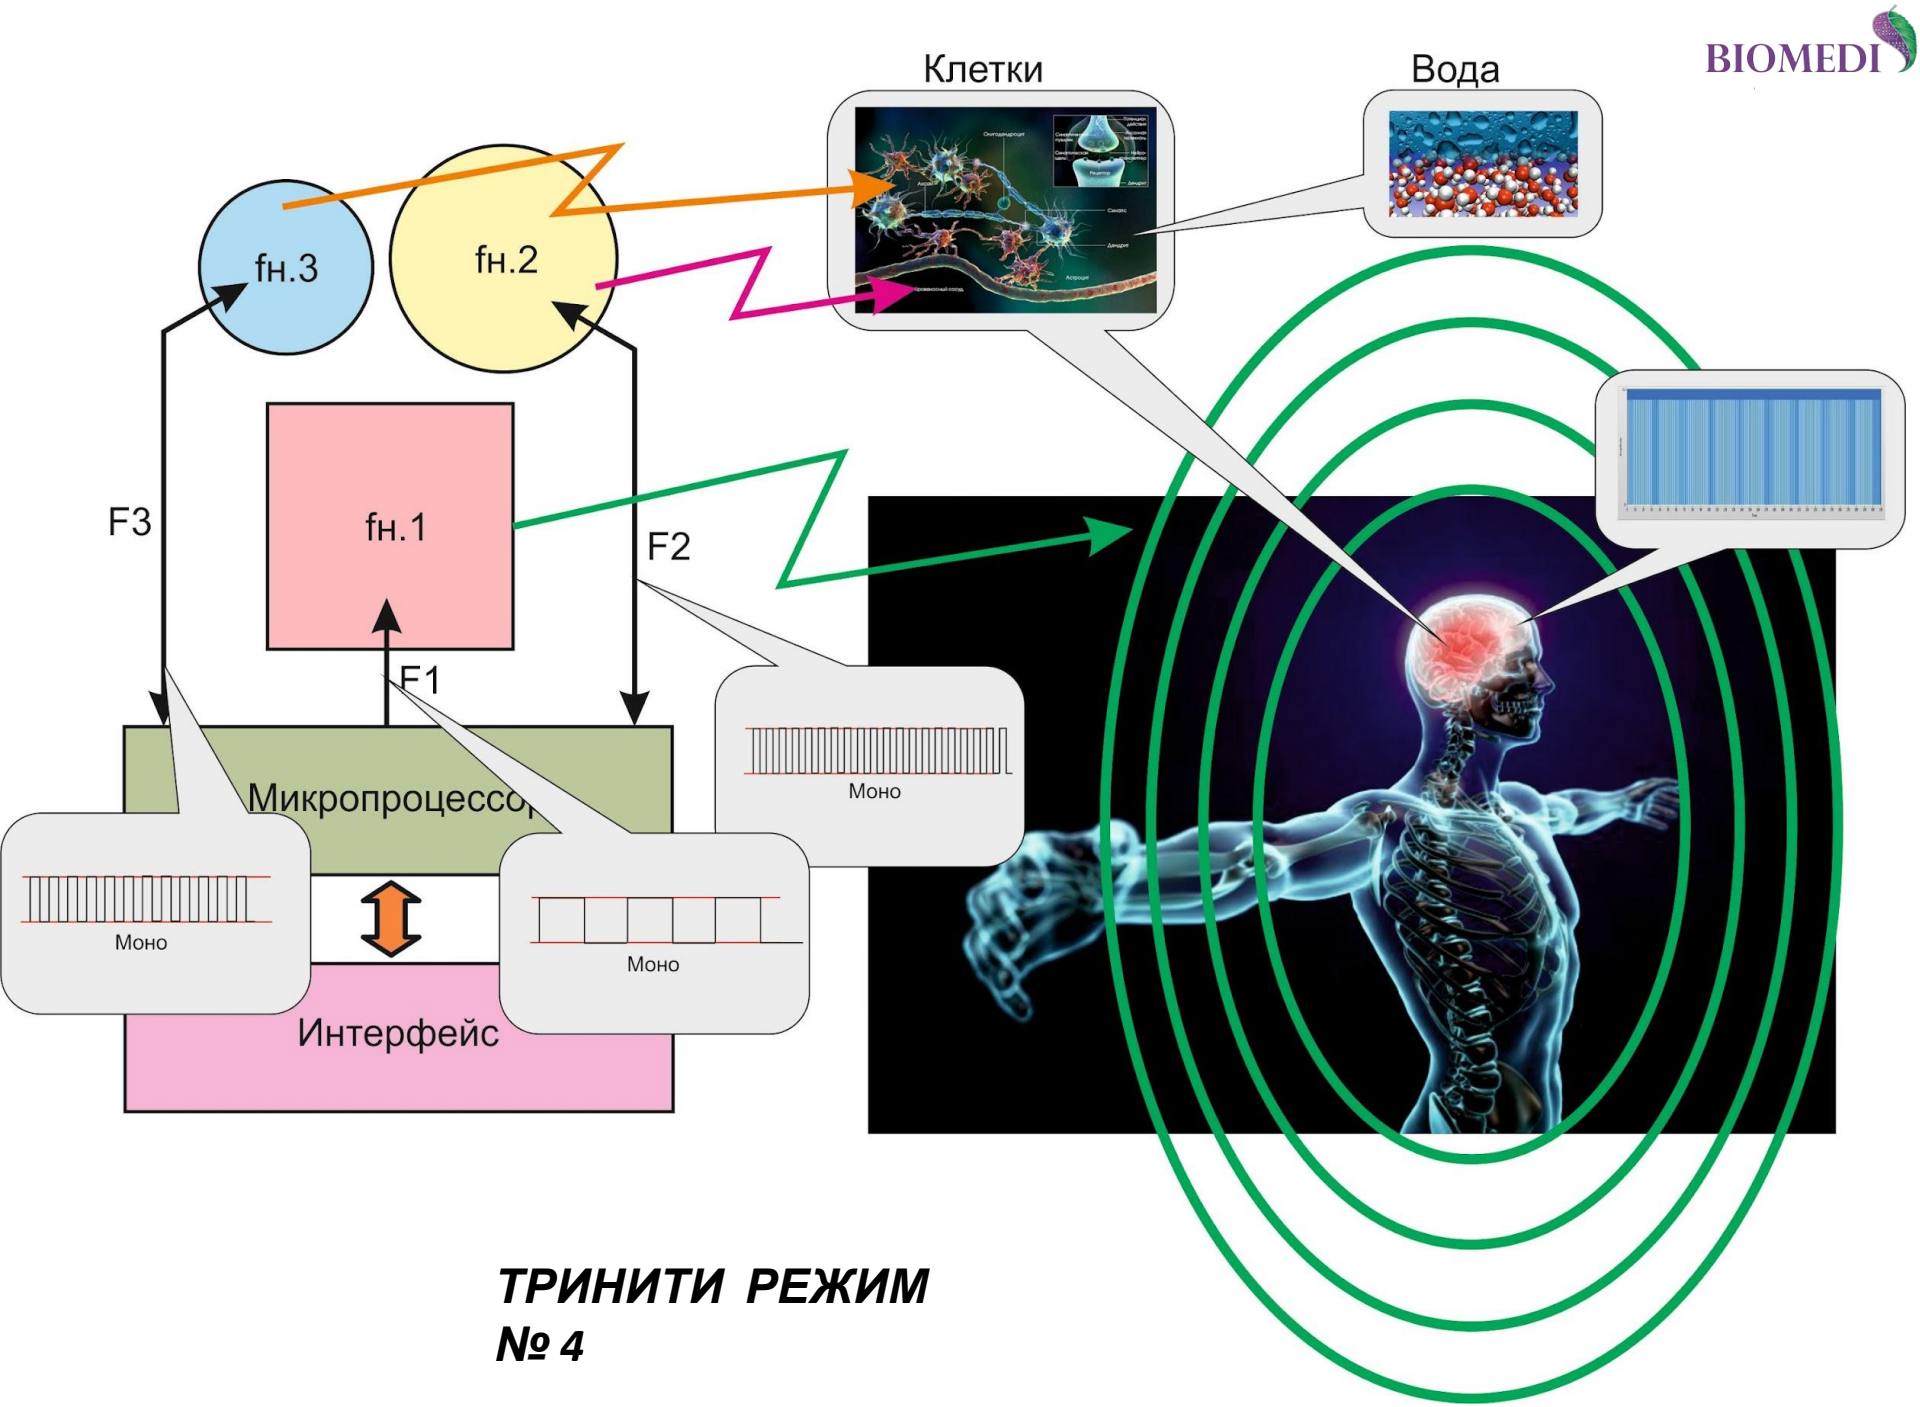

ТРИНИТИ РЕЖИМ
№ 4

Режим № 4 «Суперпрограмма-2»

Frequency (Hz) - Frequency F1	Frequency (Hz) - Frequency F2	Frequency (Hz) - Frequency F3
176.13	528.38	352.26
132.10	396.29	264.19
88.06	264.19	176.13
66.05	198.14	132.10
44.03	132.10	88.06
33.02	99.07	66.05
22.02	66.05	44.03
16.51	49.54	33.02
11.01	33.02	22.02
8.26	24.77	16.51
5.50	16.51	11.01
4.13	12.38	8.26
2.75	8.26	5.50
2.06	6.19	4.13
1.38	4.13	2.75
1.03	3.10	2.06
0.69	2.06	1.38
0.52	1.55	1.03
0.34	1.03	0.69
0.26	0.77	0.52
0.17	0.52	0.34

F1 (Hz)	F2 (Hz)	F3 (Hz)
9.00	66.50	57.5
9.88	66.94	57.06
10.50	67.25	56.75
10.88	67.44	56.56
11.00	67.50	56.5
10.69	67.34	56.66
10.00	67.00	57
9.31	66.66	57.34
9.00	66.50	57.5
9.31	66.66	57.34
10.00	67.00	57
10.69	67.34	56.66
11.00	67.50	56.5
10.69	67.34	56.66
10.00	67.00	57
9.31	66.66	57.34
9.00	66.50	57.5
9.31	66.66	57.34
10.00	67.00	57
10.69	67.34	56.66
11.00	67.50	56.5
10.69	67.34	56.66
10.00	67.00	57
9.31	66.66	57.34
9.00	66.50	57.5
9.31	66.66	57.34
10.00	67.00	57
10.69	67.34	56.66
11.00	67.50	56.5
10.69	67.34	56.66
10.00	67.00	57
9.31	66.66	57.34
9.00	66.50	57.5
9.31	66.66	57.34
10.00	67.00	57
10.69	67.34	56.66
11.00	67.50	56.5
10.88	67.44	56.56
10.50	67.25	56.75
9.88	66.94	57.06
9.00	66.50	57.5

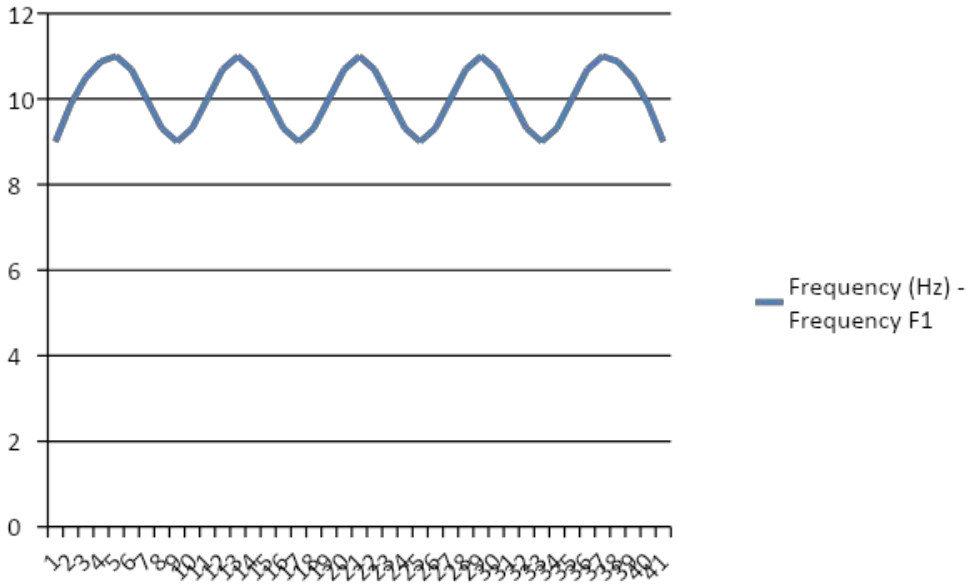

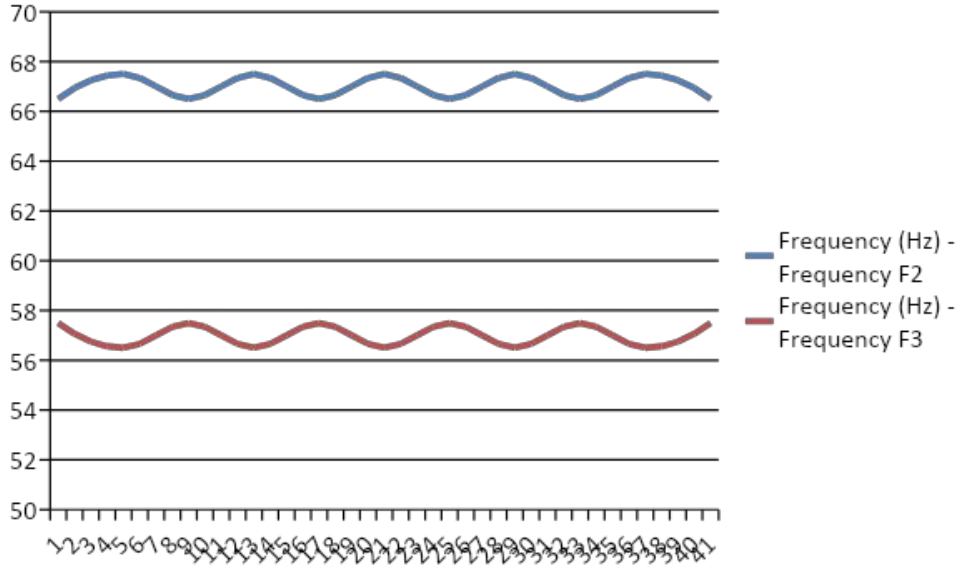

Режим № 4 Программа «Альфа релакс для восст. физ. сил»

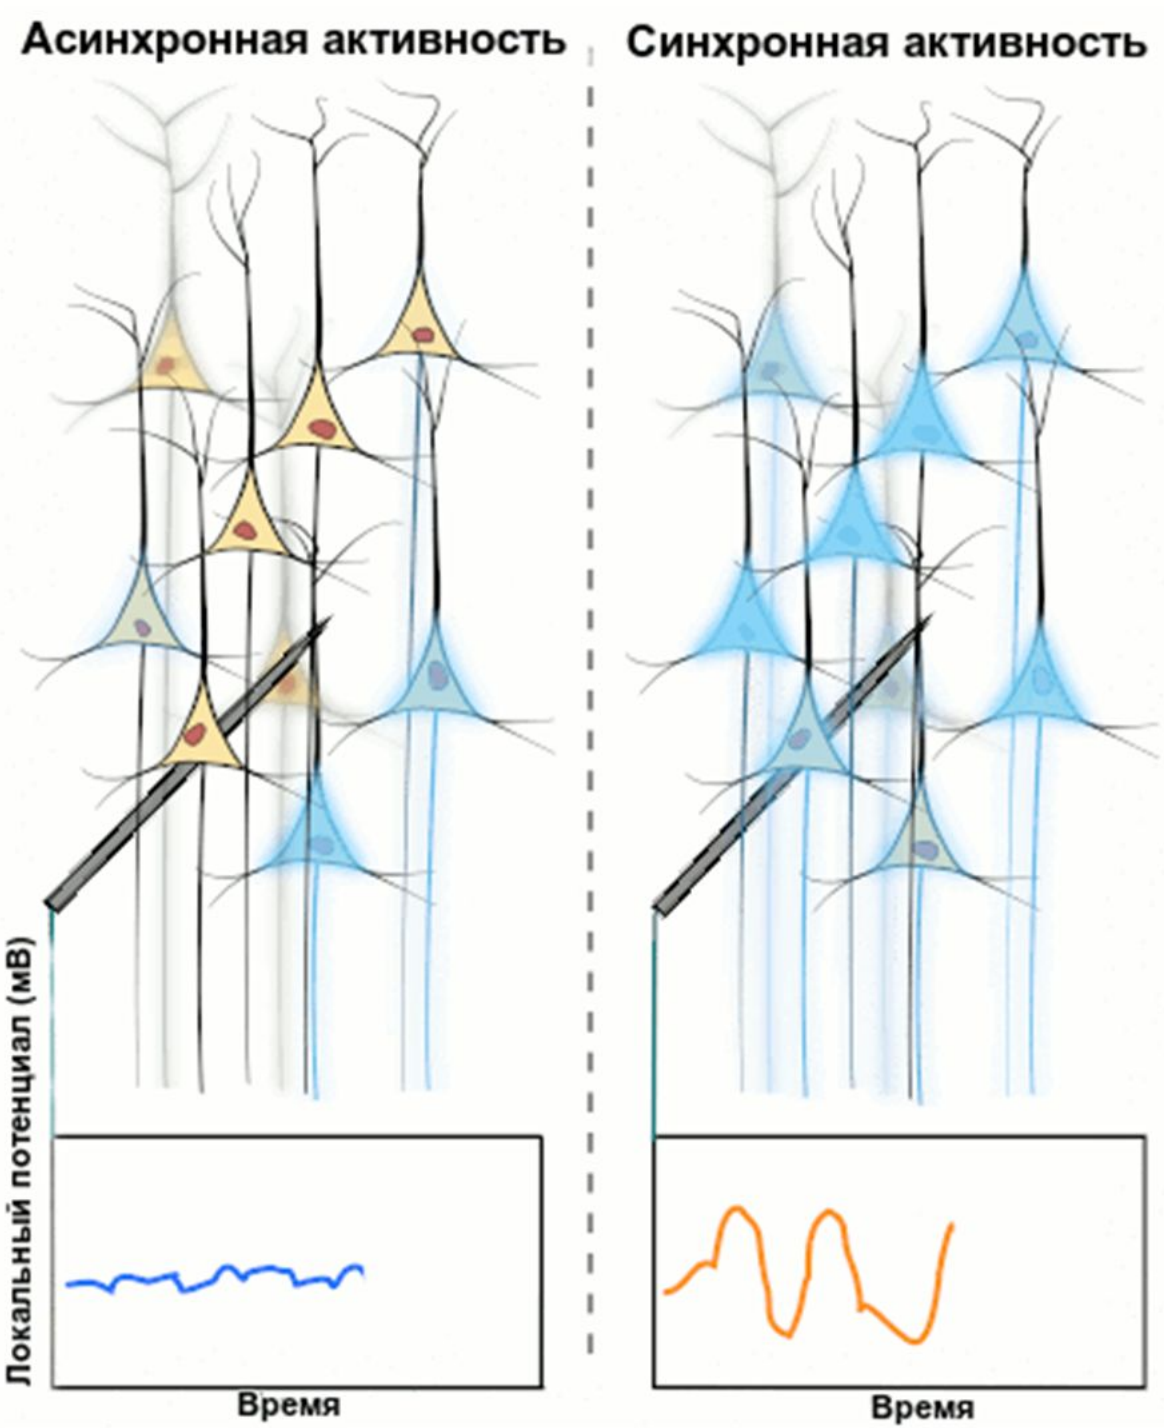
Асинхронная активность
Синхронная активность
Локальный потенциал (мВ)
Время
Время

BIOMEDI

До

После

BIOMEDI

Спокойствие=14.7%

Спокойствие=80.2%

До

После

BIOMEDI

Спокойствие=53%

Спокойствие=85%

BIOMEDI

До

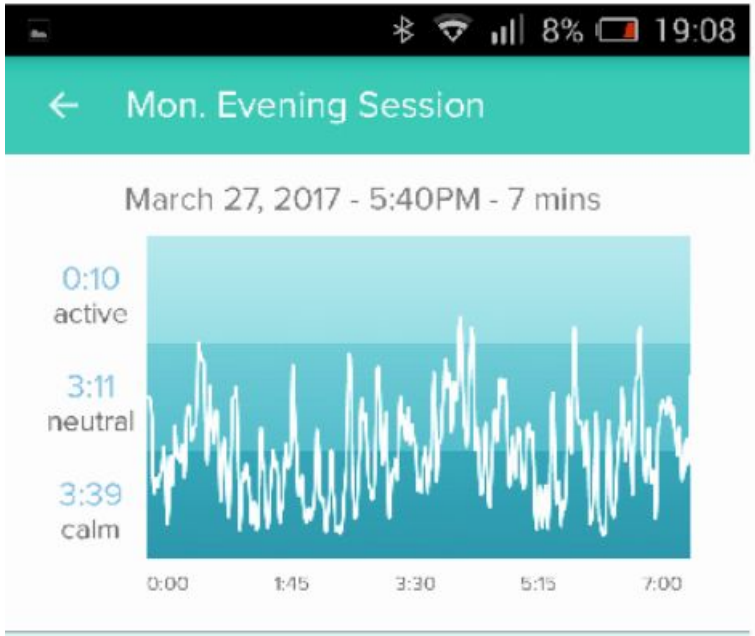

Спокойствие=52.1%

После

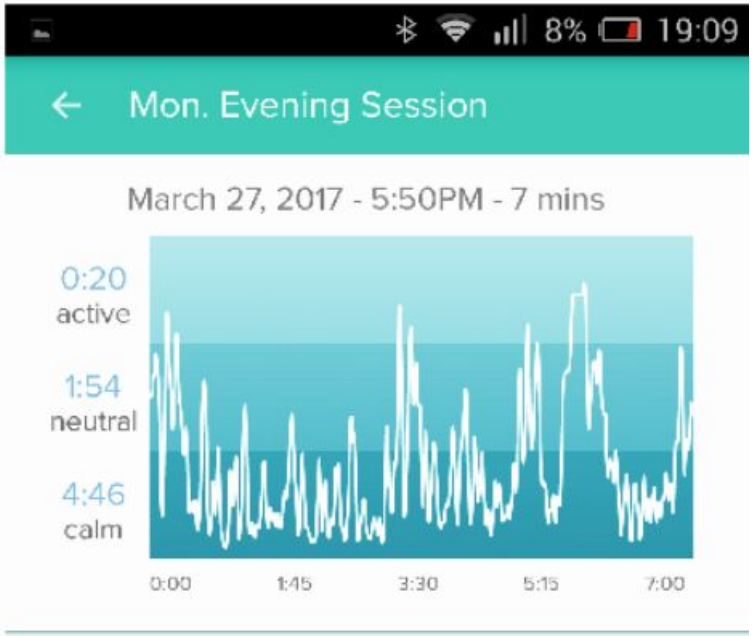

Спокойствие=68%

BIOMEDI

До

Спокойствие=52.6%

После

Спокойствие=80.4%

ЗАО "Клиника Современных Медицинских Технологий"
Большой Головин пер., д.4.
Телефон: 8(495)737-43-90
Тел : 231-10-46

Медицинская документация
Форма №025/у-87
Утв.Минздравом СССР 31.12.87
№ 1338

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО
Ультразвуковое исследование органов малого таза женщины

Дата приема: **17.01.2017**
Пациент:
Доктор: **Харичкова Алевтина Михайловна**
Номер карты: **36/17**
Дата рождения: **1990**

День м/цикла : 5 д.ц. П/ М 13.01.2017
Доступ : трансвагинальный

МАТКА
Тело матки : определяется в обычном положении грушевидной формы с ровным контуром
Длина матки : 45 мм (норма 40-60 мм.)
Толщина : 25 мм (норма 30-45 мм.)
Ширина : 47 мм (норма 45-60 мм.)
Строение миометрия : не изменено

ЭНДОМЕТРИЙ
Толщина : обычная (с учетом дня цикла) "трехслойный " гипоэхогенный соответствует фазе цикла М-ЭХО - 3 мм
Контуры : на границе с внутренним мышечным слоем четкие
Полость матки : не расширена и не деформирована

ШЕЙКА МАТКИ
Шейка матки : определяется размеры обычные
Толщина эндоцервикса : обычная
Цервикальный канал : не расширен

ПРАВЫЙ ЯИЧНИК
Правый яичник : определяется в типичном месте
Длина : 28 мм. (норма20-35 мм.)
Толщина : 18 мм. (норма 15-25 мм.)
Ширина : 22 мм. (норма 20-30 мм.)
Объем : 6,31 см3 (норма не более 8 см3)
Строение : не изменено, фолликулярный аппарат выражен

ЛЕВЫЙ ЯИЧНИК
Левый яичник : определяется за маткой по ребру
Длина : 43 мм. (норма20-35 мм.)
Толщина : 28 мм. (норма 15-25 мм.)
Ширина : 32 мм. (норма 20-30 мм.)
Объем : 21,16 см3 (норма не более 8 см3)
Строение : изменено за счет наличия анэхогенного образования с тонкими ровными стенками, размерами 39 х 24 мм , в режиме ЦДК без признаков кровотока

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В позадиматочном пространстве : свободная жидкость не определяется
Патологические образования в области малого таза : не выявлены
ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Сонографическая картина фолликулиновой фазы менструального цикла, фолликулярной кисты левого яичника
РЕКОМЕНДАЦИИ : Консультация гинеколога повторить УЗИ на 5-7 день менструального цикла через 2 мес.

Направления:

mindray

20170117-084341-260A

17-01-2017 16:08:37

V10 4B AP 97% MI 1.2 TIS 0.3

Матка

ДлинаМатки Dist

ВысотаМатки

ШиринаМатки

ТолщЭндометрия

Возврат

iClear 2

iBeam

M

1 ДлинаМатки 4.53 cm

2 ВысотаМатки 2.53 cm

3 ТолщЭндометрия 4.2 mm

Report 3D/4D iScape

mindray

20170117-084341-260A

17-01-2017 16:11:38

Разм

Отрезок

Обводка

Эллипс

Угол

Объ

Отношение(Д)

Соотношение(Tra...

Соотнош.(Ellispe)

ОбъемПоток

V10 4B AP 97% MI 0.6 TIS 0.3

V10 4B AP 97% MI 0.6 TIS 0.3

1	Lt ДлинаЯичника	4.30 cm
2	Lt ВысотаЯичника	2.86 cm
3	Lt ШиринаЯичника	3.29 cm
	Lt ОбъемЯичника	21.16 cm³
4	Dist	3.98 cm
5	Dist	2.49 cm

Power 3D/4D Scan

ЗАО "Клиника Современных Медицинских Технологий"
Большой Головин пер., д.4.
телефон: 8(495)737-43-90

Медицинская документация
Форма №025/у-87
Утв.Минздравом СССР 31.12.87
№ 1338

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО
Ультразвуковое исследование органов малого таза женщины

Дата приема: **16.03.2017**
Пациент: Номер карты: **36/17**
Доктор: **Харичкова Алевтина Михайловна** Дата рождения: **1990**

День м/цикла : 7 д.ц. П/М 10.03.2017
Доступ : трансвагинальный

МАТКА
Тело матки : определяется в обычном положении грушевидной формы с ровным контуром
Длина матки : 39 мм. (норма 40-60 мм.)
Толщина : 33 мм. (норма 30-45 мм.)
Ширина : 43 мм (норма 45-60 мм.)
Строение миометрия : не изменено

ЭНДОМЕТРИЙ
Толщина : обычная (с учетом дня цикла) "трехслойный " гипоэхогенный соответствует фазе цикла М-ЭХО - 6,5 мм
Контуры : на границе с внутренним мышечным слоем четкие
Полость матки : не расширена и не деформирована

ШЕЙКА МАТКИ
Шейка матки : определяется размеры обычные
Толщина эндоцервикса : обычная
Цервикальный канал : не расширен

ПРАВЫЙ ЯИЧНИК
Правый яичник : определяется в типичном месте
Длина : 27 мм. (норма20-35 мм.)
Толщина : 16 мм. (норма 15-25 мм.)
Ширина : 18 мм. (норма 20-30 мм.)
Строение : не изменено, фолликулярный аппарат выражен

ЛЕВЫЙ ЯИЧНИК
Левый яичник : определяется по ребру
Длина : 29 мм. (норма20-35 мм.)
Толщина : 14 мм. (норма 15-25 мм.)
Ширина : 18 мм. (норма 20-30 мм.)
Строение : изменено за счет анэхогенного включения анэхогенной эхоструктуры неправильной формы размером 19 х 7,5 мм без признаков кровотока в режиме ЦДК

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В позадиматочном пространстве : свободная жидкость не определяется
Патологические образования в области малого таза : не выявлены
ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Сонографическая картина фолликулярной кисты левого яичника в стадии регресса
РЕКОМЕНДАЦИИ : УЗИ контроль через 6 мес.

Направления:

Доктор: Харичкова Алевтина Михайловна

mindray

20170316-114155-260A

16-03-2017 17:53:25

Разм

Отрезок

Обводка

Эллипс

Угол

Объ

Отношение(Д)

Соотношение(Tra...

Соотнош.(Ellispe)

ОбъемПоток

V10 4B AP 97% MI 1.2 TIS 0.3

V10 4B AP 97% MI 0.9 TIS 0.4

1	Rt ДлинаЯичника	2.77 cm
2	Rt ВысотаЯичника	1.66 cm
3	Lt ДлинаЯичника	2.90 cm
4	Lt ВысотаЯичника	1.43 cm
5	Dist	1.89 cm
6	Dist	0.75 cm

Power 3D/4D TScape

mindray

20170316-114155-260A

16-03-2017 17:50:15

Матка

V10 4B AP 97% MI 1.2 TIS 0.3

ДлинаМатки Dist

ВысотаМатки

ШиринаМатки

ТолщЭндометрия

Возврат

iClear 2

iBeam

M

1 ДлинаМатки 3.97 cm

2 ВысотаМатки 3.39 cm

3 ТолщЭндометрия 6.7 mm

Power 3D/4D 1Scape

BIOMEDI

BIOMEDI

Здоровье - залог успеха!