

**Казахстанский  
институт  
метрологии**




## Размещение эталонов/эталонного оборудования по регионам Казахстана

РГП «КазИНМетр» имеет 5 филиалов в пяти городах страны:



# Деятельность РГП «КазИнМетр» как национального метрологического института (NMI)



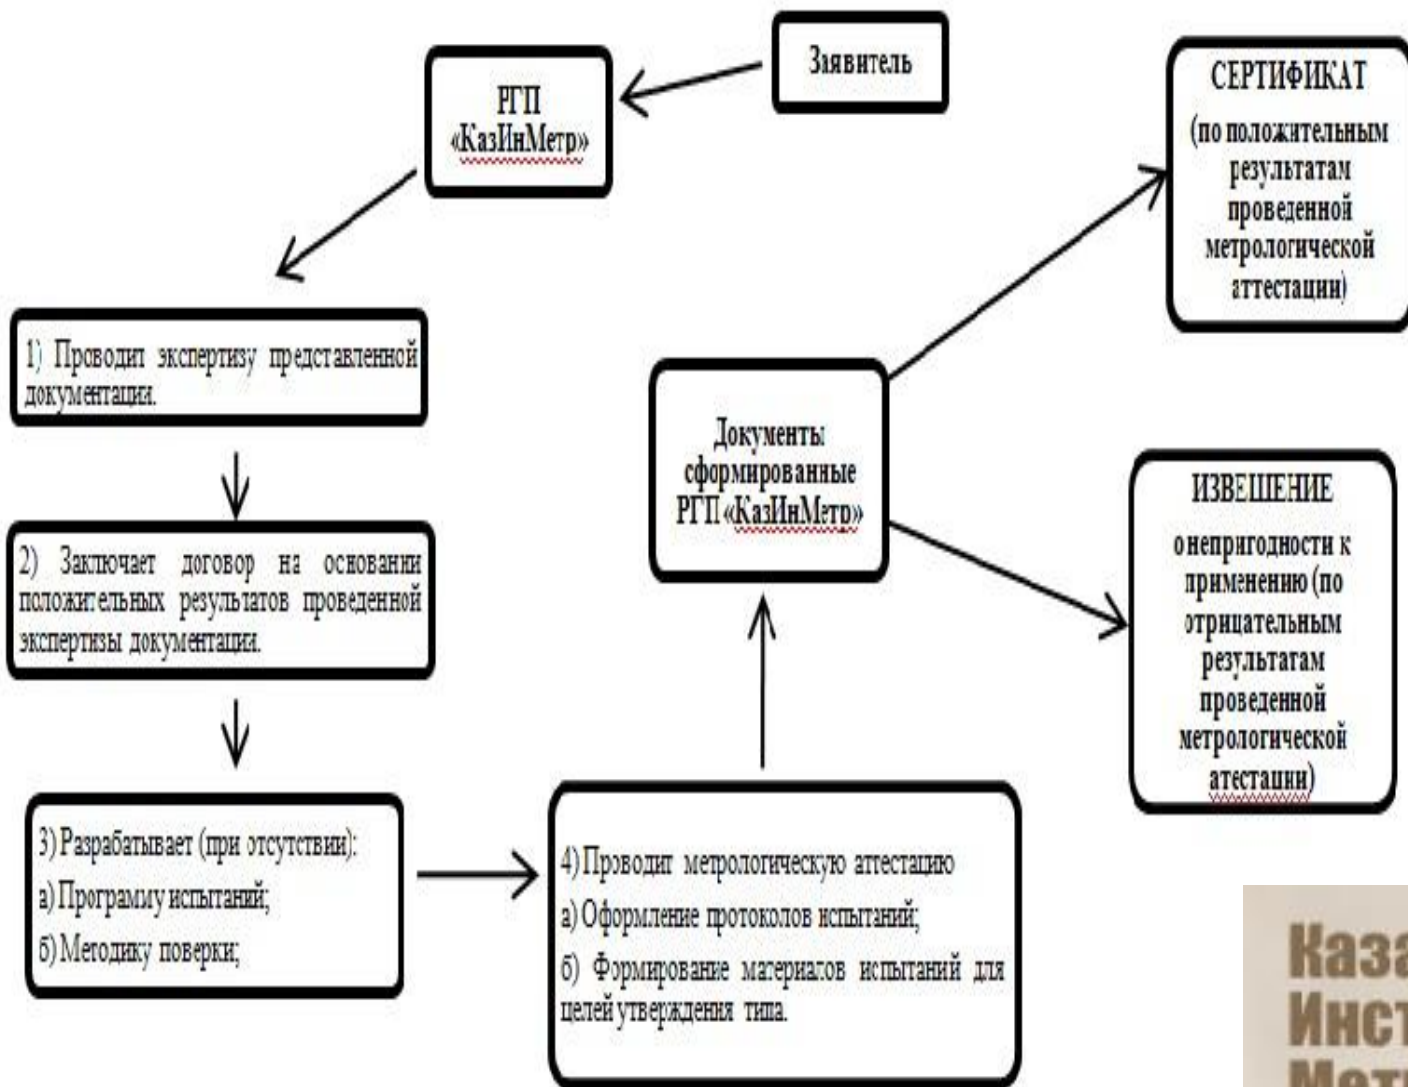

**Казахстанский  
Институт  
Метрологии**  
РГП "КазИнМетр"



# Государственные эталоны :

- ➔ Государственный эталон длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности
- ➔ Государственный эталон единицы избыточного давления-микроманометр переносной ПМКМ-1
- ➔ Государственный эталон единицы электрического напряжения в диапазоне частот 30-1000 МГц
- ➔ Государственный эталон единицы температуры ,диапазон от 962°C до 1769°C
- ➔ Государственный эталон единицы температуры ,диапазон от 0°C до 660,323°C

- ➡ **Государственный эталон единицы абсолютного давления – измерительная поршневая система эталонного грузопоршневого манометра Ruska, мод.2465**
- ➡ **Государственный эталон меры температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР)**
- ➡ **Государственный вторичный эталон единицы длины в диапазоне от 0,1 до 200 мм**
- ➡ **Государственный эталон единицы температуры , диапазон от 77 К до 273,16 К**



# Поверка трехфазных счетчиков

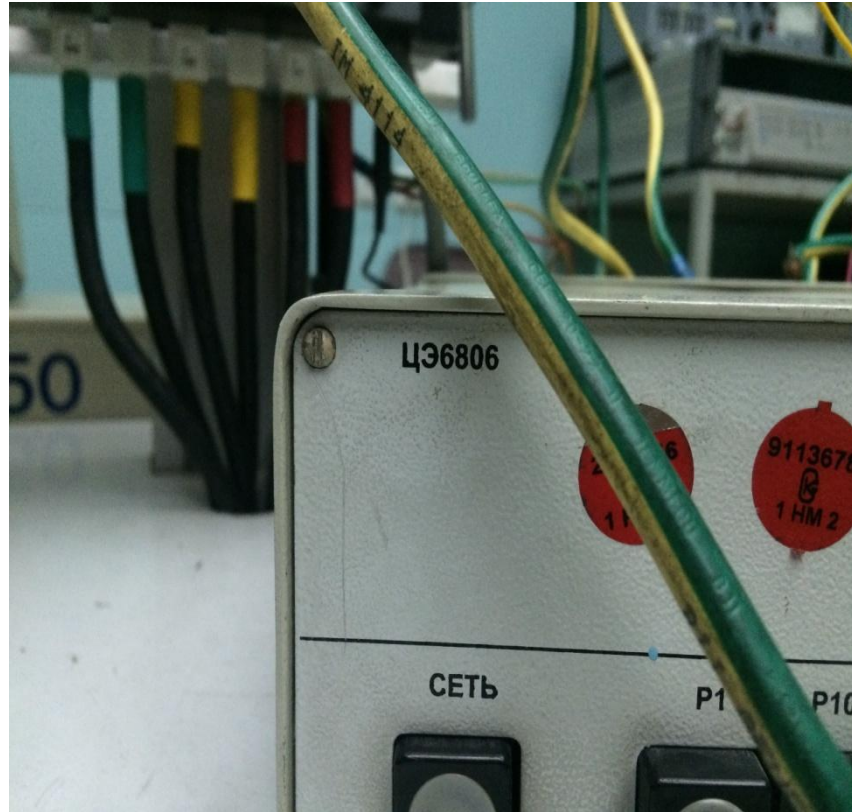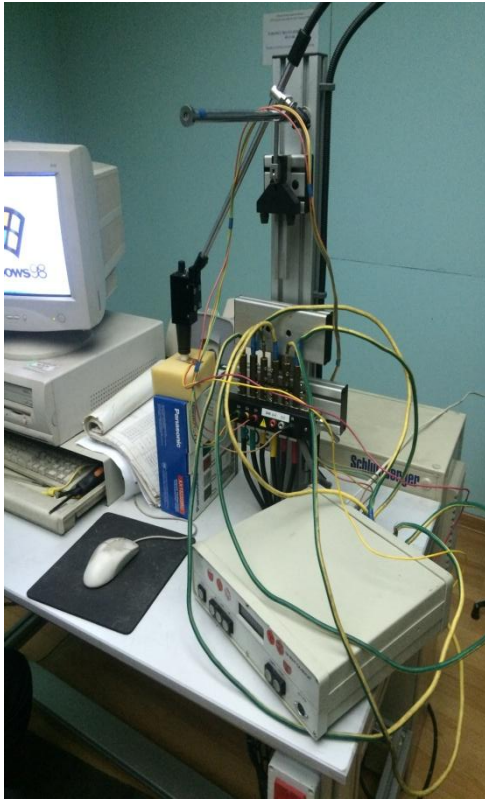


УТВЕЖДАЮ  
директора ФГУП  
"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"  
В.С. Александров  
2002 г.



СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ  
ЦЭ6806  
Методика поверки  
ИНЕС.411152.002 Д1

Руководитель лаборатории  
Государственных эталонов в  
области измерений  
электроэнергетических величин  
Е.З. Шалиро  
2002 г.


Главный инженер  
ОАО "ЗИП Энергомера"  
Б.Н. Тритенко  
"15" ноябрь 2002





6229127-0002

ИЭС 01-00 (029) 001152



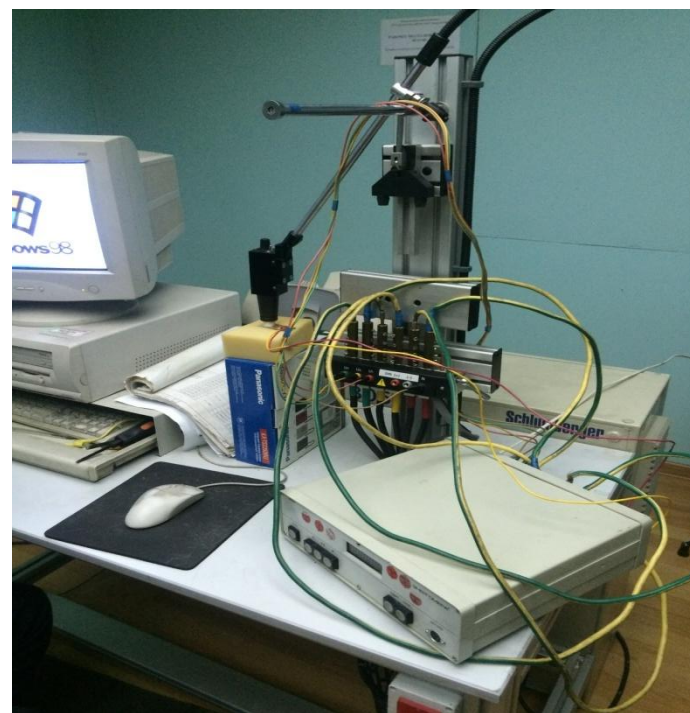

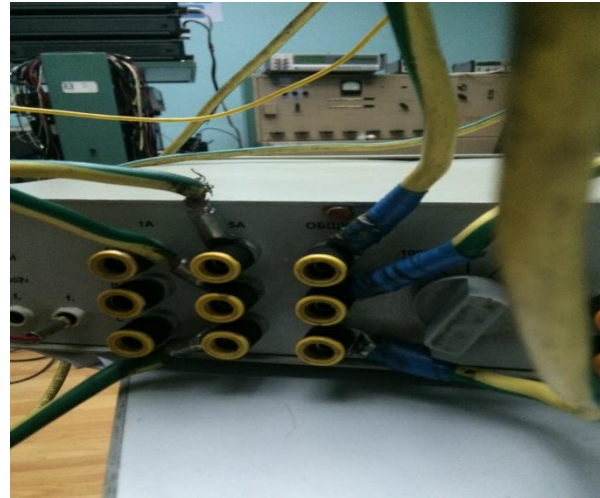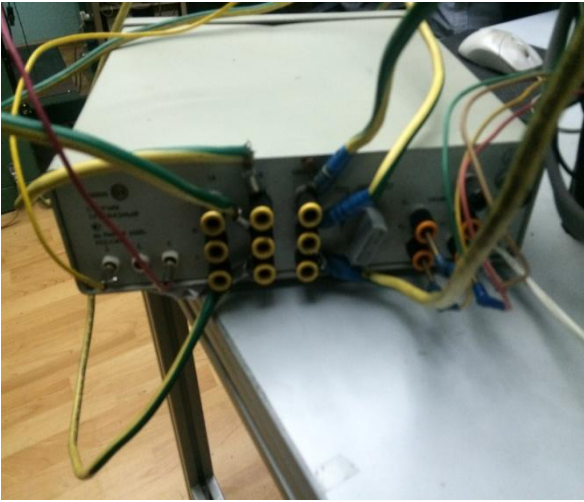





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Оценка соответствия  
СЛОВАРЬ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

СТ РК ИСО/МЭК 17000-2009  
*ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment —  
Vocabulary and general principles (IDT)*

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии  
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан  
(Госстандарт)

Астана



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Основные требования к проведению проверки квалификации

СТ РК ИСО/IEC 17043-2012

*ISO/IEC 17043-2010  
Conformity assessment – General requirements for proficiency testing (IDT).*

Официальное издание

Комитет технического регулирования и метрологии  
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
(Госстандарт)

Астана



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
Государственная система обеспечения единства измерений  
Республики Казахстан

Порядок проведения испытаний и  
утверждения типа средств измерений

СТ РК 2.21-2007

Издание официальное

РГП "КазИнМетр"  
Изменение № 4  
ИУ СТ РК № 11 20 14 г.

РГП "КазИнМетр"  
Изменение № 3  
ИУ СТ РК № 10 20 13 г.

«КазСтИн» РМК Оңтүстік филиалы  
ТЕКСЕРІЛДІ/ПРОВЕРЕН  
«13» 03 2014 ж.  
Қолы

Комитет по техническому регулированию и метрологии  
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

РГП "КазИнМетр"  
Изменение № 2  
ИУ СТ РК № 08 20 12 г.

Астана

РГП "КазИнМетр"  
Изменение № 1  
ИУ СТ РК № 11 20 12 г.

РГП "КазИнМетр"  
Проверен  
- 15 - 05 2015 г.  
Ф.И.О. Шер

РГП "КазИнМетр"  
ОРИГИНАЛ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ  
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СТ РК 2.75-2009

Издание официальное

«КазСтИн» РМК Оңтүстік филиалы  
ТЕКСЕРІЛДІ/ПРОВЕРЕН  
«28» 02 2013 ж.  
Қолы

Комитет по техническому регулированию и метрологии  
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан  
(Госстандарт)

Астана



**Спасибо за  
внимание !!!**

