

**Казахстанский
институт
метрологии**




Размещение эталонов/эталонного оборудования по регионам Казахстана

РГП «КазИНМетр» имеет 5 филиалов в пяти городах страны:



Деятельность РГП «КазИнМетр» как национального метрологического института (NMI)




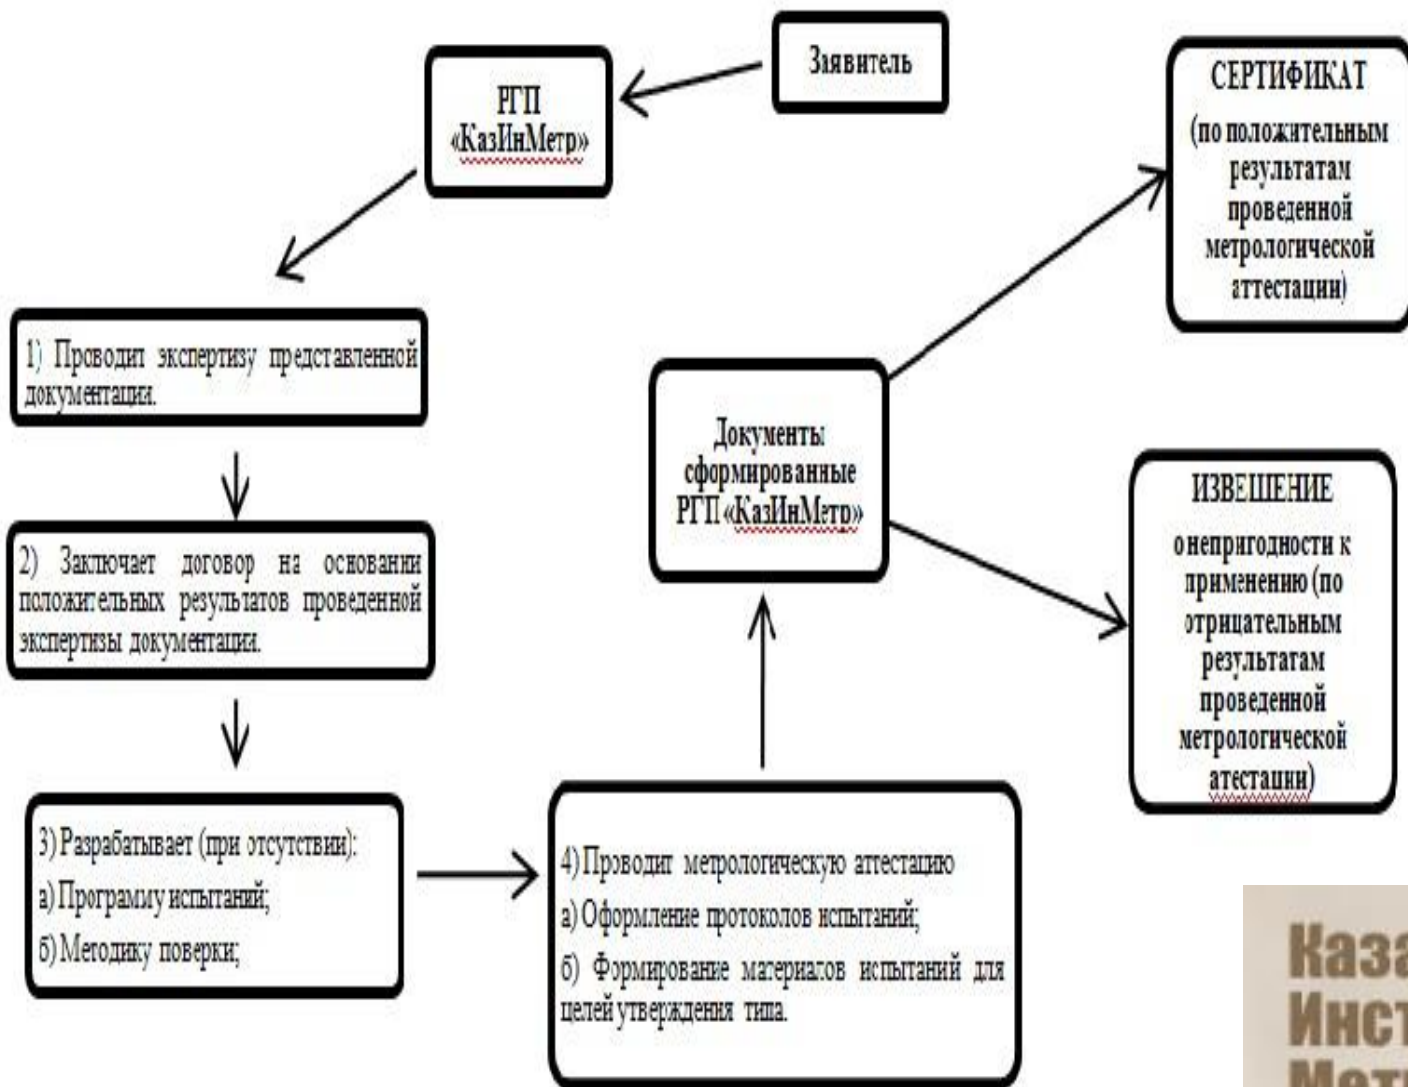


Государственные эталоны :

- ➔ Государственный эталон длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности
- ➔ Государственный эталон единицы избыточного давления-микроманометр переносной ПМКМ-1
- ➔ Государственный эталон единицы электрического напряжения в диапазоне частот 30-1000 МГц
- ➔ Государственный эталон единицы температуры ,диапазон от 962°C до 1769°C
- ➔ Государственный эталон единицы температуры ,диапазон от 0°C до 660,323°C

- ➔ **Государственный эталон единицы абсолютного давления – измерительная поршневая система эталонного грузопоршневого манометра Ruska, мод.2465**
- ➔ **Государственный эталон меры температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР)**
- ➔ **Государственный вторичный эталон единицы длины в диапазоне от 0,1 до 200 мм**
- ➔ **Государственный эталон единицы температуры , диапазон от 77 К до 273,16 К**

Поверка трехфазных счетчиков

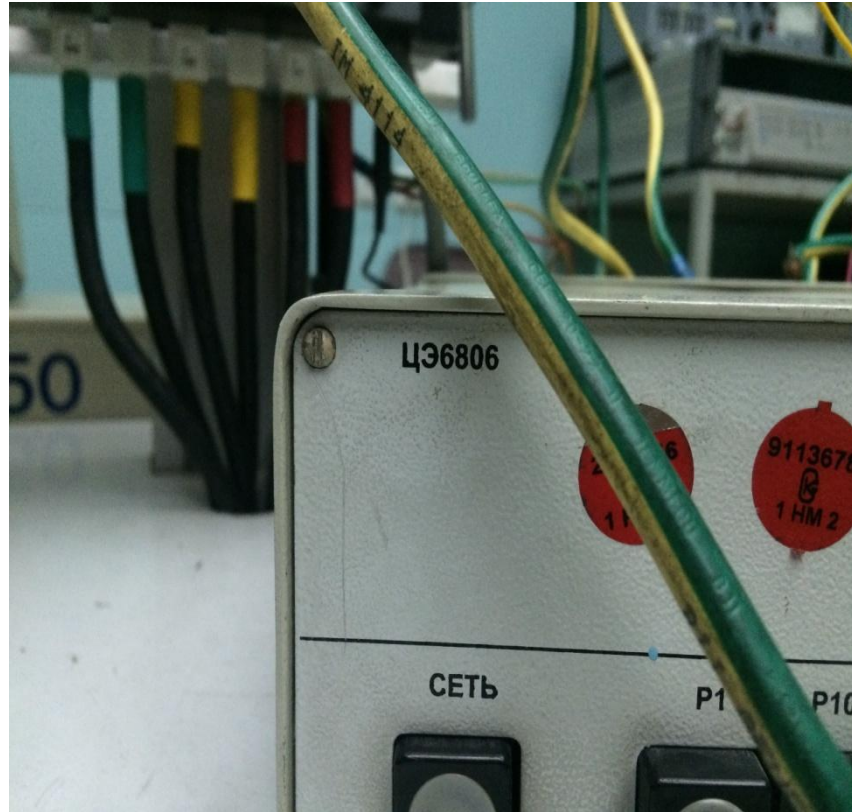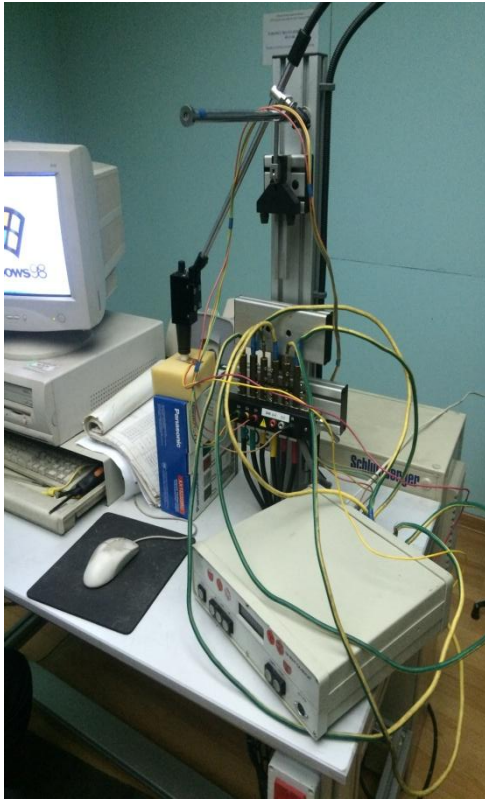


УТВЕРЖДАЮ
директора ФГУП
"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
В.С. Александров
2002 г.



СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ
ЦЭ6806
Методика поверки
ИНЕС.411152.002 Д1


Руководитель лаборатории
Государственных эталонов в
области измерений
электроэнергетических величин
Е.З. Шалиро
2002 г.




Главный инженер
ОАО "ЗИП Энергомера"
Б.Н. Тритенко
"15" ноябрь 2002



6229127-0002

ИДЧ 01-00 (029) 0011152

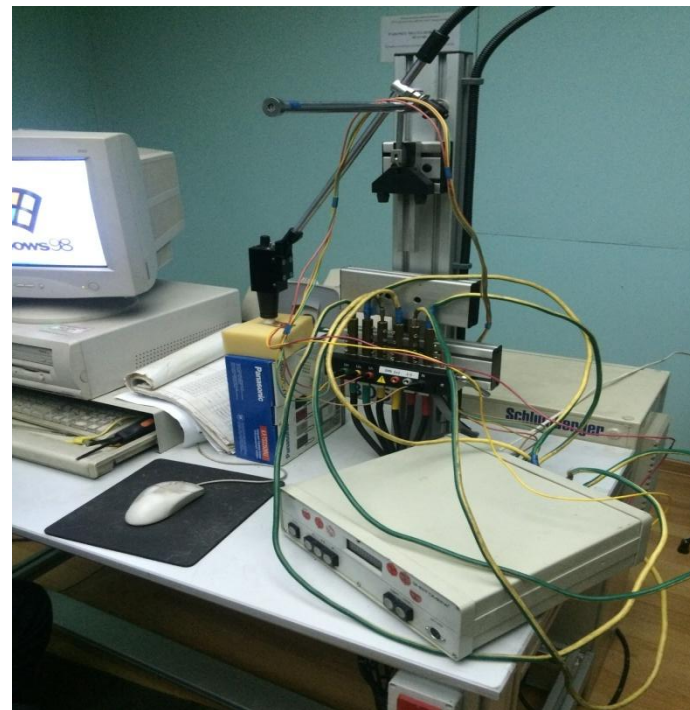

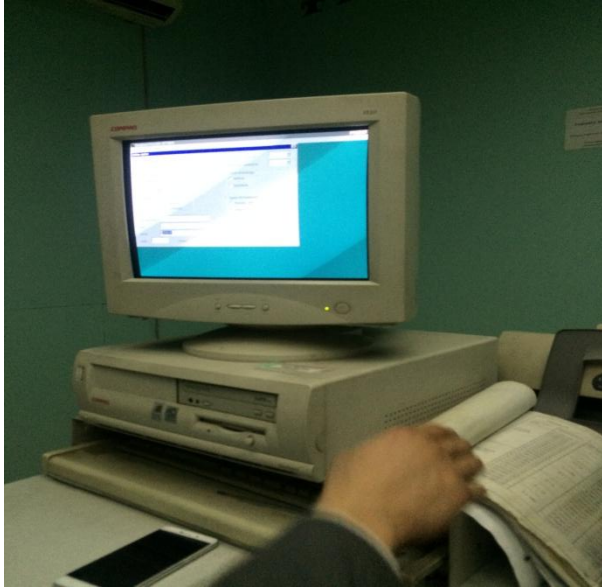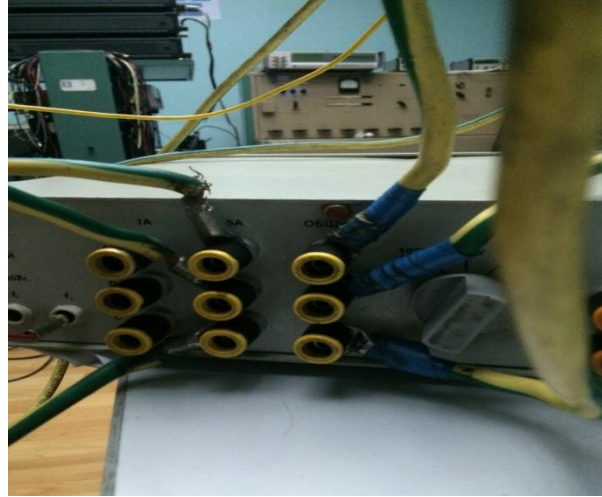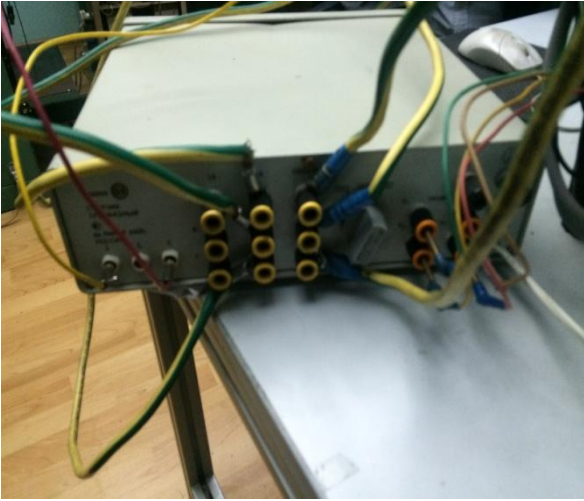



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Оценка соответствия
СЛОВАРЬ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

СТ РК ИСО/МЭК 17000-2009
*ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment —
Vocabulary and general principles (IDT)*

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Основные требования к проведению проверки квалификации

СТ РК ИСО/IEC 17043-2012

*ISO/IEC 17043-2010
Conformity assessment – General requirements for proficiency testing (IDT).*

Официальное издание

Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Государственная система обеспечения единства измерений
Республики Казахстан

Порядок проведения испытаний и
утверждения типа средств измерений

СТ РК 2.21-2007

Издание официальное

РГП "КазИнМетр"
Изменение № 4
ИУ СТ РК № 11 20 14 г.

РГП "КазИнМетр"
Изменение № 3
ИУ СТ РК № 10 20 13 г.

«КазСтИн» РМК Оңтүстік филиалы
ТЕКСЕРІЛДІ/ПРОВЕРЕН
«13» 03 2014 ж.
Қолы

Комитет по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
Астана

РГП "КазИнМетр"
Изменение № 2
ИУ СТ РК № 08 20 12 г.

РГП "КазИнМетр"
Изменение № 1
ИУ СТ РК № 11 20 12 г.

РГП "КазИнМетр"
Проверен
- 15 - 05 2015 г.
Ф.И.О. Шер

РГП "КазИнМетр"
ПРОВЕРЕН
- 18 - 02
Ф.И.О. Шер

РГП "КазИнМетр"
ОРИГИНАЛ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СТ РК 2.75-2009

Издание официальное

«КазСтИн» РМК Оңтүстік филиалы
ТЕКСЕРІЛДІ/ПРОВЕРЕН
«28» 02 2013 ж.
Қолы

Комитет по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана

**Спасибо за
внимание !!!**

