

**Казахстанский
институт
метрологии**




Размещение эталонов/эталонного оборудования по регионам Казахстана

РГП «КазИНМетр» имеет 5 филиалов в пяти городах страны:



Деятельность РГП «КазИнМетр» как национального метрологического института (NMI)



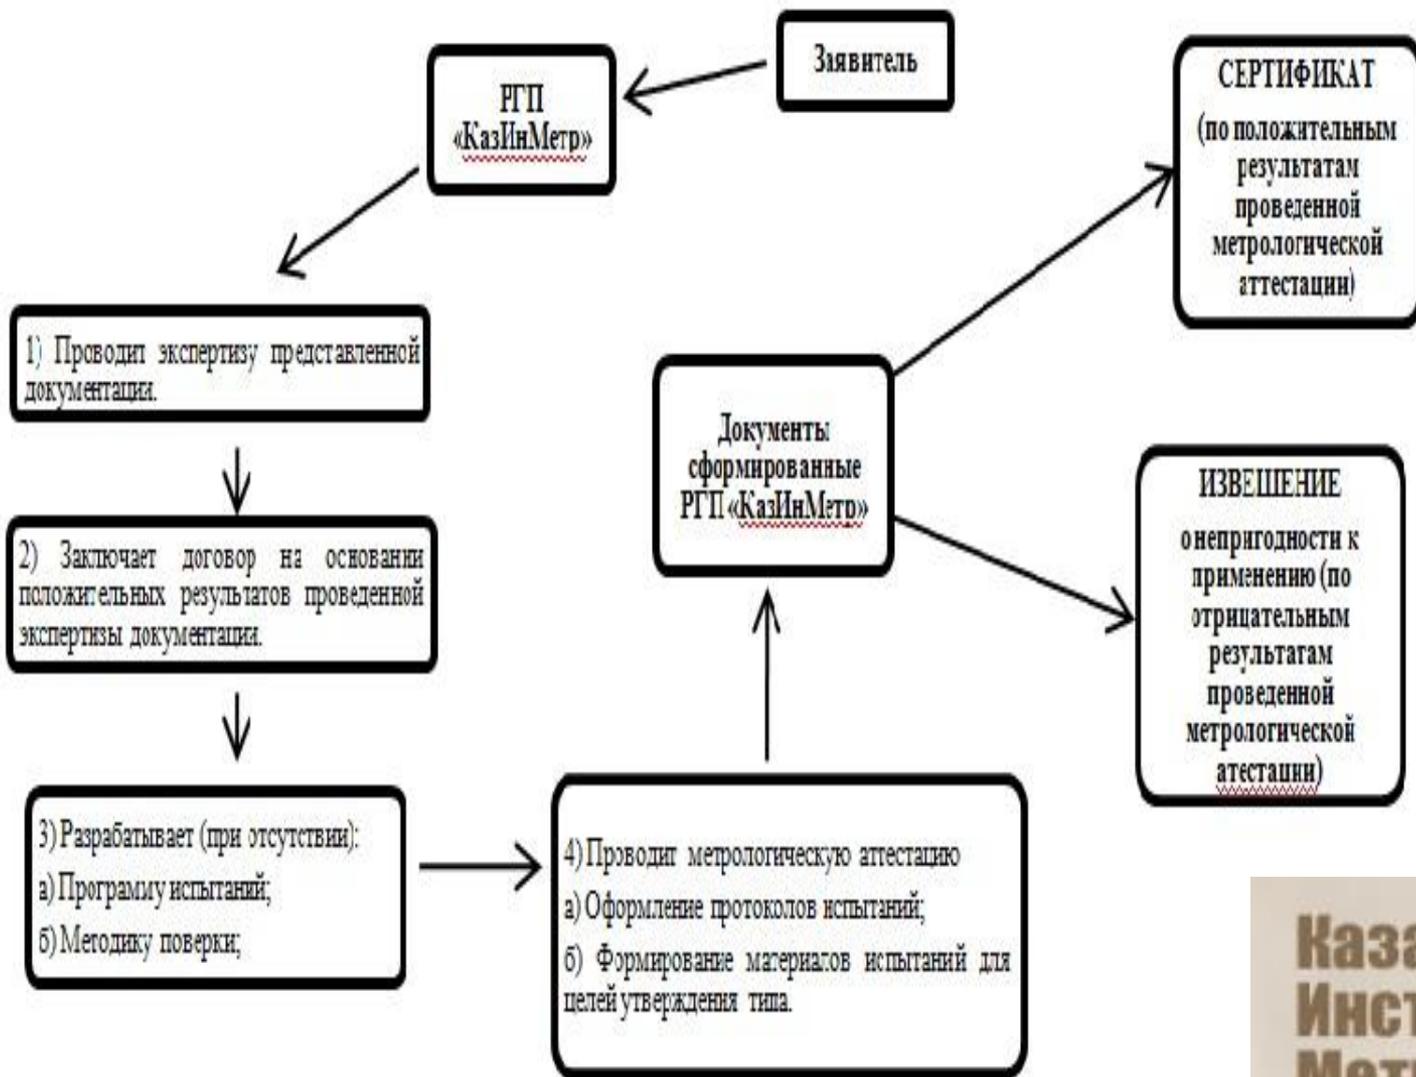


**Казахстанский
Институт
Метрологии**
РГП "КазИнМетр"

Государственные эталоны :

- ➔ Государственный эталон длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности
- ➔ Государственный эталон единицы избыточного давления-микроманометр переносной ПМКМ-1
- ➔ Государственный эталон единицы электрического напряжения в диапазоне частот 30-1000 МГц
- ➔ Государственный эталон единицы температуры ,диапазон от 962°C до 1769°C
- ➔ Государственный эталон единицы температуры ,диапазон от 0°C до 660,323°C

- ➔ **Государственный эталон единицы абсолютного давления – измерительная поршневая система эталонного грузопоршневого манометра Ruska, мод.2465**
- ➔ **Государственный эталон меры температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР)**
- ➔ **Государственный вторичный эталон единицы длины в диапазоне от 0,1 до 200 мм**
- ➔ **Государственный эталон единицы температуры , диапазон от 77 К до 273,16 К**

Поверка трехфазных счетчиков

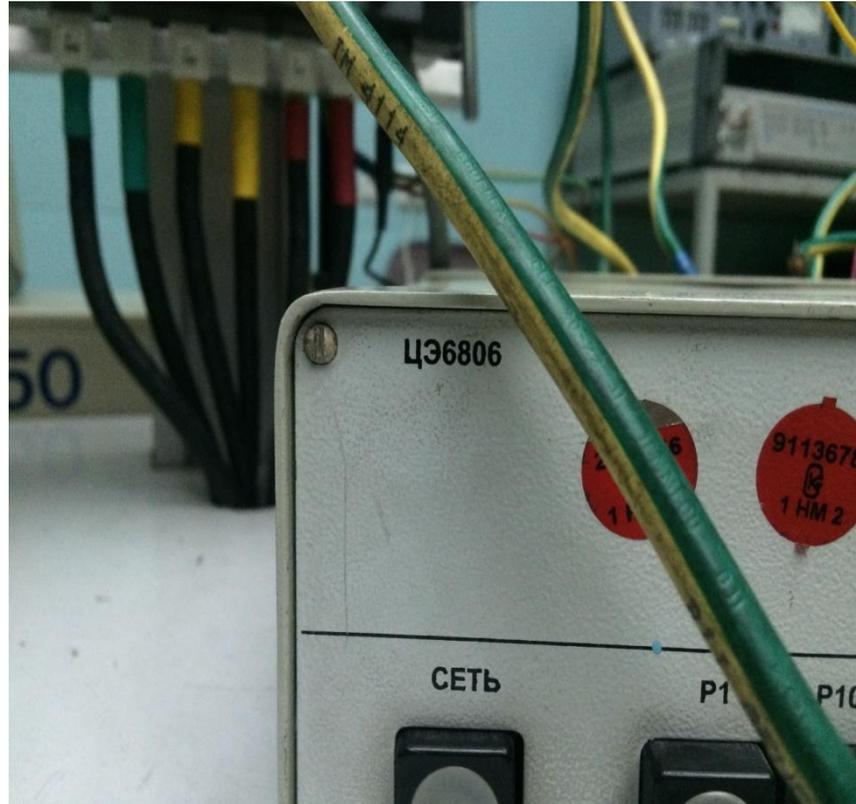

УТВЕЖДАЮ
директора ФГУП
"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
В.С. Александров
2002 г.



СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ
ЦЭ6806
Методика поверки
ИНЕС.411152.002 Д1



Руководитель лаборатории
Государственных эталонов в
области измерений
электроэнергетических величин
Е.З. Шалиро
2002 г.


Главный инженер
ОАО "ЗИП Энергомера"
Б.Н. Тритенко
"15" ноябрь 2002



6229127-0002

ИДЧ 01-00 (029) 0011152

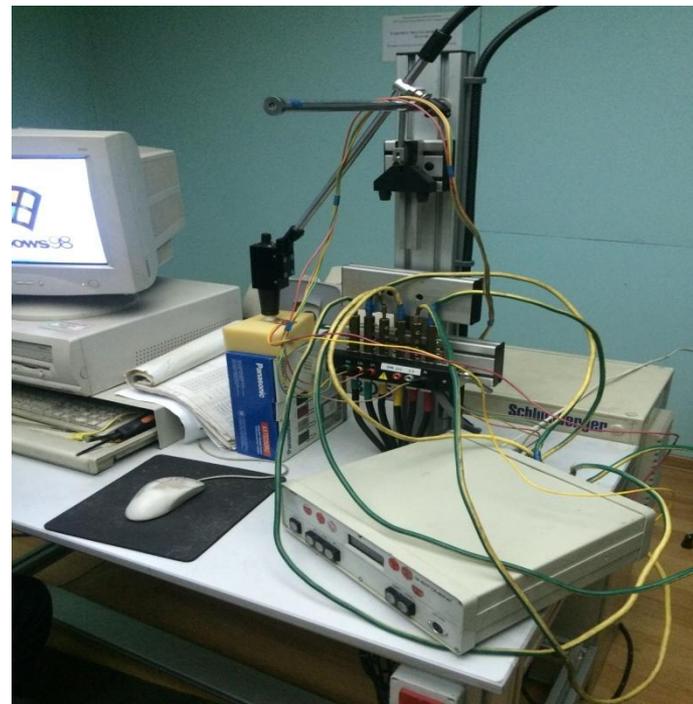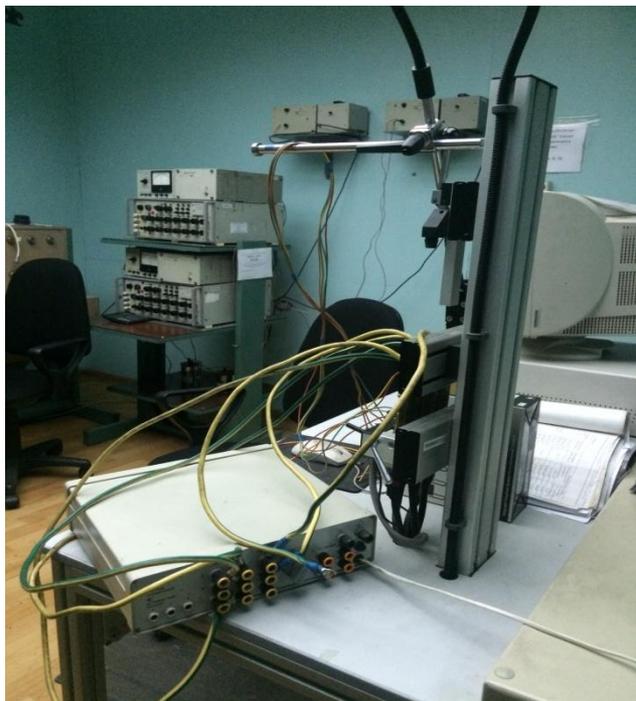

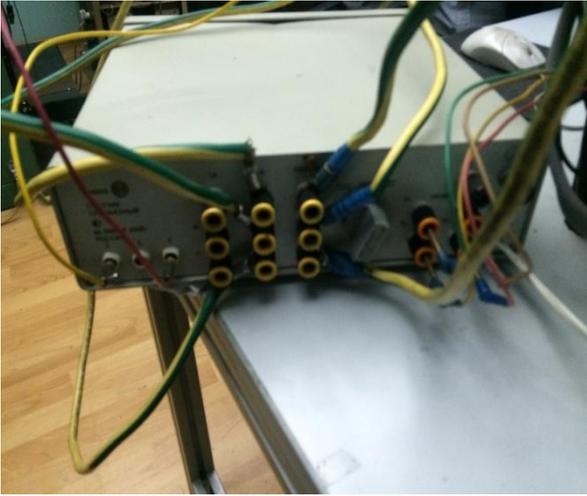



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Оценка соответствия
СЛОВАРЬ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

СТ РК ИСО/МЭК 17000-2009
*ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment —
Vocabulary and general principles (IDT)*

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Основные требования к проведению проверки квалификации

СТ РК ИСО/IEC 17043-2012

*ISO/IEC 17043-2010
Conformity assessment – General requirements for proficiency testing (IDT).*

Официальное издание

Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Государственная система обеспечения единства измерений
Республики Казахстан

Порядок проведения испытаний и
утверждения типа средств измерений

СТ РК 2.21-2007

Издание официальное

РГП "КазИнМетр"
Изменение № 4
ИУ СТ РК № 11 20 14 г.

РГП "КазИнМетр"
Изменение № 3
ИУ СТ РК № 10 20 13 г.

«КазСтИн» РМК Оңтүстік филиалы
ТЕКСЕРІЛДІ/ПРОВЕРЕН
«13» 03 2014 ж.
Қолы

Комитет по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
Астана

РГП "КазИнМетр"
Изменение № 2
ИУ СТ РК № 08 20 12 г.

РГП "КазИнМетр"
Изменение № 1
ИУ СТ РК № 11 20 12 г.

РГП "КазИнМетр"
Проверен
15 05 2015 г.
Ф.И.О. Шер

РГП "КазИнМетр"
ПРОВЕРЕН
18 02
Ф.И.О. Шер

РГП "КазИнМетр"
ОРИГИНАЛ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СТ РК 2.75-2009

Издание официальное

«КазСтИн» РМК Оңтүстік филиалы
ТЕКСЕРІЛДІ/ПРОВЕРЕН
28 02 2013 ж.
Қолы

Комитет по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана

**Спасибо за
внимание !!!**

