THUASNE

VENOFLEX®

Презентация 2017

Wings for your health

План занятия

1 / Патология

2 / Стандарты «ASQUAL» та «RAL»

3 / Серия Venoflex

4 / Аксессуары

Что такое хроническая венозная недостаточность/ХВН?





- ХВН – синдром связанный с нарушением венозного оттока крови, который приводит к дезорганизации микроциркуляции. ХВН напрямую связано с варикозным расширением вен.

- Варикозное расширение вен – расширение поверхностных вен, сопровождающееся нарушением работы венозных клапанов и нарушением кровотока.
- Лимфовенозная недостаточность – нарушение работы лимфосистемы и кровеносных сосудов.
- Симптомы ХВН – отечность ног, тяжесть в ногах, боли в икроножных мышцах, изменения цвета кожных покровов.
- Симптомы Варикоза – боли и тяжесть в ногах, кожный зуд голеней и стоп, появление венозной сетки, выпячивание вен.
- Симптомы лимфовенозной недостаточности – непреходящие отеки ног, даже после длительного отдыха, изменение цвета кожных покровов. Отек охватывает всю конечность. Нарушение трофики вен с дальнейшим возможным развитием трофических язв.

Патология

THUASNE

Факторы провоцирующие развитие ХВН

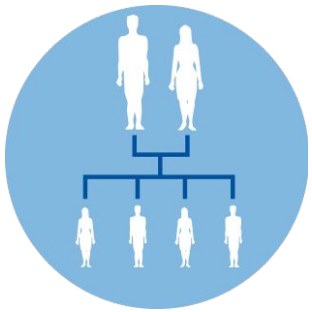

Генетическая предрасположенность

Малоподвижный образ жизни



Влияние высоких температур

Лишний вес

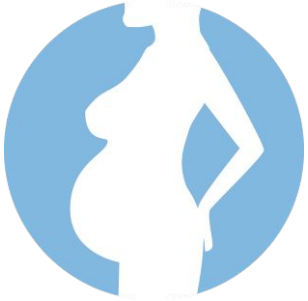

Беременность

CEAP Классификация

THUASNE

Международная классификация хронических заболеваний вен нижних конечностей (CEAP)

Клиническая классификация

C0 - Отсутствие симптомов болезни вен при осмотре и пальпации.
C1 – Телеангиэктазии или ретикулярные вены.
C2 - Расширенные вены.
C3 - Отек.
C4 - Кожные изменения, обусловленные заболеванием вен.
C5 - Кожные изменения, обусловленные заболеванием вен и зашившая язва.
C6 - Кожные изменения, обусловленные заболеванием вен и активная язва

Этиологическая классификация

Ec - Врожденное заболевание.
Ep - Первичное с неизвестной причиной.
Es - Вторичное с известной причиной: посттромботическое, посттравматическое, и т.д.

Анатомическая классификация

As – Поверхностные вены.
Ad – Глубокие вены.
Ap – Повздовжные вены.

Патофизиологическая классификация

PR – Рефлюкс (Обратный ток крови по венам)
PO – Обструкция (Закрытие просвета вены).

C1 : Телеангиэктазии или ретикулярные вены

C2 : Варикозные вены

Телеангиэктазии - стойкое расширение сосудов и подкожных вен диаметром до 1 мм.
Ретикулярные вены –расширенные вены синего цвета диаметром от 1 до 3 мм.

C3 : Отек

C4: Венозная экзема

C5: Зажившая язва

C6: Активная язва

План занятия

1 / Патология

2 / Стандарты «ASQUAL» та «RAL»

3 / Серия Venoflex

4 / Аксессуары

2 основных стандарта: ASQUAL та RAL

Norme	French standard ASQUAL	German standard RAL-GZ 387:2000
Class I	10-15 mmHg	18-21 mmHg
Class II	15-20 mmHg	23-32 mmHg
Class III	20-36 mmHg	34-46 mmHg
Class IV	> 36 mmHg	> 49 mmHg

Правильность подбора класса компрессии

THUASNE

ASQUAL Класс компрессии	RAL Класс компрессии	Классификация CEAP	Симптомы
1	профилактика	C0 C1	✔ синдром «уставших ног» ✔ тяжесть в ногах ✔ незначительное расширение вен ✔ телеангиоэктазии ✔ профилактика при длительном нахождении на ногах ✔ путешествия
2	1	C0 C1 C2 C3	✔ варикозное расширение вен ✔ до- и послеоперационный период ✔ после проведения склеро терапии ✔ нарушение работы вен по время беременности ✔ отеки
3	2	C2 C3 C4 C5	✔ варикозные вены ✔ отеки ✔ послеоперационный период ✔ венозная экзема, пигментация ✔ венозные изменения во время беременности ✔ лимфодема ✔ тромбоз ✔ лечение поверхностных и глубоких вен ✔ тромбоз – лечение и профилактика
4	4	C4 C5	✔ зажившая трофическая язва ✔ лимфодема ✔ лечение и профилактика тромбоза

Лечение

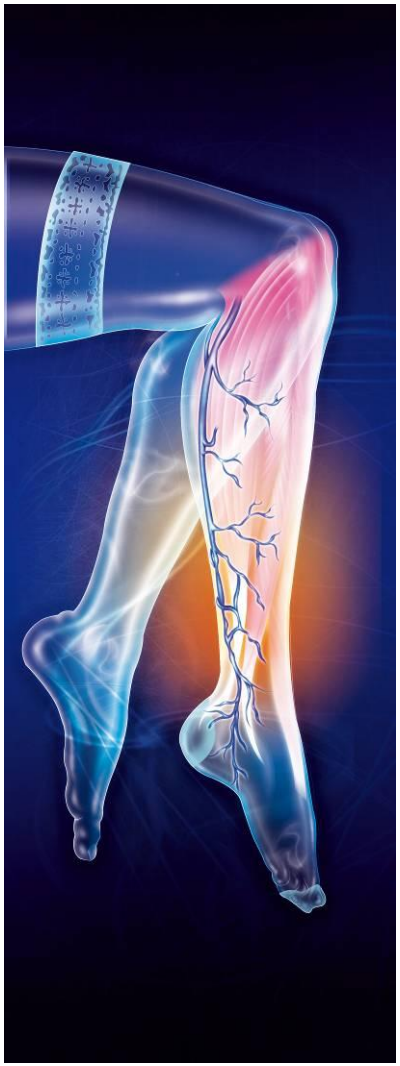

Венотоники – лекарственные средства с выраженным ангио протекторным действием (снижение отечности, улучшение кровообращения, укрепление стенок сосудов, профилактика тромбоза)

Склеротерапия - процедура используется для лечения сосудистых заболеваний. С венозный (сосудистый) просвет вводится препарат, который вызывает склеивание сосуда.

Хирургия – оперативное лечение-удаление пораженных вен.

Лазер – лечение заболеваний с помощью лазерной терапии.

Антиварикозный компрессионный трикотаж - лечение проводиться на всех этапах развития венозной недостаточности.

Принцип действия

Применение внешнего давления, для создания дополнительного каркаса для вены и восстановления работы венозных клапанов.

С действием компрессионного трикотажа

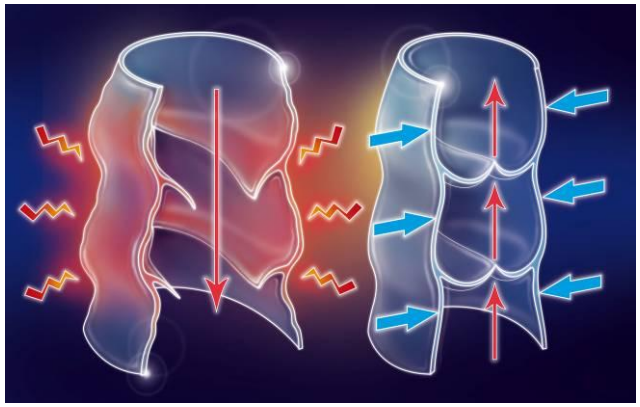

Без действия компрессионного трикотажа

Механизм действия:

- уменьшения диаметра вены
- Ускорение венозного оттока
- уменьшение отечности

План занятия

1 / Патология

2 / Стандарты «ASQUAL» та «RAL»

3 / Серия Venoflex

4 / Аксессуары

Преимущества торговой марки VENOFLEX®

Легко одевать, легко носить анатомическая форма стопы создает идеальное прилегание изделия.

Удобно плоские швы.

Крепость усиленные зоны пятки, сводов и носочной части.

Гигиена антибактериальные материалы

Практичность возможность машинной стирки в деликатном режиме.

Безопасность сертификация Oeko Tex (отсутствие опасных ингредиентов)

Женственность широкая цветовая гамма и ассортимент

Отсутствие передавливания эксклюзивная широкая манжетка на гольфах.

VENOFLEX

THUASNE

Pressure at tigh level vs Anke:

75% for class 1
70% for class 2
60% for class 3
40% for class 4

Ассортимент продукции VENOFLEX

ДЛЯ НЕЁ

Secret®



FAST® LAINE

FAST® COTON

Incognito®

Kokoon®

Simply COTON®

Simply COTON FIN®

Ассортимент продукции VENOFLEX

ДЛЯ НЕГО

Elegance®

City®
Confort Fil d'Ecosse

City®
Confort Coton

FAST® LAINE

FAST® COTON

THUASNE

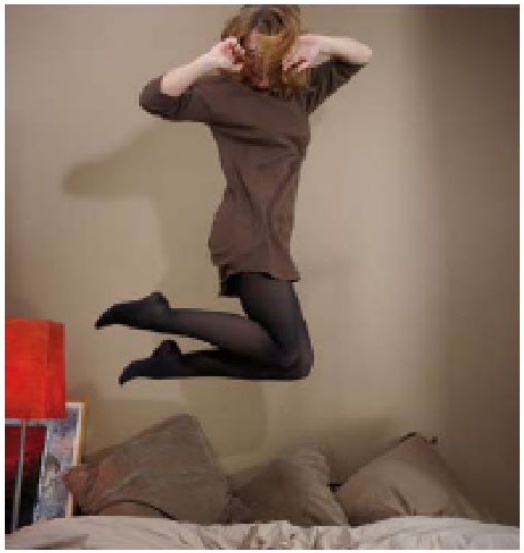

VENOFLEX Kokoon®

Wings for your health

THUASNE

VENOFLEX Kokoon®

мягкость

эластичность

Адаптированность

(6 размеров, 3 высоты: возможность подбора изделия на нестандартную фигуру)

План занятия

1 / Патология

2 / Стандарты «ASQUAL» та «RAL»

3 / Серия Venoflex

4 / Аксессуары

Помощь в одевании изделий БАТЛЕР

THUASNE

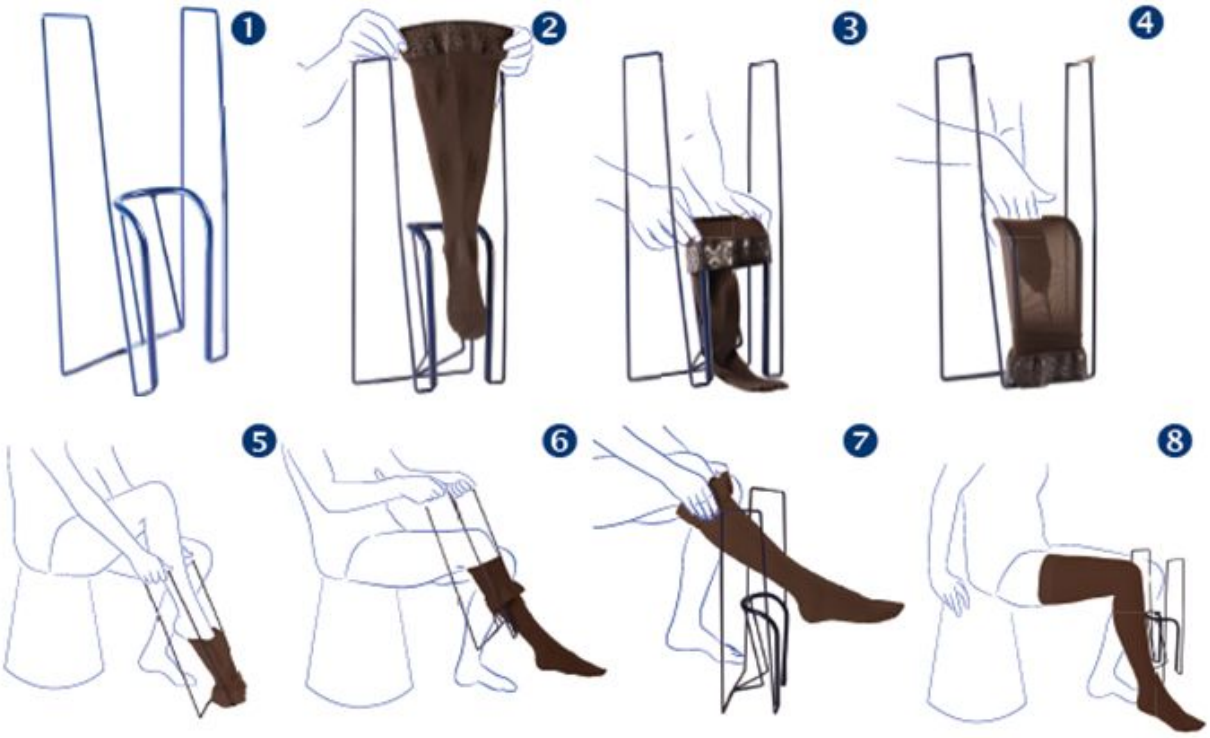

1. Поставте Батлер на твердую поверхность.
2. Расположите изделие по центру дугообразной части батлера так, чтоб пятка была обращена к Вам, а носочная часть - от Вас.
3. Наденьте верхнюю часть трикотажа на Батлер и выверните его наизнанку.
4. Натяните изделие на дугообразную часть до появления пяточной области изделия.
5. Прижмите двумя руками балтер к полу, а ногу просуньте в отверстие так, чтоб пальцы достигли носочной области изделия и стопа встала на пол.
6. Придерживаясь за рамки натяните изделие до колена.
7. Равномерно, не перекручивая, расправте изделие по ноге. Убедитесь, что зона носка и пятки находяться на своих местах.
8. Расправте все неровности и складки.

Brevet depose Patent pending

Носочек для облегчения одевания трикотажа

THUASNE

- **Удобно:** 2 в 1 => для закрытого и открытого типов носка
- **Легко и Компактно :** упаковка с застежкой, которая помещается в карман
- **Практично:** Стирается при 40 ° в стиральной машине

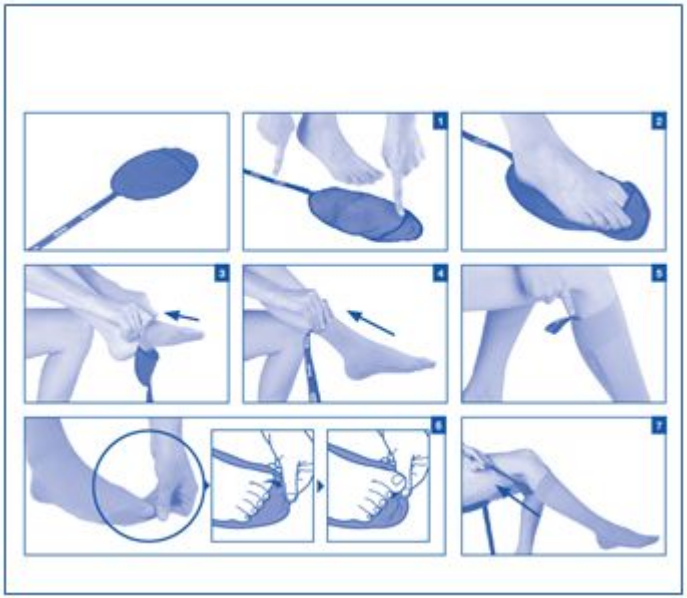

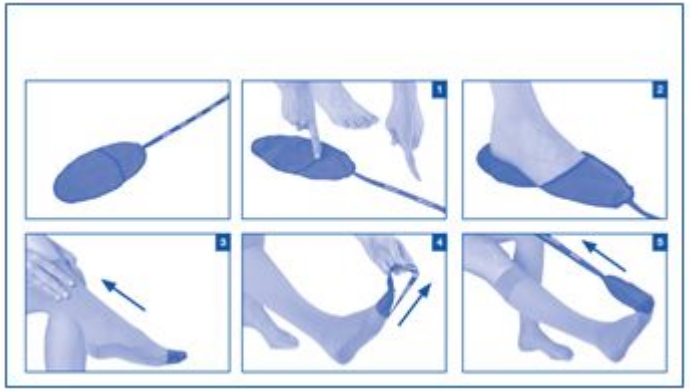

THUASNE

Благодарим За Внимание

Wings for your health