




FloSal

Prostrolane –
мгновенный и яркий результат



Флагман мировых биотехнологий
PROSTROLANE *Natural-B* —

ПЕРВЫЙ ревитализант с филлинговым эффектом
МГНОВЕННОГО И ЯРКОГО ДЕЙСТВИЯ

PROSTROLANE *Natural-B*

IMCAS 2018 в Париже



AMWC 2018 в Монако



PROSTROLANE

FloSal



МГНОВЕННЫЙ
ЭФФЕКТ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

F L O S A L . C O M . U A

Клинические наблюдения PROSTROLANE

50 пациентов

ИССЛЕДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ✓ Лифтинг-эффект;
- ✓ Глубина морщин;
- ✓ Тон кожи, интенсивность сосудистого рисунка (купероз);
- ✓ Плотность кожи;
- ✓ Филлинговый эффект;
- ✓ Эмоциональная удовлетворенность пациентов.

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕРТИФІКАЦІЇ»
04053, м. Київ, Вулиця Гоголя, буд. 7, офіс 320
UA.TR.116



СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ПРОЕКТУ

(пункти 8-11 Додатка 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 (ТР))

Виробник: Caregen Co., Ltd. / Кареген Ко., Лтд.
Юридична адреса: 46-38, Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14119 South Korea / 46-38, Кареген Блдг., ЕлЕс-ро 91 беон-гіл, Донган-гу, Анйанг-сі, Гієнті-до, 14119 Південна Корея

Виробничі площадки: Caregen Co., Ltd. / Кареген Ко., Лтд.
46-38, Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14119 South Korea / 46-38, Кареген Блдг., ЕлЕс-ро 91 беон-гіл, Донган-гу, Анйанг-сі, Гієнті-до, 14119 Південна Корея

Уповноважений представник: ТОВ «СМТ УКРАЇНА»
вул. Яценка, буд. 1, кв. 42, м. Запоріжжя, 69057, Україна

Вироби: Імплантат ін'єкційний для м'яких тканин:
Прострелей Інтер Б СІ.

Присвоєний орган з оцінки відповідності Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науковий інститут сертифікації» (ідентифікаційний номер № UA.TR.116) підтверджує, що проект зазначених виробів відповідає вимогам пунктів 8-11 додатка 3 ТР.

Підстава для видачі:
Акт експертизи документів № PR.6863-18 від 24.09.2018;
Рішення про видачу сертифіката № PR.6864-18 від 25.09.2018.

Сертифікат № PR.587-18
Дійсний до «24» вересня 2023 р.
Видалий № 1. Сертифіковано з 25.09.2018.
Дата реєстрації «25» вересня 2018 р.



В.о. керівника органу з оцінки відповідності
М.А. Вахрушев



Сторінка 1 з 1

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕРТИФІКАЦІЇ»
04053, м. Київ, Вулиця Гоголя, буд. 7, офіс 320
UA.TR.116



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Порядок проведення процедури забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (Додаток 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 (ТР))

Виробник: Caregen Co., Ltd. / Кареген Ко., Лтд.
Юридична адреса: 46-38, Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14119 South Korea / 46-38, Кареген Блдг., ЕлЕс-ро 91 беон-гіл, Донган-гу, Анйанг-сі, Гієнті-до, 14119 Південна Корея

Виробничі площадки: Caregen Co., Ltd. / Кареген Ко., Лтд.
46-38, Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14119 South Korea / 46-38, Кареген Блдг., ЕлЕс-ро 91 беон-гіл, Донган-гу, Анйанг-сі, Гієнті-до, 14119 Південна Корея

Уповноважений представник: ТОВ «СМТ УКРАЇНА»
вул. Яценка, буд. 1, кв. 42, м. Запоріжжя, 69057, Україна

Вироби: Імплантати ін'єкційні для м'яких тканин:
Dermateal CP; Dermateal CE; Dermateal GCP; Dermateal HLL;
Dermateal JLI; Розчин Dermateal під техніку кругів під очима;
Розчин Dermateal від мішок під очима; REVOFIL, Файн;
REVOFIL Плюс; REVOFIL Ультра; REVOFIL Аквашайн;
REVOFIL, Аквашайн БР; AQUASHINE BTX™;
Філлер для волосся Dr.Садж; Прострелей;
Прострелей Неврен Б; Прострелей Інтер Б;
Прострелей Бланк Б; Прострелей Інтер Б СІ.

Присвоєний орган з оцінки відповідності Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науковий інститут сертифікації» (ідентифікаційний номер № UA.TR.116) підтверджує, що зазначений виробник виробів системи управління якістю на етапах розроблення, виробництва та остаточної перевірки стосовно зазначених виробів у відповідності до пунктів 3-7 Додатка 3 ТР та яка є об'єктом періодичних наглядових аудитів згідно пунктів 12-15 Додатка 3 ТР. Для реалізації продукції III класу ризику додатково має бути наданий сертифікат перевірки проекту за пунктами 8-11 Додатка 3 ТР.

Підстава для видачі:
Звіт № PR.687/6-PR.184/ S1/2-18 від 12.07.2018;
Рішення про видачу сертифіката № PR.687/7-18 від 26.09.2018.

Сертифікат № PR.236-17
Дійсний до «17» травня 2022 р.
Видалий № 3. Сертифіковано з 18.05.2017.
Дата реєстрації «26» вересня 2018 р.





В.о. керівника органу з оцінки відповідності
М.А. Вахрушев



Сторінка 1 з 2

FloSal

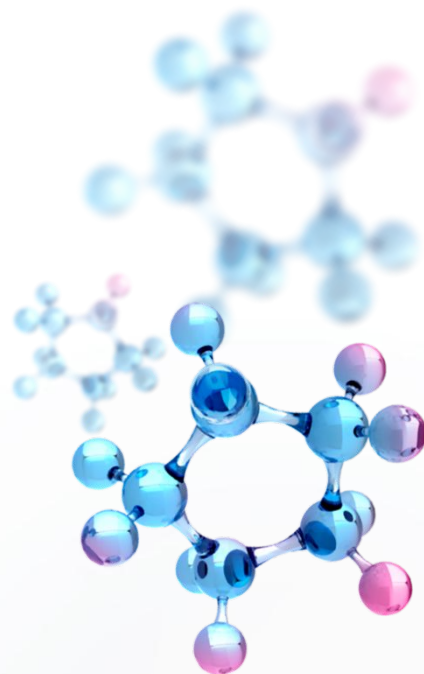



issued in compliance with the Council Directive 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC, which is implemented by the Slovak Government Decree No. 582/2008 Coll. as amended by 215/2013 Coll., certifies that the medical device of Class III.

Dermal Filler:
Prostrolane Natural-B
Prostrolane Blanc-B
Prostrolane Inner-B

manufactured by company

CAREGEN Co., Ltd.

46-38 Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14119,
South Korea

is manufactured under conditions fulfilling the quality system requirements of Annex II, excluding (4), of the Directive 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC.

The Notified Body No. 2265 has performed an audit of the above device quality system. The full quality assurance system has been assessed, approved and is subject to continuous surveillance according to Annex II, Sections 3.3, and 5, of the Directive 93/42/EEC as amended by 2007/17/EC. The detailed description of the system, requirements and measures applied by the manufacturer are presented in the Audit Report No. 310243 and the Final protocol No. 310289/2017 that is enclosed to this certificate.

This certificate is issued under the following conditions:

It applies only to the quality system maintained in the manufacture of the above referenced models of medical devices and it does not substitute the design or type-examination procedures, if requested. The certificate remains valid until the manufacturing conditions or the quality system are changed but until November 28th, 1991 at the latest. The certificate validity is conditional upon positive results of regular surveillance audits and fulfilment of relevant legal and other requirements by manufacturer. For the placing on the market of the above referenced models of medical devices covered by this certificate, an EC design-examination certificate according to the Directive 93/42/EEC as amended by 2007/17/EC, Annex II (4) is required.



In Bratislava, on September 25th, 2017

Received 20 April 2006; accepted 17 May 2006

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕРТИФІКАЦІЇ»
04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, офіс 320
UA-TR-116



Порядок проведення процедури забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (Додаток 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 (ТР))

Виробник: Caregen Co., Ltd. / Кареген Ко., Лтд.
Юридична 46-38, Caregen Bldg., Ls-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do,
адрес: 14119 South Korea / 46-38, Кареген Блдг., ЕлЕс-ро 91 бсон-гіл, Донтан-гу,
 Анянг-сі, Гйентгі-до, 14119 Південна Корея

Виробничі
площадки: Caregen Co., Ltd. / Кареген Ко., Лтд.
46-38, Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14119 **South Korea** / 46-38, Кареген Блдг., ЕлЕс-ро 91 беон-гил, Донган-гу, Анйанг-сі, Гйеонгі-до, 14119 **Південна Корея**

Уповноважений ТОВ «СМТ УКРАЇНА»
представник: вул. Яценка, буд. 1, кв. 42, м. Запоріжжя, 69057, Україна


Вироби: Імплантати іт'скайїні для м'яких тканин:
Dermaheal CP; Dermaheal CS; Dermaheal FCP; Dermaheal ШЛ;
Dermaheal ЛЛ; Розчин Dermaheal від темних кругів під очима;
Розчин Dermaheal від мішків під очима; REVOFIL Файн;
REVOFIL Плюс; REVOFIL Ультра; REVOFIL Аквашайн;
REVOFIL Аквашайн БР; AQUASHINE ВТХ™;
Філер для волосся Др.Сидж; Простролейн;
Простролейн Нечрел Б; Простролейн Іннер Б;
Простролейн Біанк Б; Простролейн Іннер Б СІ.

Призначений орган з оцінки відповідності Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науковий інститут сертифікації» (ідентифікаційний номер № UA.TR.116) підтверджує, що вказаний виробник впровадив систему управління якістю на етапах розроблення, виробництва та остаточної перевірки стосовно зазначених виробів у відповідності до пунктів 3-7 Додатка 3 ТР та яка є об'єктом періодичних наглядових аудитів згідно пунктів 12-15 Додатка 3 ТР. Для реалізації продукції III класу ризику додатково має бути наявний сертифікат перевірки проспекту за пунктами 8-11 Додатка 3 ТР.

Підстава для видачі:

Звіт № PR.687/6-PR.184/ S1/2-18 від 12.07.2018;
Рішення про видачу сертифіката № PR.687/7-18 від 26.09.2018.

Сертифікат № PR.236-17
Дійсний до «17» травня 2022 р.
Видання № 3. Сертифіковано з 18.05.2017.
Дата реєстрації «26» вересня 2018 р.



Сторінка 1 з 2

Эффект PROSTROLANE *Natural-B*



WOW-лифтинг



FLASH-сияние



NATURE-
филлинг



Форма выпуска – шприц 2
мл

PROSTROLANE *Natural-B*



WOW-лифтинг

- ✓ Улучшения овала лица
- ✓ Придание четких контуров



FLASH-сияние

- ✓ Уплотнение кожи
- ✓ Здоровый цвет лица и Pearl glow of the skin
- ✓ Укрепление сосудов, уменьшение купероза



NATURE-филлинг

- ✓ Устранение теневых зон, предающих возраст
- ✓ Уменьшение глубины морщин

PROSTROLANE *Natural-B*


- **Скорость и результат** процедуры **не имеют аналогов!**
- **Всего 2 процедуры** с интервалом в 2 недели для идеального результата!
- **Незаменимая основа** для проведения любых аппаратных и малоинвазивных анти-эйдж методик.







PROSTROLANE Blanc B

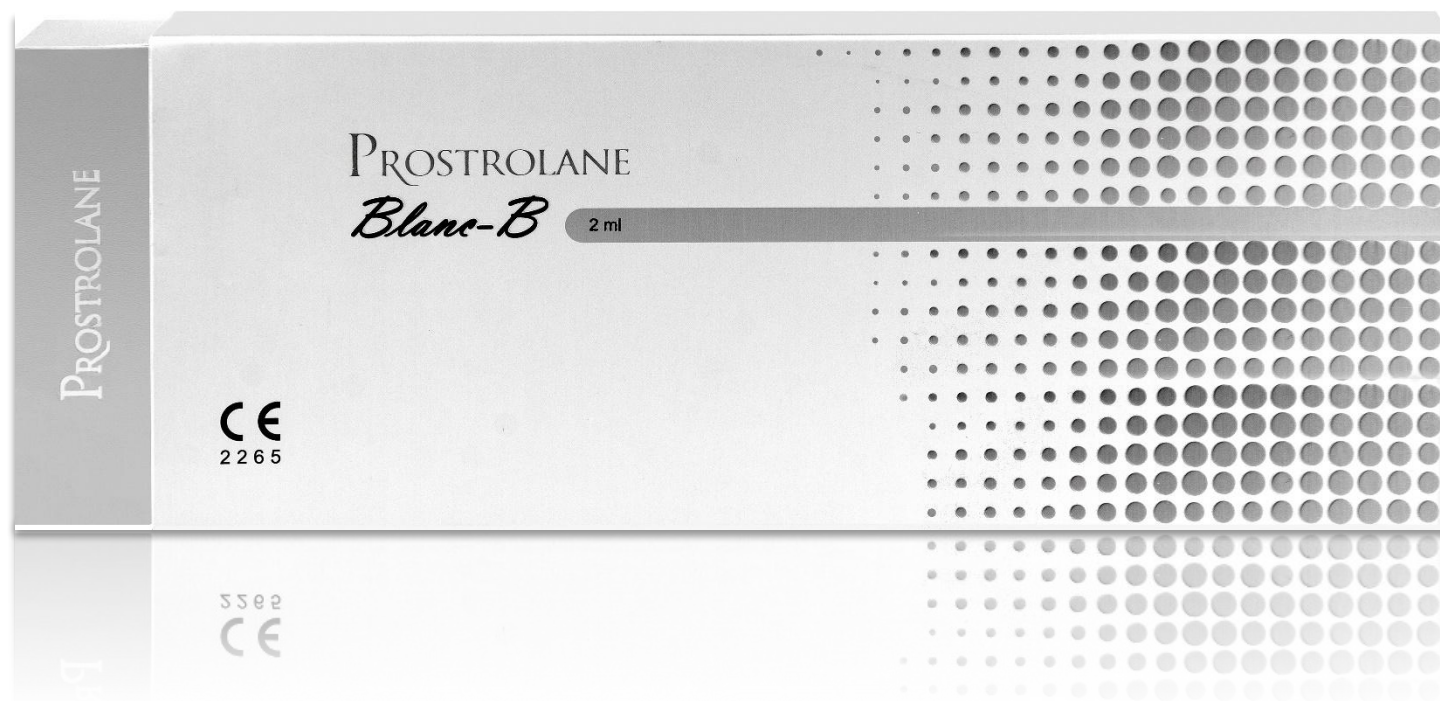

Форма выпуска – шприц 2
мл

Эффекты PROSTROLANE Blanc B




Bright-эффект



Face lift-
эффект



NATURE-
филлинг

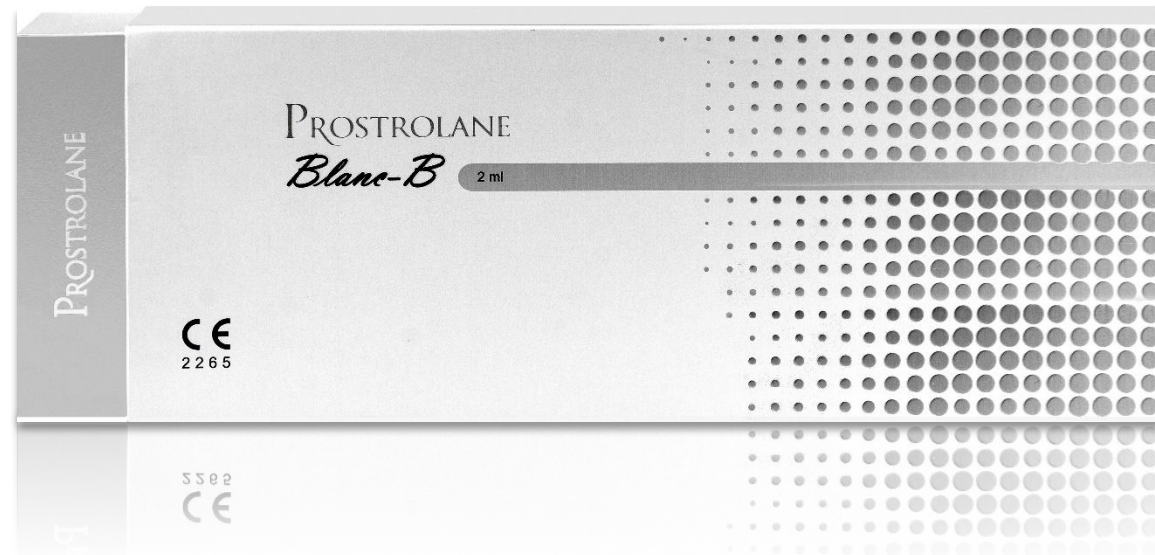

PROSTROLANE *Natural-B*



Bright-эффект

- ✓ Укрепление сосудов, уменьшение купероза
- ✓ Осветление гиперпигментации
- ✓ Здоровый цвет лица и Pearl glow of the skin





Face lift-эффект


- ✓ Уплотнение кожи
- ✓ Улучшения овала лица
- ✓ Придание четких контуров



NATURE-филлинг

- ✓ Устранение теневых зон, предающих возраст
- ✓ Уменьшение глубины морщин

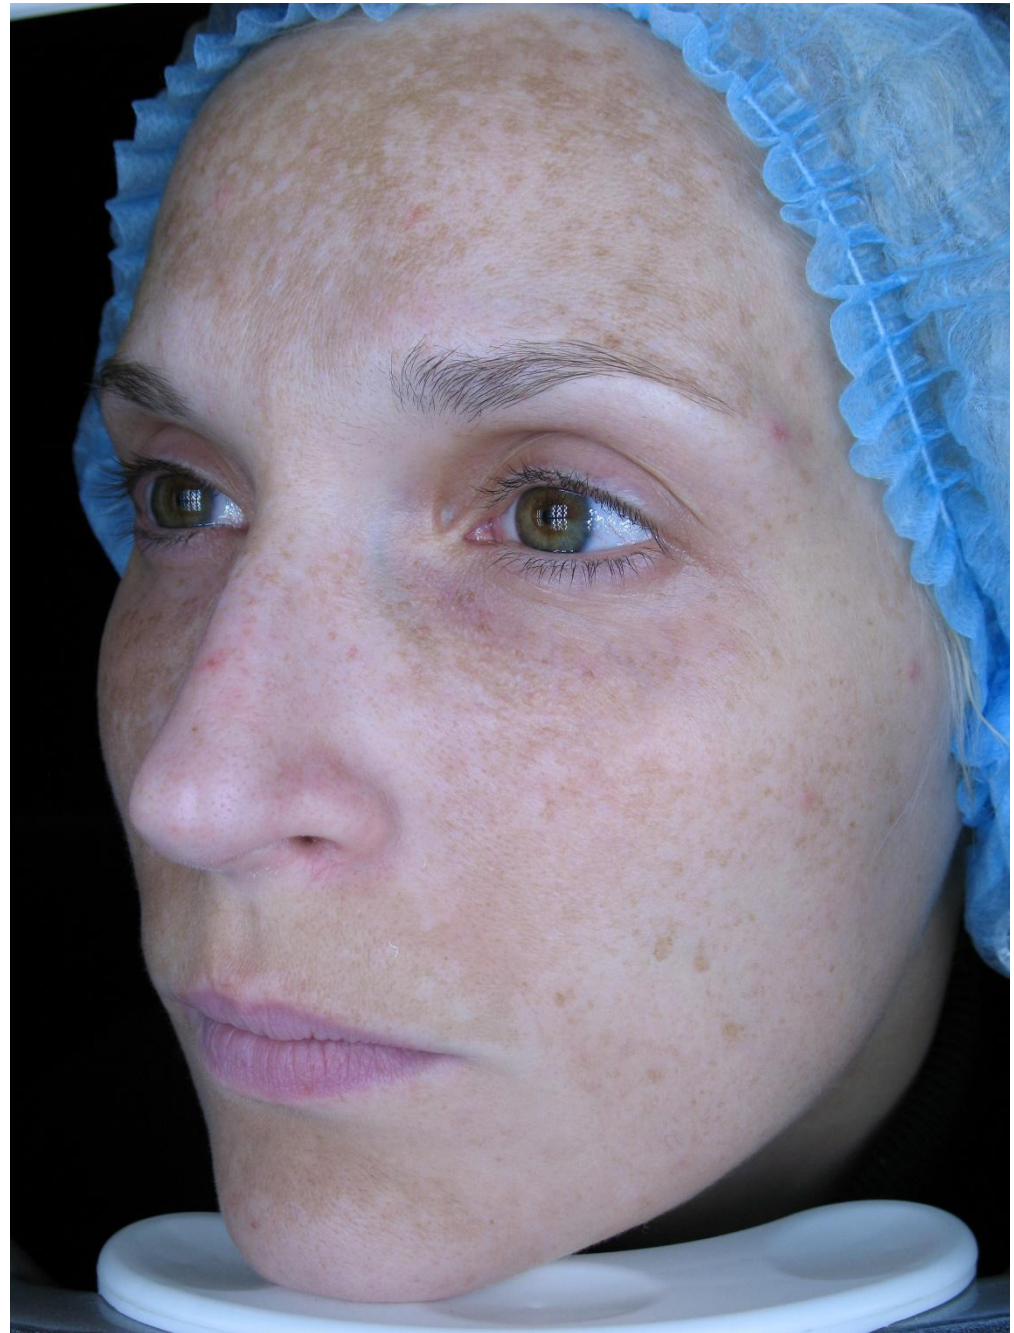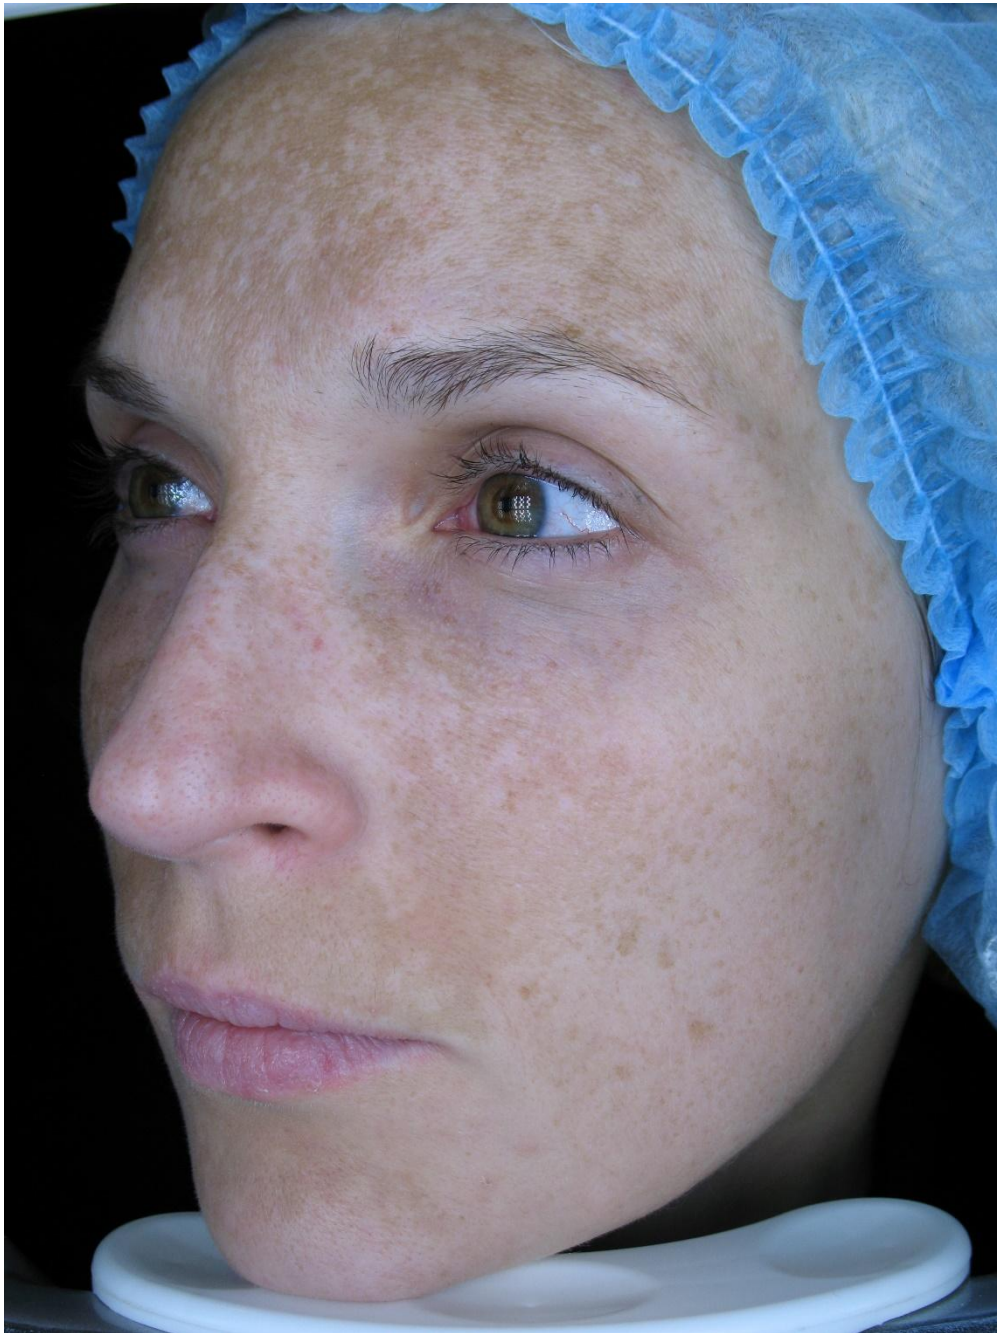

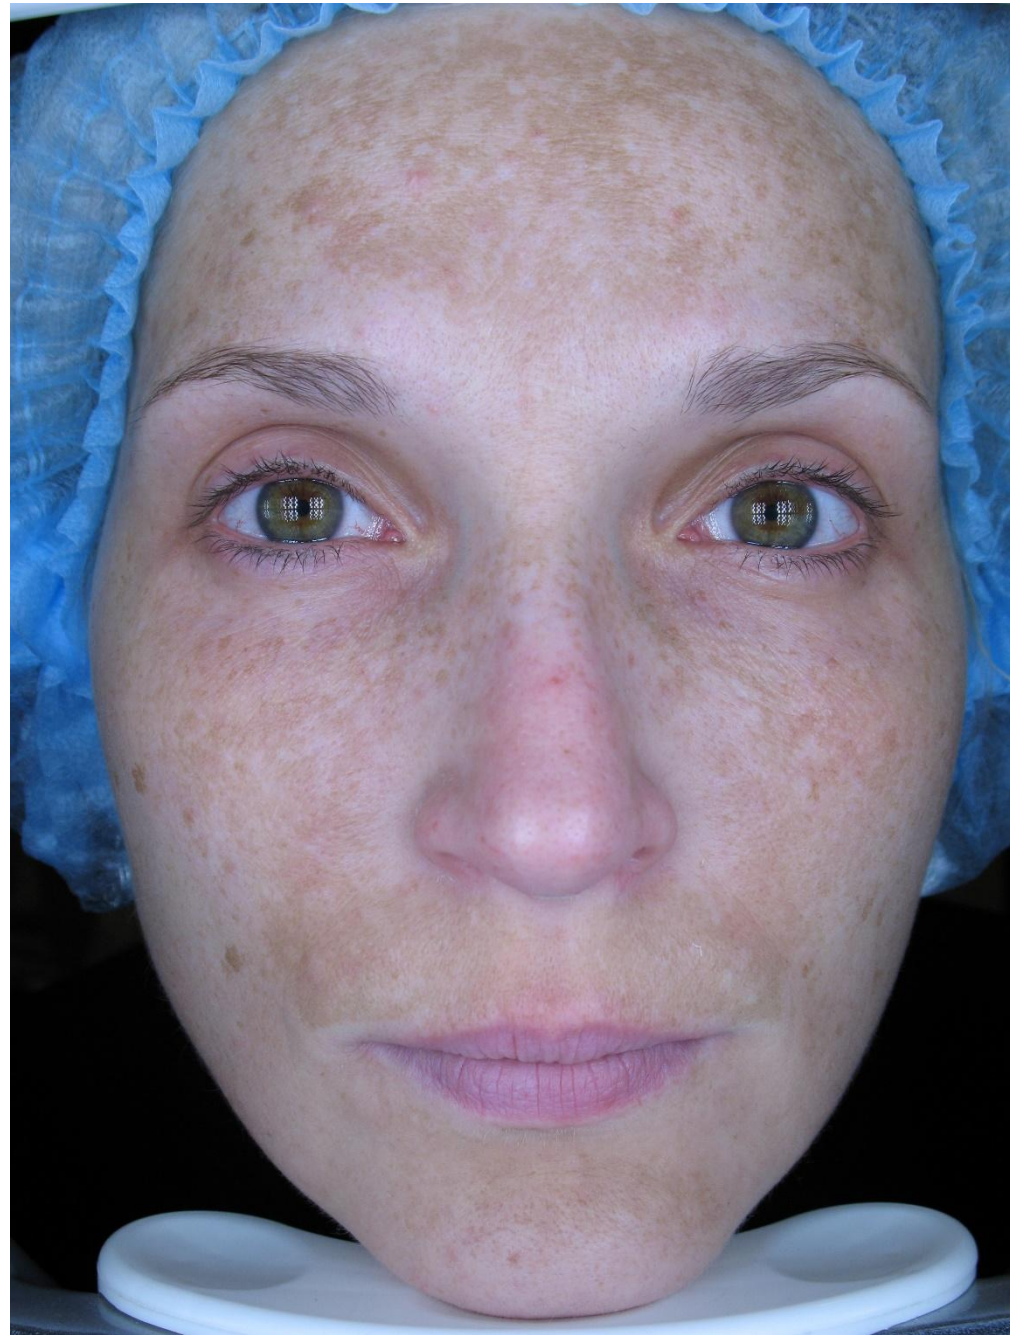


Prostrolane Inner B



Prostrolane Inner B

Fat reduction-эффект

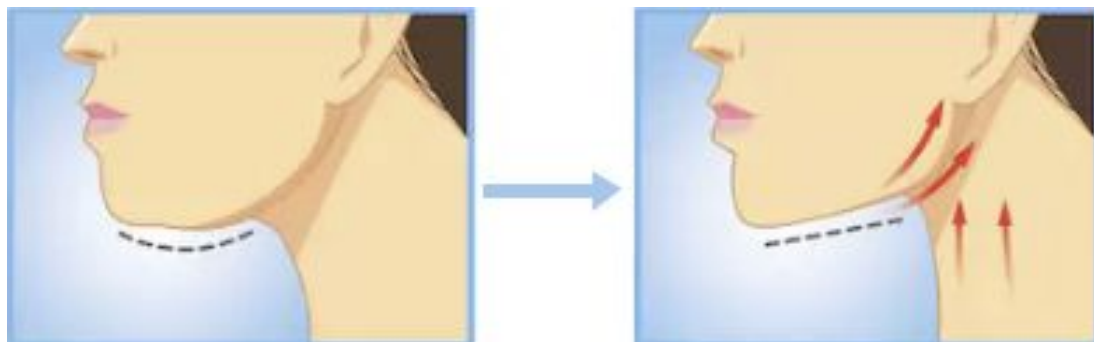


Face lift-эффект



Форма выпуска – шприц 2
мл

ЛИПОМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЦА

Prostrolane Inner B

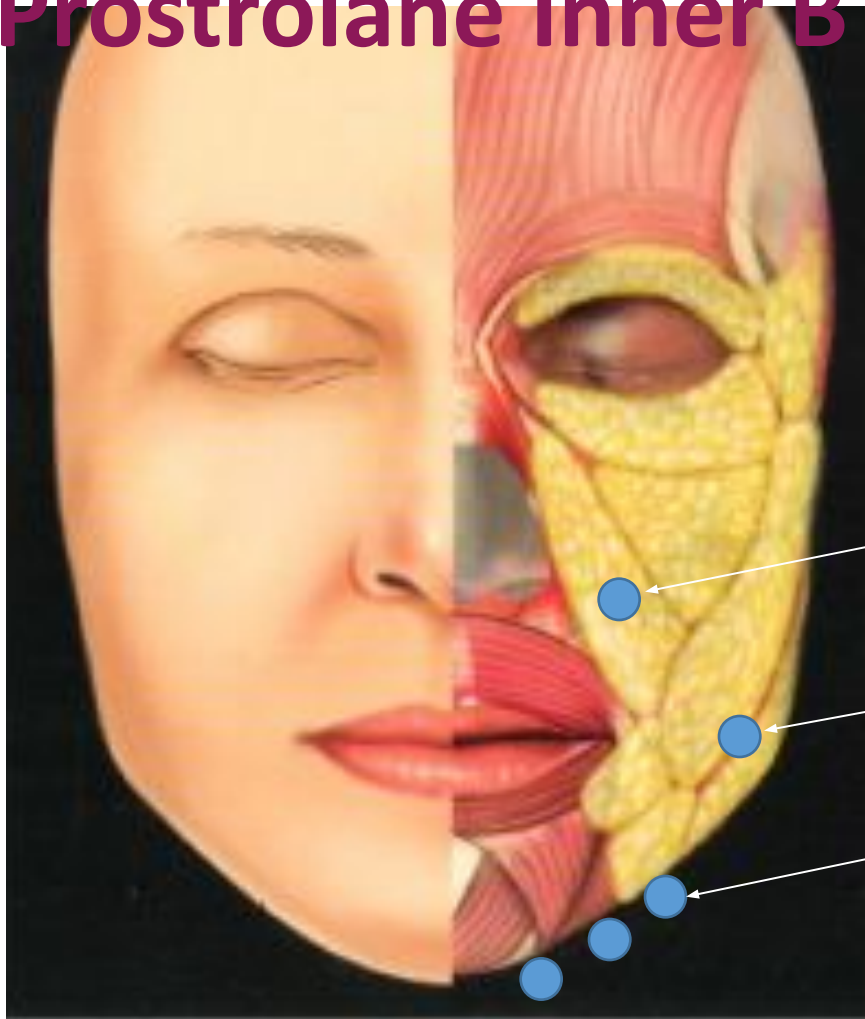


0,3-0,5 мл

0,5-1 мл

2 мл



ДО

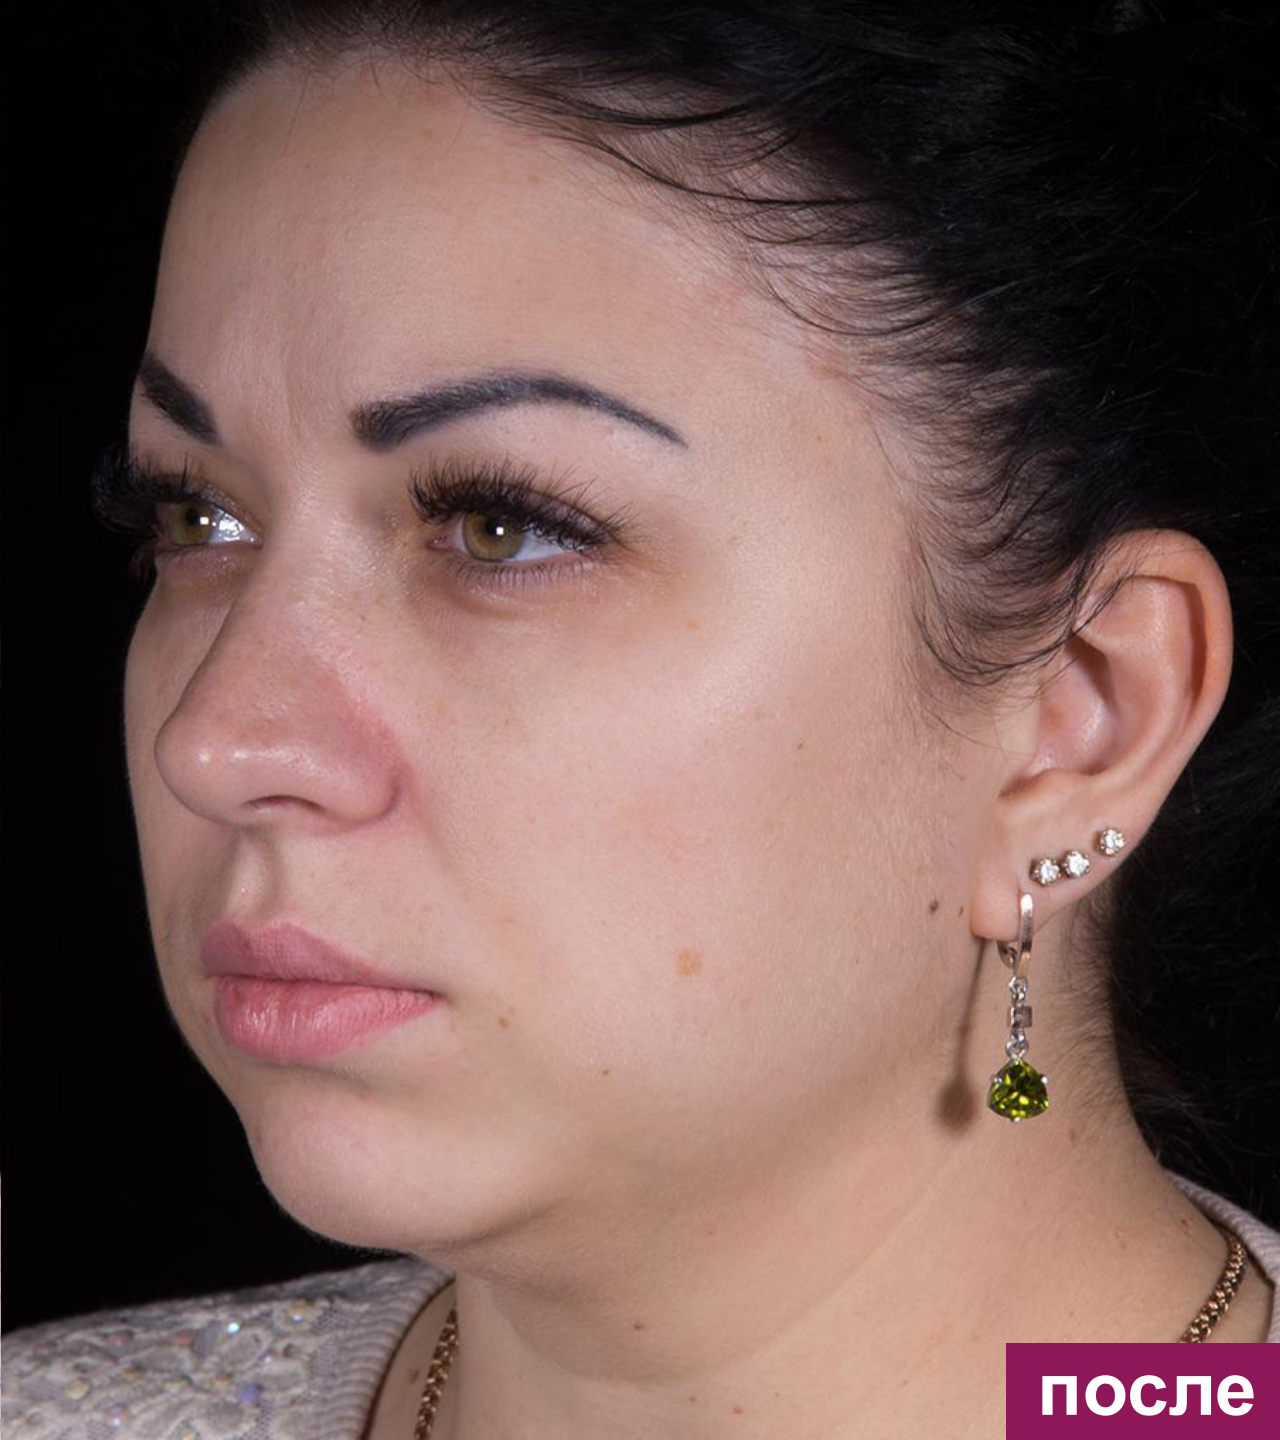

ПОСЛЕ



до



после