OMNICAM 2.0 VS PRIMESCAN

Маланина
Виктория

кандидат медицинских наук,
руководитель стоматологической клиники
«ДенталЭлит», г.Минск

02.10.2021 Минск

ДенталЭлит

Dentsply Sirona

1
КАБИНЕТ

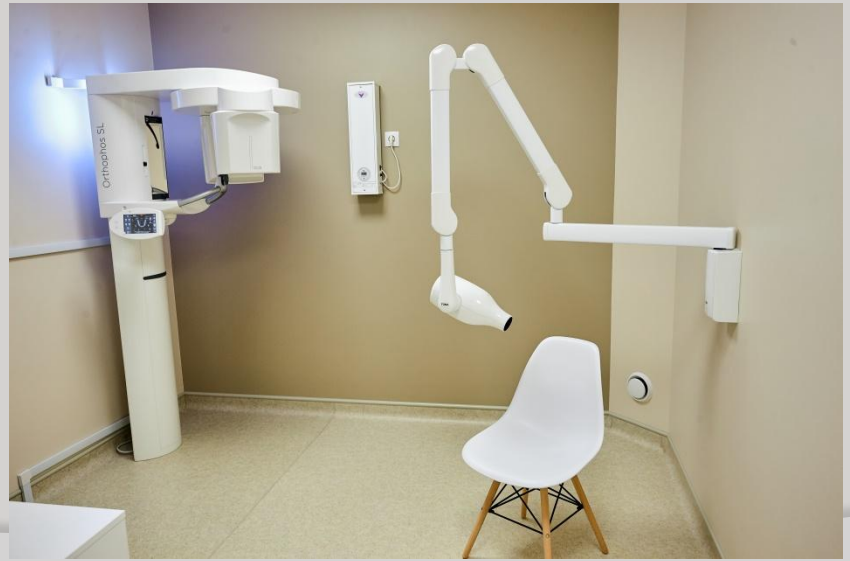
Orthophos SL

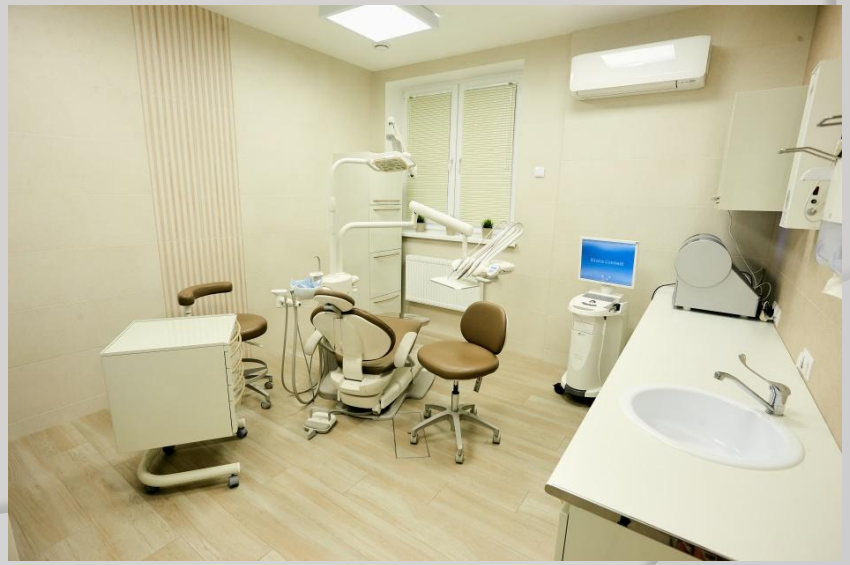

2013

XX МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ИСКУССТВЕ РЕСТАВРАЦИИ ЗУБОВ

Prisma® ЧЕМПИОНАТ 2013

Виктория
КИРИЛОВА
/ Беларусь/

УЧАСТНИК
Международного финала
XX соревнований
в искусстве реставрации зубов
Призма-чемпионат-2013

ДИПЛОМ

Профессор Таиса Скрипникова

DENTSPLY ДентАрт
Украинская медицинская стоматологическая академия
Фирма Дентсплай Лтд (Великобритания)
Издательство ДентАрт

Генеральный спонсор DENTSPLY
Официальный спонсор Oral-B

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
Д 03.18.05 при учреждении образования "Белорусский государственный медицинский университет"
от 7 апреля 2020 г. (протокол № 4)

Манатиной
Виктории Игоревне
ПРИСУЖДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
КАНДИДАТА
медицинских наук

Председатель совета по защите диссертаций Г.Г.Кондратенко
Ученый секретарь совета по защите диссертаций Н.В.Шаковец
КН 009867
г. Минск
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

2015-2020

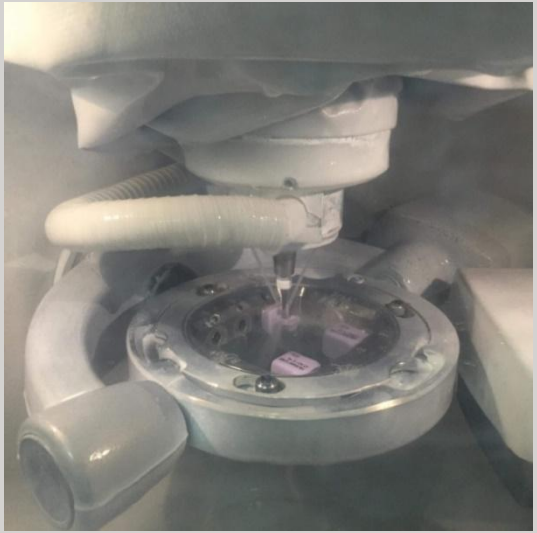

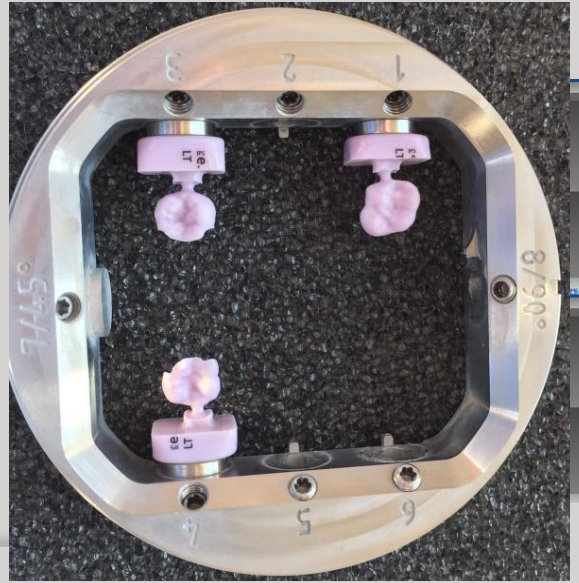

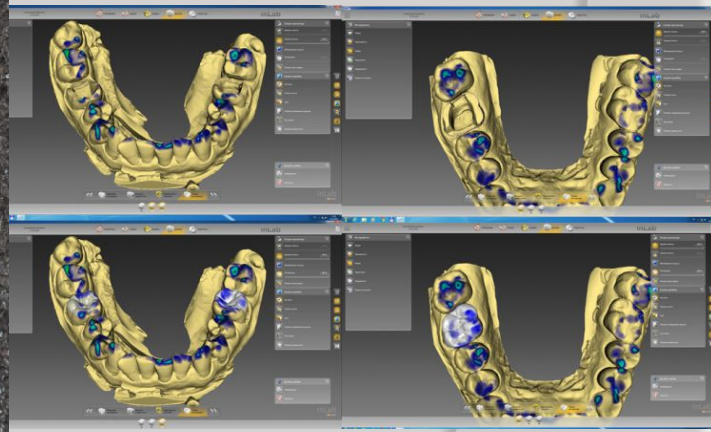

inLab MC XL

inLab
DELL

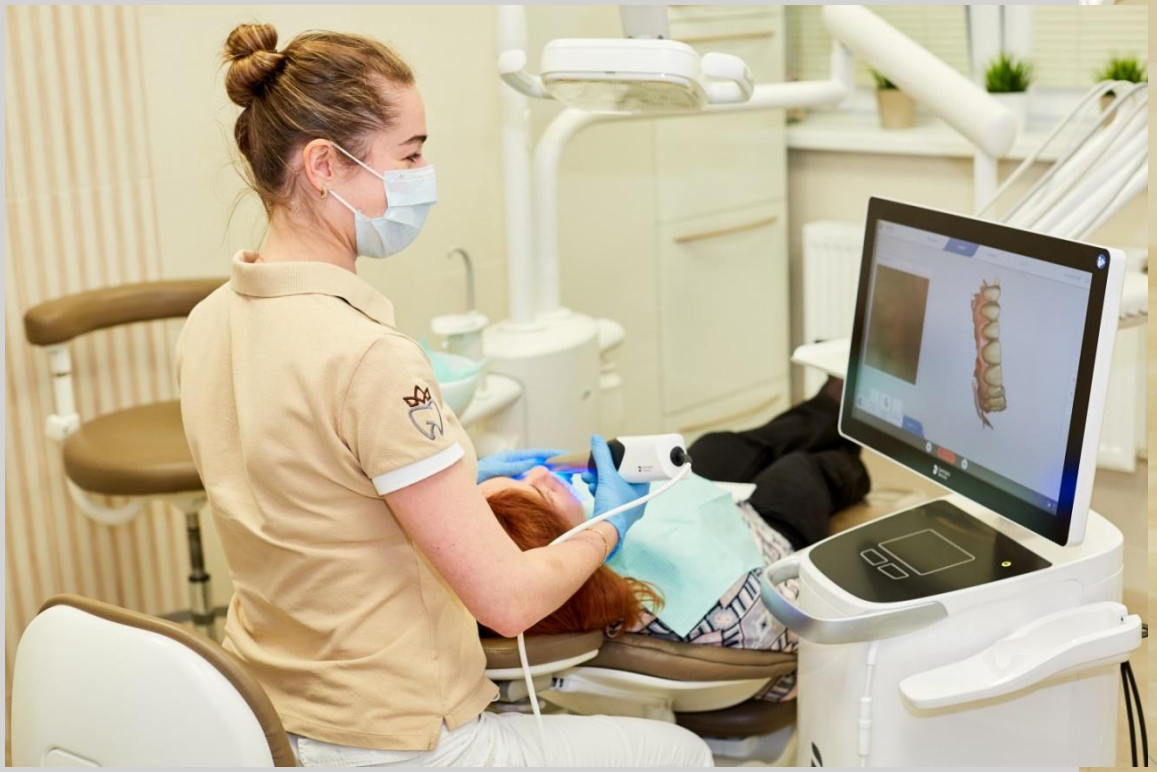

Из чего состоит система Cerec?

- Сканирующее устройство
- Компьютер с программным обеспечением
- Шлифовально-фрезерный аппарат
- Печь для индивидуализации

(при необходимости)

СКАНЕР

- Bluecam
- Omnicam
- Primescan

InEos X5

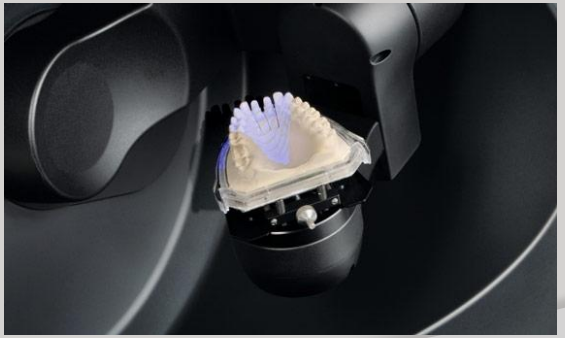

Фрезерный аппарат

CEREC Primemill

Программное обеспечение

CEREC

InLab

Cerec SpeedFire

Варианты комплектов оборудования для работы в CAD/CAM

Для клиники

Для лаборатории

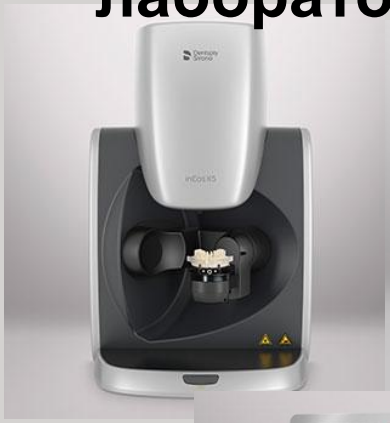

Преимущества цифровой стоматологии для врача и пациента:

- Быстро
- Точно
- Комфортно
- Предсказуемо

Материлы для CAD/CAM

- Полевошпатная керамика (vita mark II, cerec blocks)
- Дисиликат лития (e.max Cad, vita suprinity)
- Композитные материалы (tetric CAD, Brilliant Crios)
- PMMA (vita CAD-temp, Telio Cad)
- Диоксид циркония

Primescan
VS
Omnicam 2.0

Primescan

Точность

Сканирование с исключительной точностью: инновационный интеллектуальный датчик Smart Pixel Sensor и технология динамического глубокого сканирования обеспечивают высокую резкость даже при сканировании областей до 20 мм глубиной

Удобство использования

Простота сканирования всех уже имеющихся реставраций и труднодоступных областей: увеличенное поле обзора мгновенно и точно визуализирует крупные области при меньшем количестве проходов

Скорость

Ускоренное сканирование с плавным процессом сканирования: консолидация более 50 000 изображений в секунду и быстрая обработка именно тех данных, которые необходимы программному обеспечению

Возможности сетевого взаимодействия

Ускорьте свой рабочий процесс: благодаря бесперебойным, проверенным и открытым возможностям передачи данных, лаборатории и иные третьи стороны мгновенно получают модели с высоким разрешением

Гигиеническая безопасность

Возьмите инфекцию под контроль: выбирайте одну из трех насадок для сканера, включая автоклавируемые и одноразовые насадки

Новый блок для съемки

Интеллектуальные функции и повышенный комфорт: интуитивно понятное управление при помощи подвижного сенсорного экрана 16:9 и сенсорной панели для обеспечения эргономичной работы.

Активац
Чтобы акти

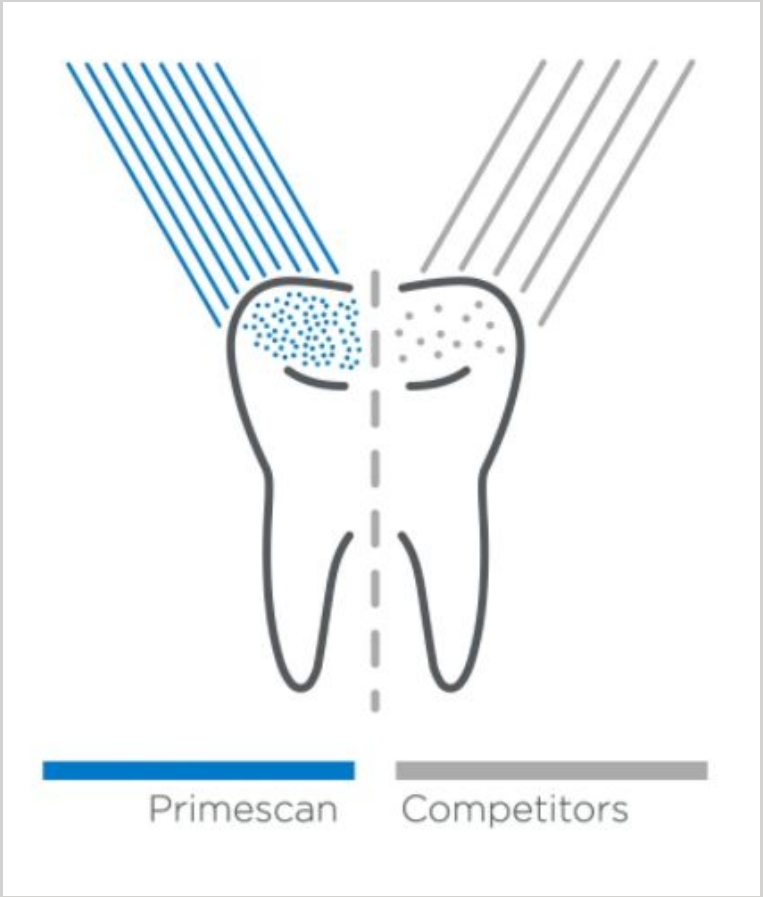

Более 1 миллиона

3D-координат в секунду

До 20 мм

Глубина измерения с идеальной четкостью

Omnicam

Преимущества CEREC Omnicam

- Беспорошковое сканирование в цвете
- Быстрое и точное сканирование полной челюсти
- Непревзойденная легкость управления
- Легкий анализ и определение оттенков зубов

Technical Data	Primescan	Omnicam
Monitor Screen resolution	1920 x 1080 (FHD)	1280 x 1024 (SXGA)
Monitor Brightness	>250 cd/m²	>250 cd/m²
Pixel per inch	102.5 / 2,1 Megapixel	86.3 / 1,3 Megapixel
Monitor Contrast	>700:1	>700:1
Monitor Color resolution	16.7 M colors	16.7 M colors
Monitor size	21.5"	19"
Aspect ratio	16:9, monitor can be rotated up to 90°, moved up to 90° and down to 37,5°	5:4
Anti-reflection	Yes, chemically abraded	No
USB Interfaces	2	1
Operating system	Windows 10, 64 Bit	Windows 7, 64 Bit
Weight	39.5 kg	44 kg
Footprint of body (WxHxD)	408 x 1023-1190** x 443*** mm	350 x 1210 x 470 mm
Processor	Intel i7-8700	Intel i7 5820K
Graphics Card	PULSE RADEON RX 570 8G	AMD RX 470
RAM	4 x 8 GB	2 x 8 GB
SSD	250 GB	No
Battery capacity	288.8 Wh	60 Wh

** Height depends on whether monitor is tilted: When tilted maximally 1023 mm, when upright 1190 mm.

*** W= 540 mm with swiveled out monitor

Сканирование с имплантатов

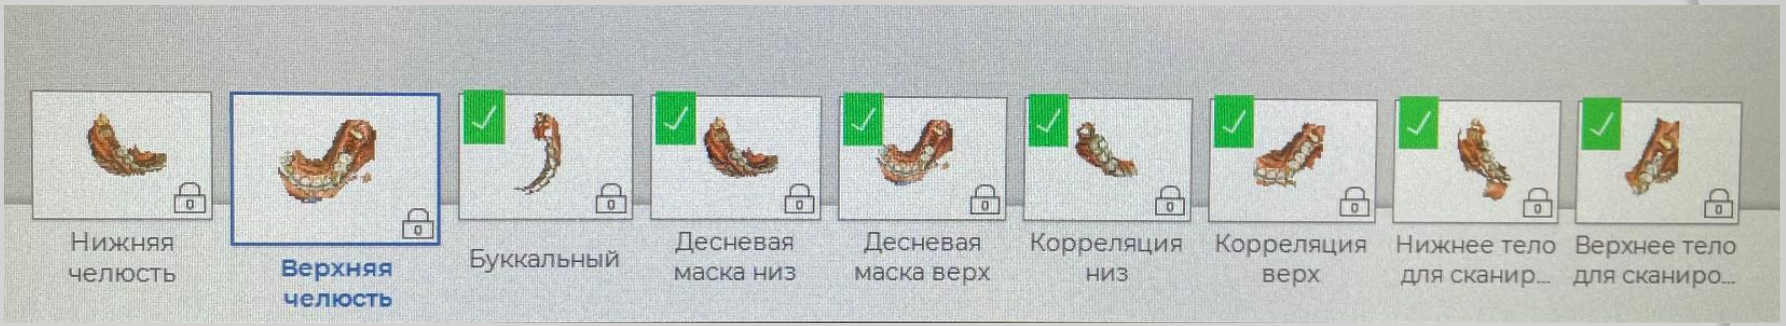

TS Link + Scan Body

Абатмент для сканирования
+ Scan Body

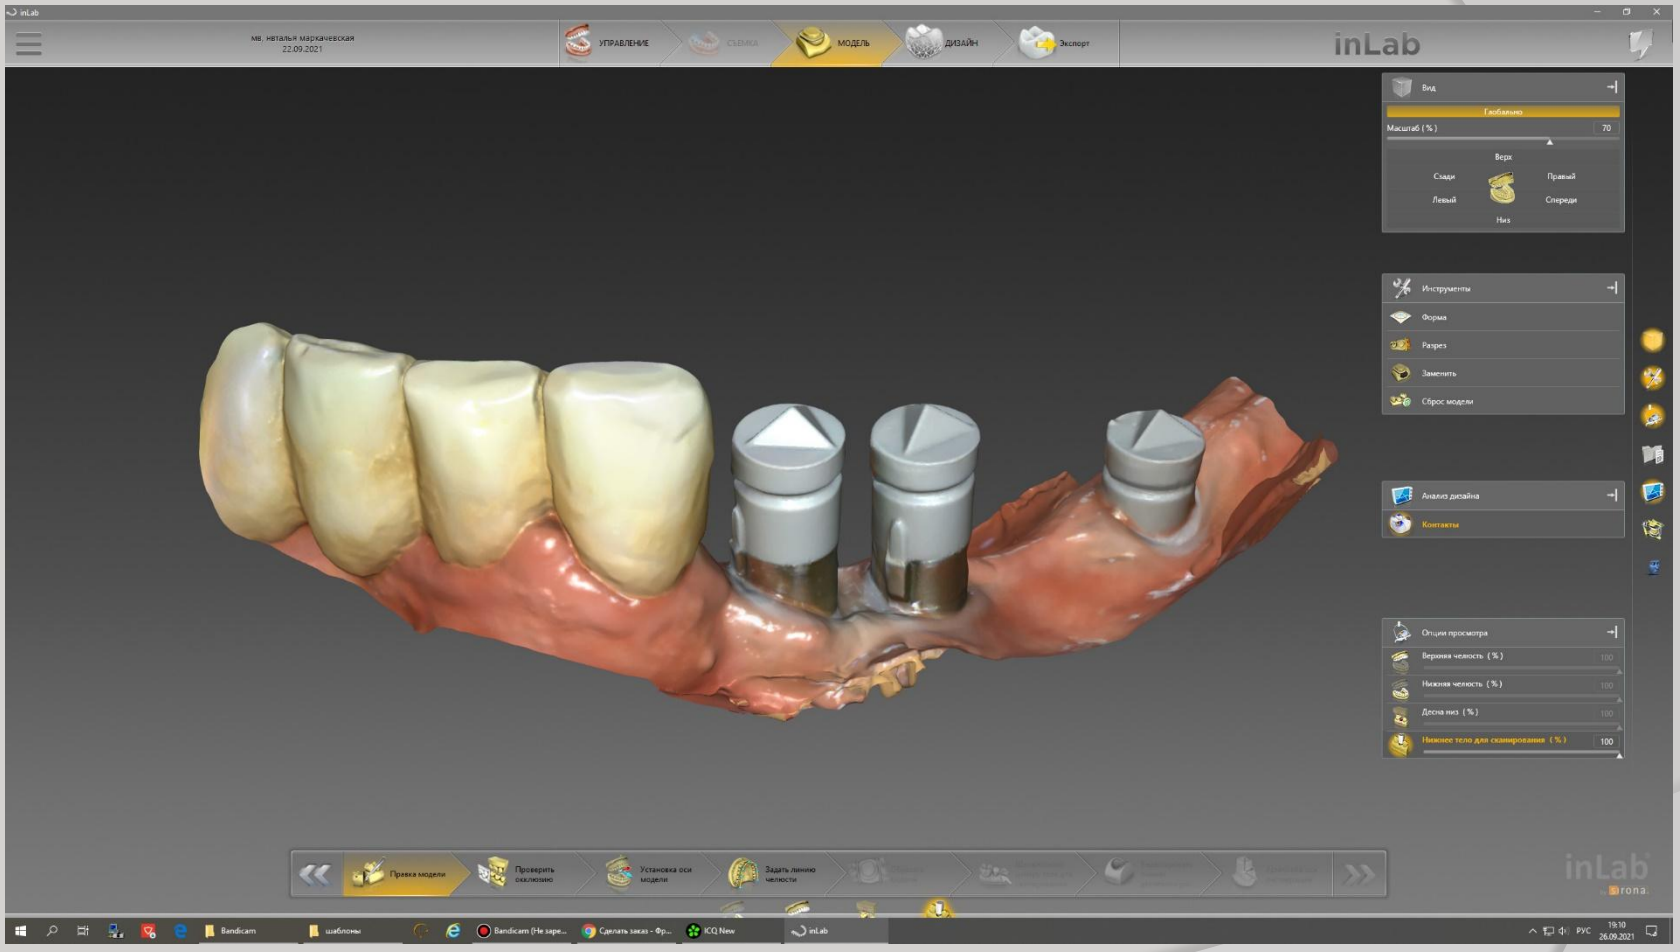
inLab
мв. наталья маркачевская
22.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
70
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
Десна низ (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
100
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
inLab
Bandicam
шаблоны
Bandicam (Не запе...
Сделать заказ - Фр...
ICQ New
inLab
РУС
19:10
26.09.2021

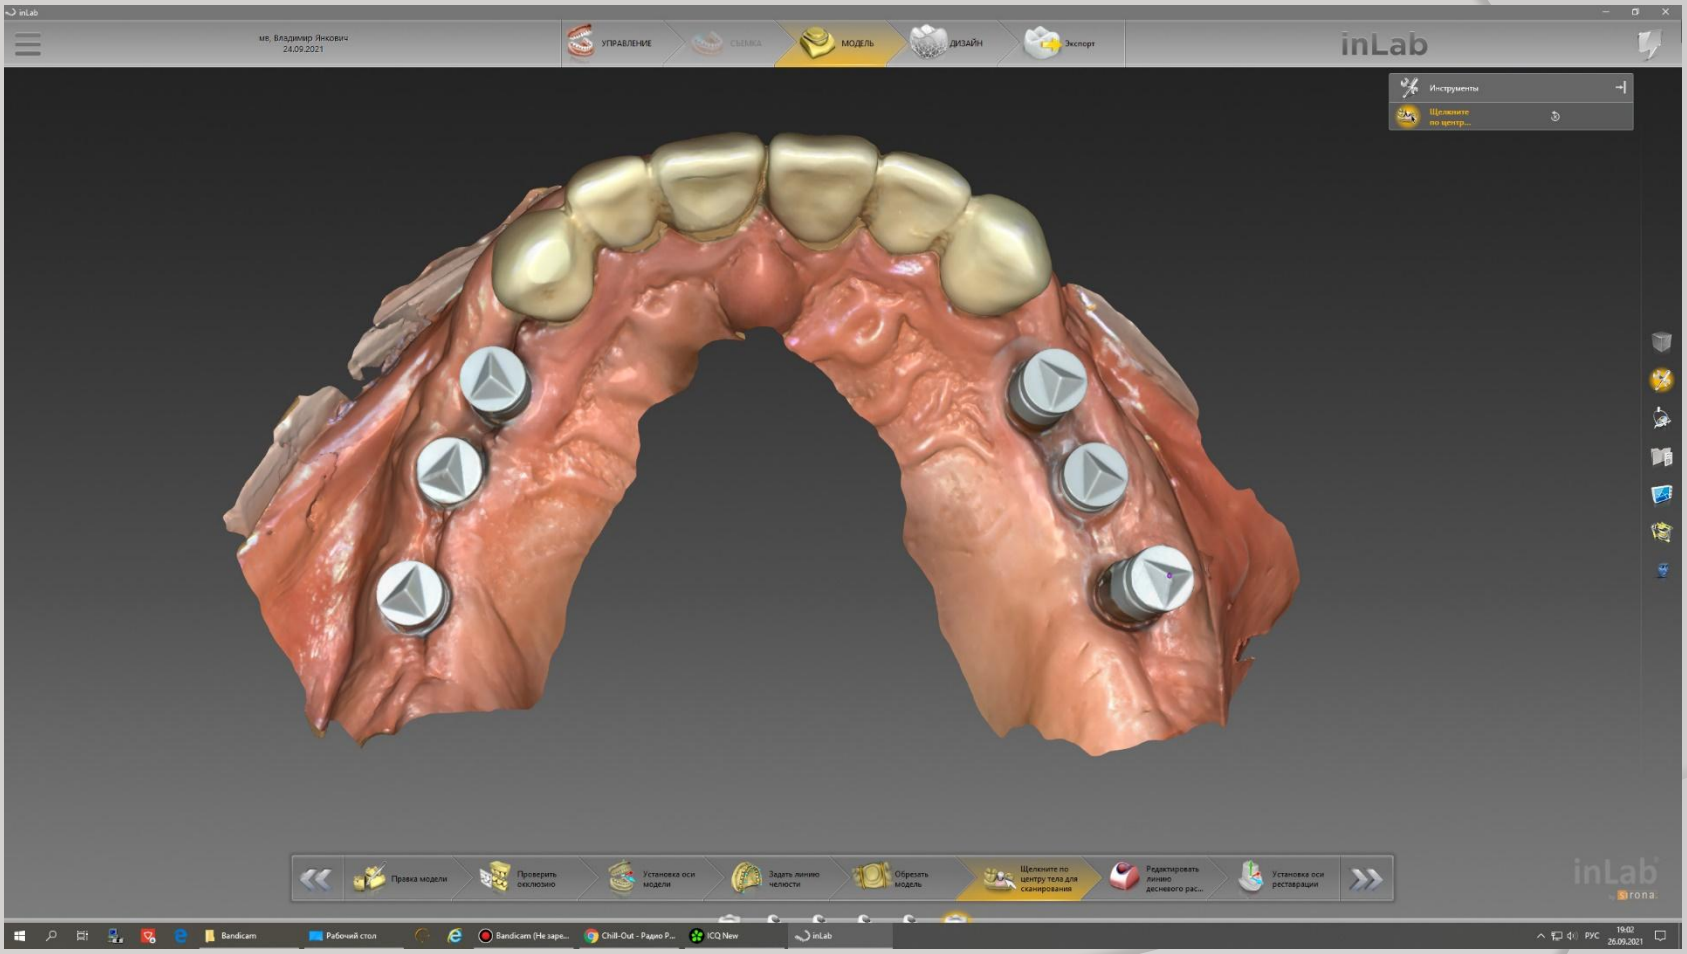
inLab
мв. Владимир Янкович
24.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Инструменты
Щелкните по центр...
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Bandicam
Рабочий стол
Bandicam [Не зарег...
Chill-Out - Радио Р...
ICQ New
inLab
РУС
19:02
26.09.2021

Язычная сторона
Щечная сторона
SP
Поверхность

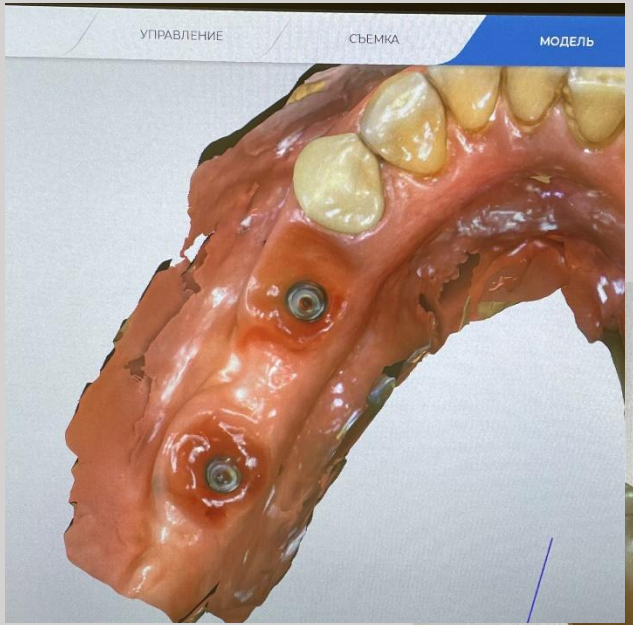
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЁМКА
МОДЕЛЬ

inPost

Мостовидные конструкции с винтовой фиксацией и балки на многопрофильных абатментах

inLab
мя, Елена Варган
10.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЁМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Показания
Реставрация
Коронка
Основа коронки
Телескоп
Понтик
Понтик каркаса
Винир
Вкладка / Накладка
Абатмент
Винтовая фиксация коронки
Балочный абатмент
Балка
Отсутствующая
Информация о реставрации
Виртуальная установка
Слой 1/1
17 Коронка
16 Винтовая фиксац...
46 Винтовая фиксация коронки
47 Коронка
Анатомический
Копировать
Копировать и отразить
MultiLayer
Соединение имплантата:
TiBase
Производитель:
Dentsply Sirona others
Тип:
O.TS 4.0 L
Тип тела для сканирования:
ScanPost
Тело для сканирования:
O.TS 4.0
Аппарат:
MC X5
Производитель:
Прочие
Материал:
ZrO2
Режим обработки:
Фрезерование
Удалить
Определить реставрации
inLab
Sirona
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:36
01.10.2021

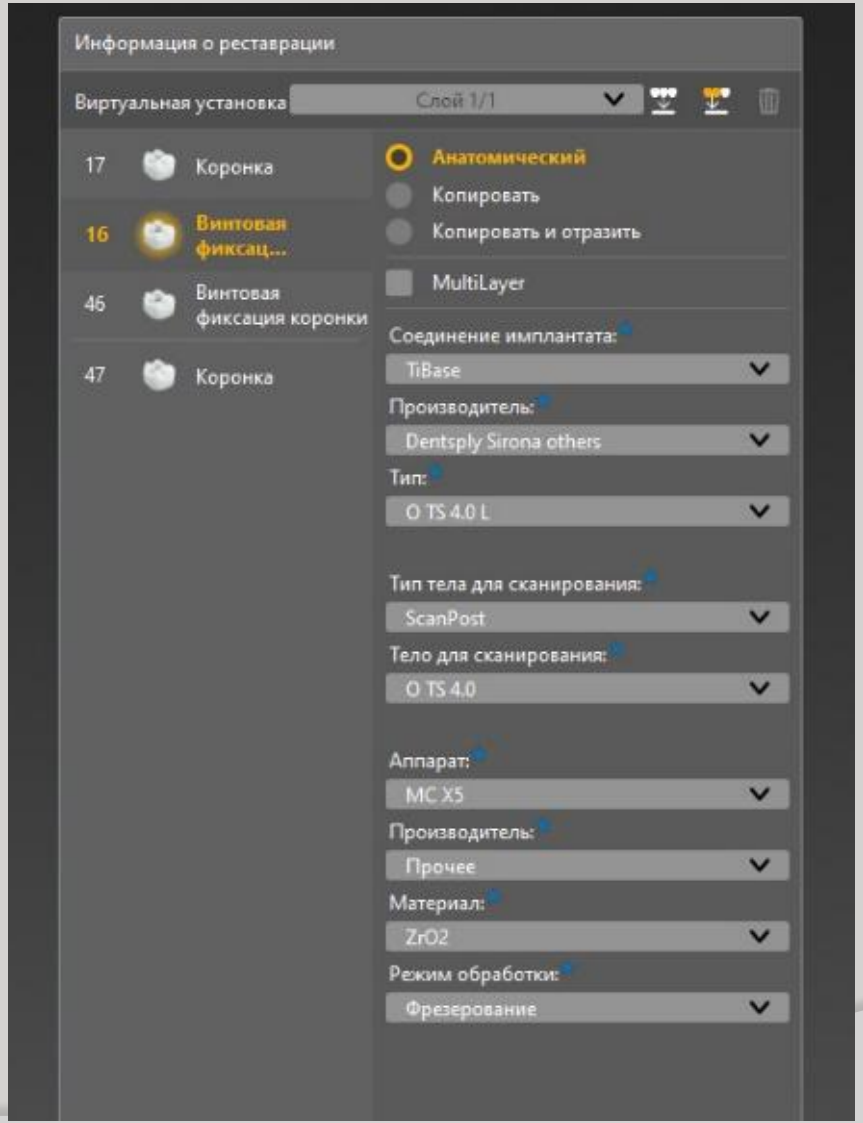
Информация о реставрации
Виртуальная установка
Слой 1/1
17
Коронка
16
Винтовая фиксац...
46
Винтовая фиксация коронки
47
Коронка
Анатомический
Копировать
Копировать и отразить
MultiLayer
Соединение имплантата:
TiBase
Производитель:
Dentsply Sirona others
Тип:
O TS 4.0 L
Тип тела для сканирования:
ScanPost
Тело для сканирования:
O TS 4.0
Аппарат:
MC X5
Производитель:
Прочее
Материал:
ZrO2
Режим обработки:
Фрезерование

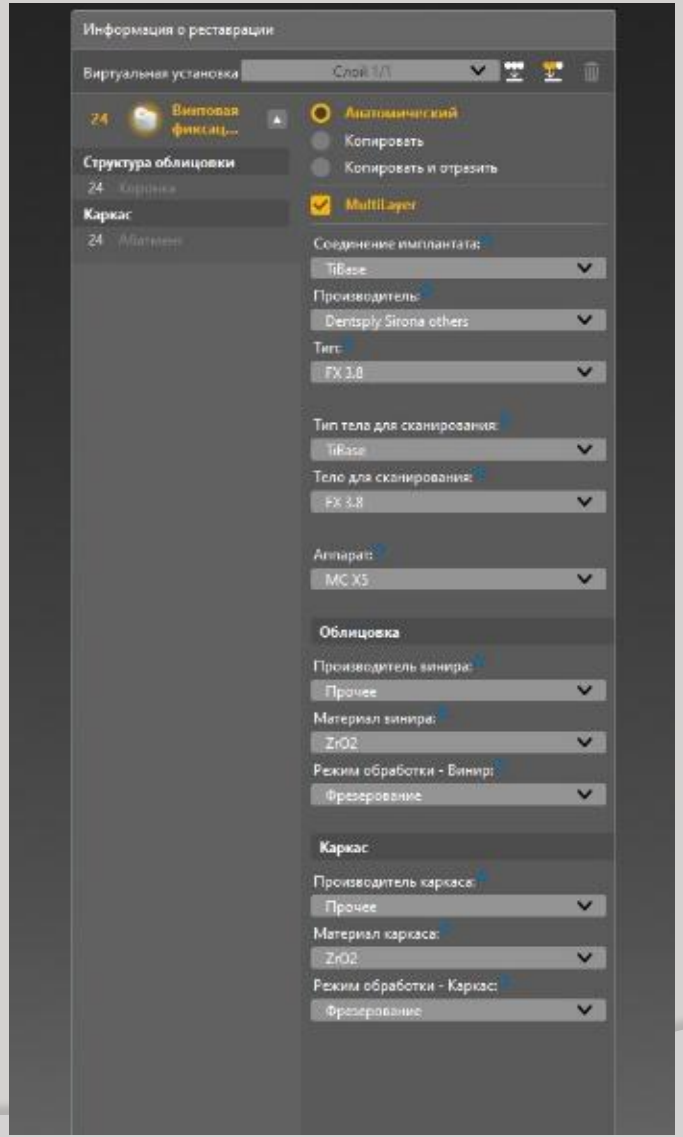
Информация о реставрации
Виртуальная установка
Слой 1/1
24
Винтовая фиксац...
Структура облицовки
24
Каркас
24
Анатомический
Копировать
Копировать и отразить
MultiLayer
Соединение имплантата:
TiBase
Производитель:
Dentsply Sirona others
Тип:
FX 3.8
Тип тела для сканирования:
TiBase
Тело для сканирования:
FX 3.8
Аппарат:
MC X5
Облицовка
Производитель винира:
Прочее
Материал винира:
ZrO2
Режим обработки - Винир:
Фрезерование
Каркас
Производитель каркаса:
Прочее
Материал каркаса:
ZrO2
Режим обработки - Каркас:
Фрезерование

Omnicam до обновления

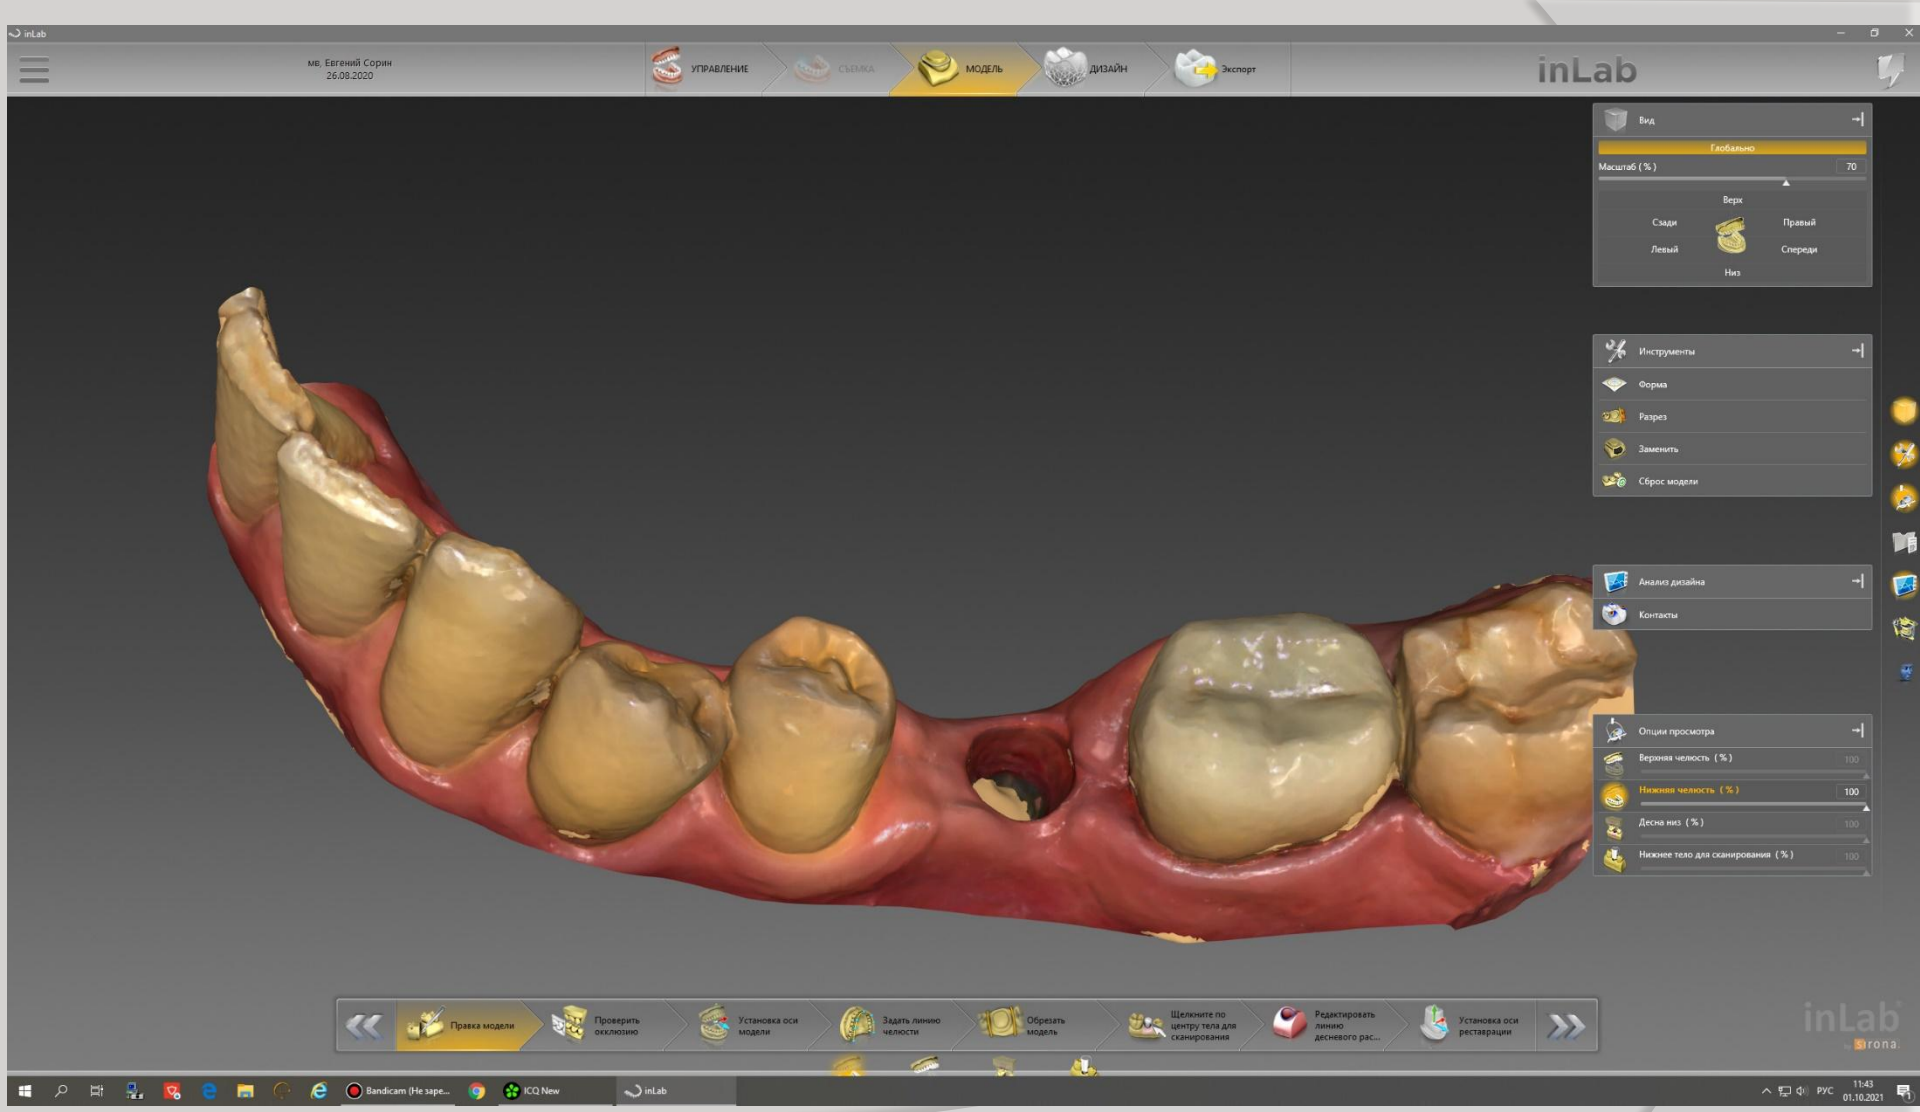
inLab
мв, Евгений Сорин
26.08.2020
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
70
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
100
Десна низ (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
Bandicam (Не запе...
ICQ New
inLab
РУС
11:43
01.10.2021

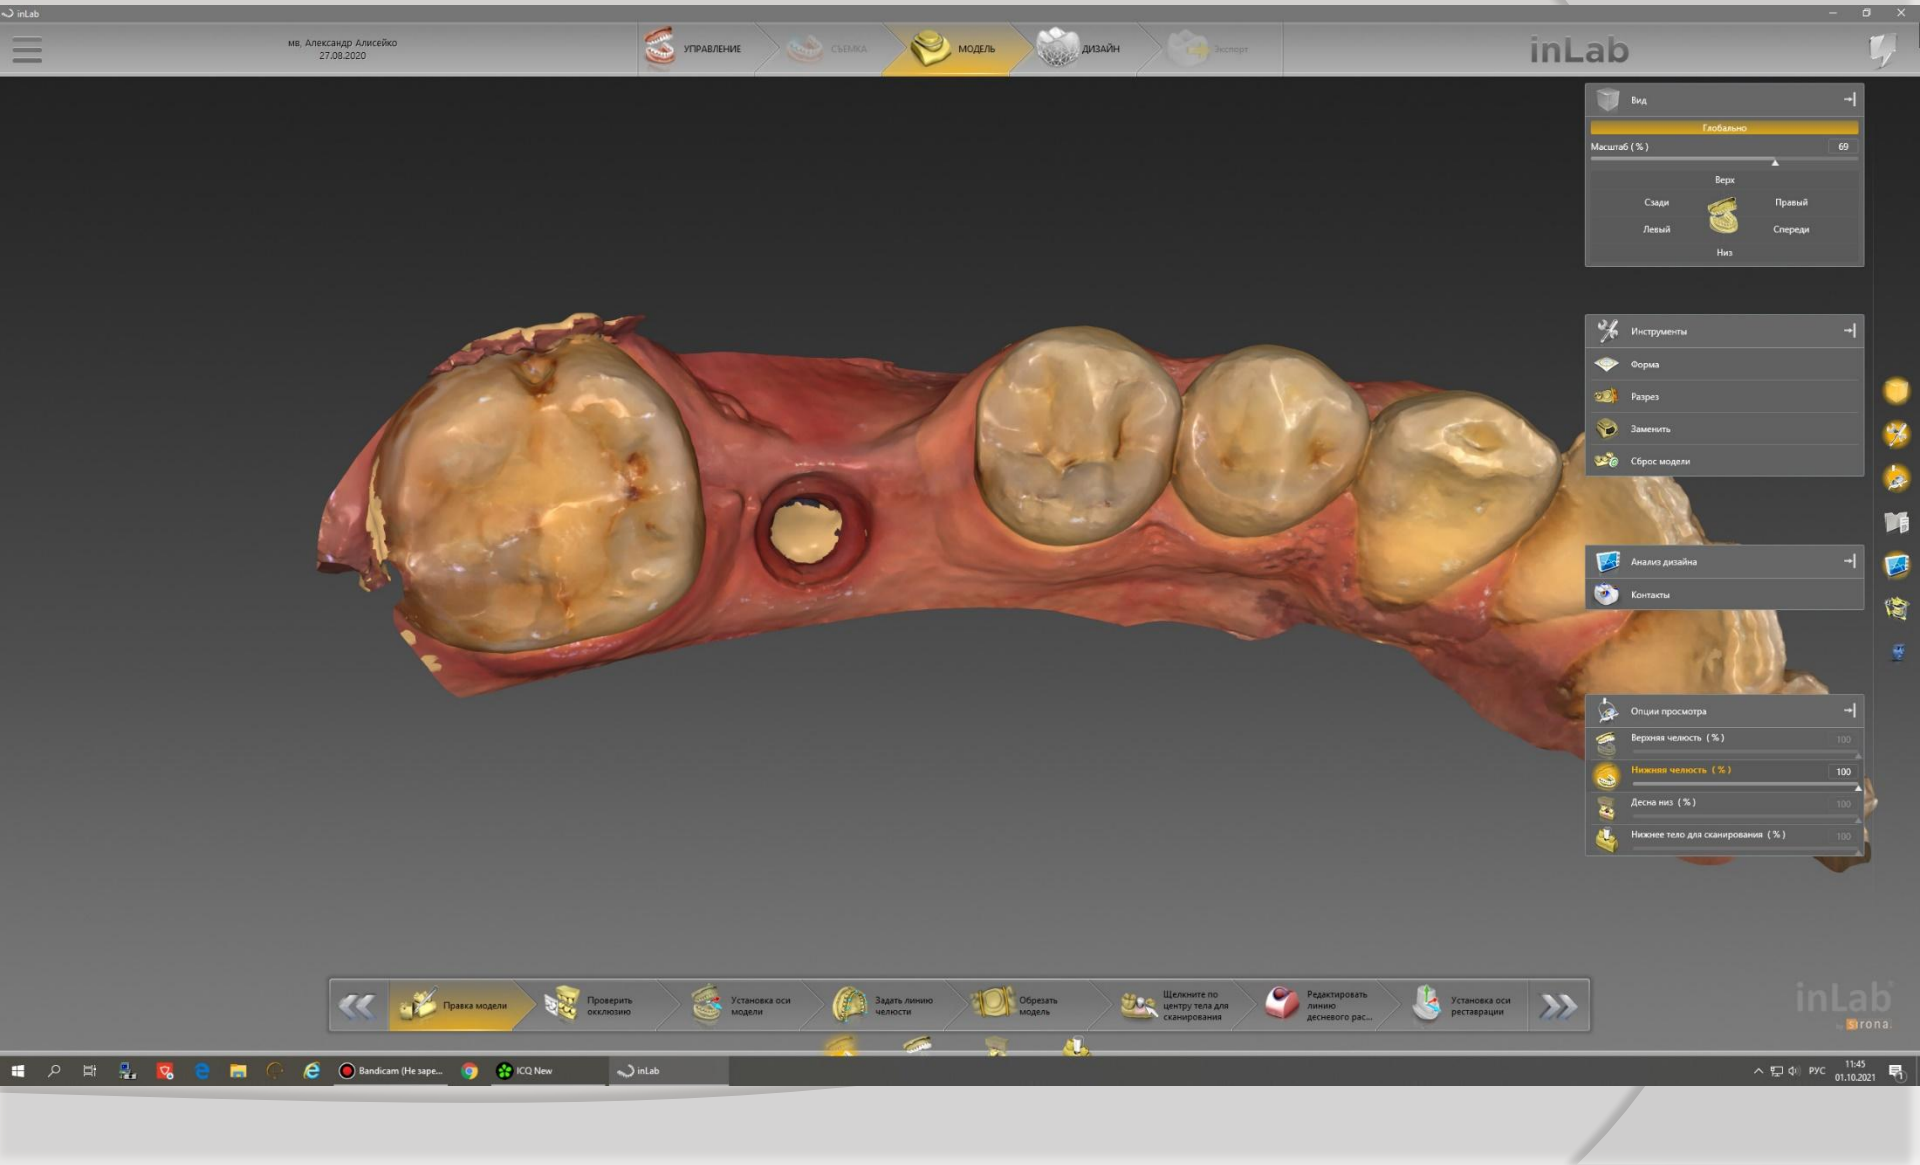
inLab
мв, Александр Алисейко
27.08.2020
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
69
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
100
Нижняя челюсть (%)
100
Десна низ (%)
100
Нижнее тело для сканирования (%)
100
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Sirona
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:45
01.10.2021

Omnicam с версией ПО 5.1.3

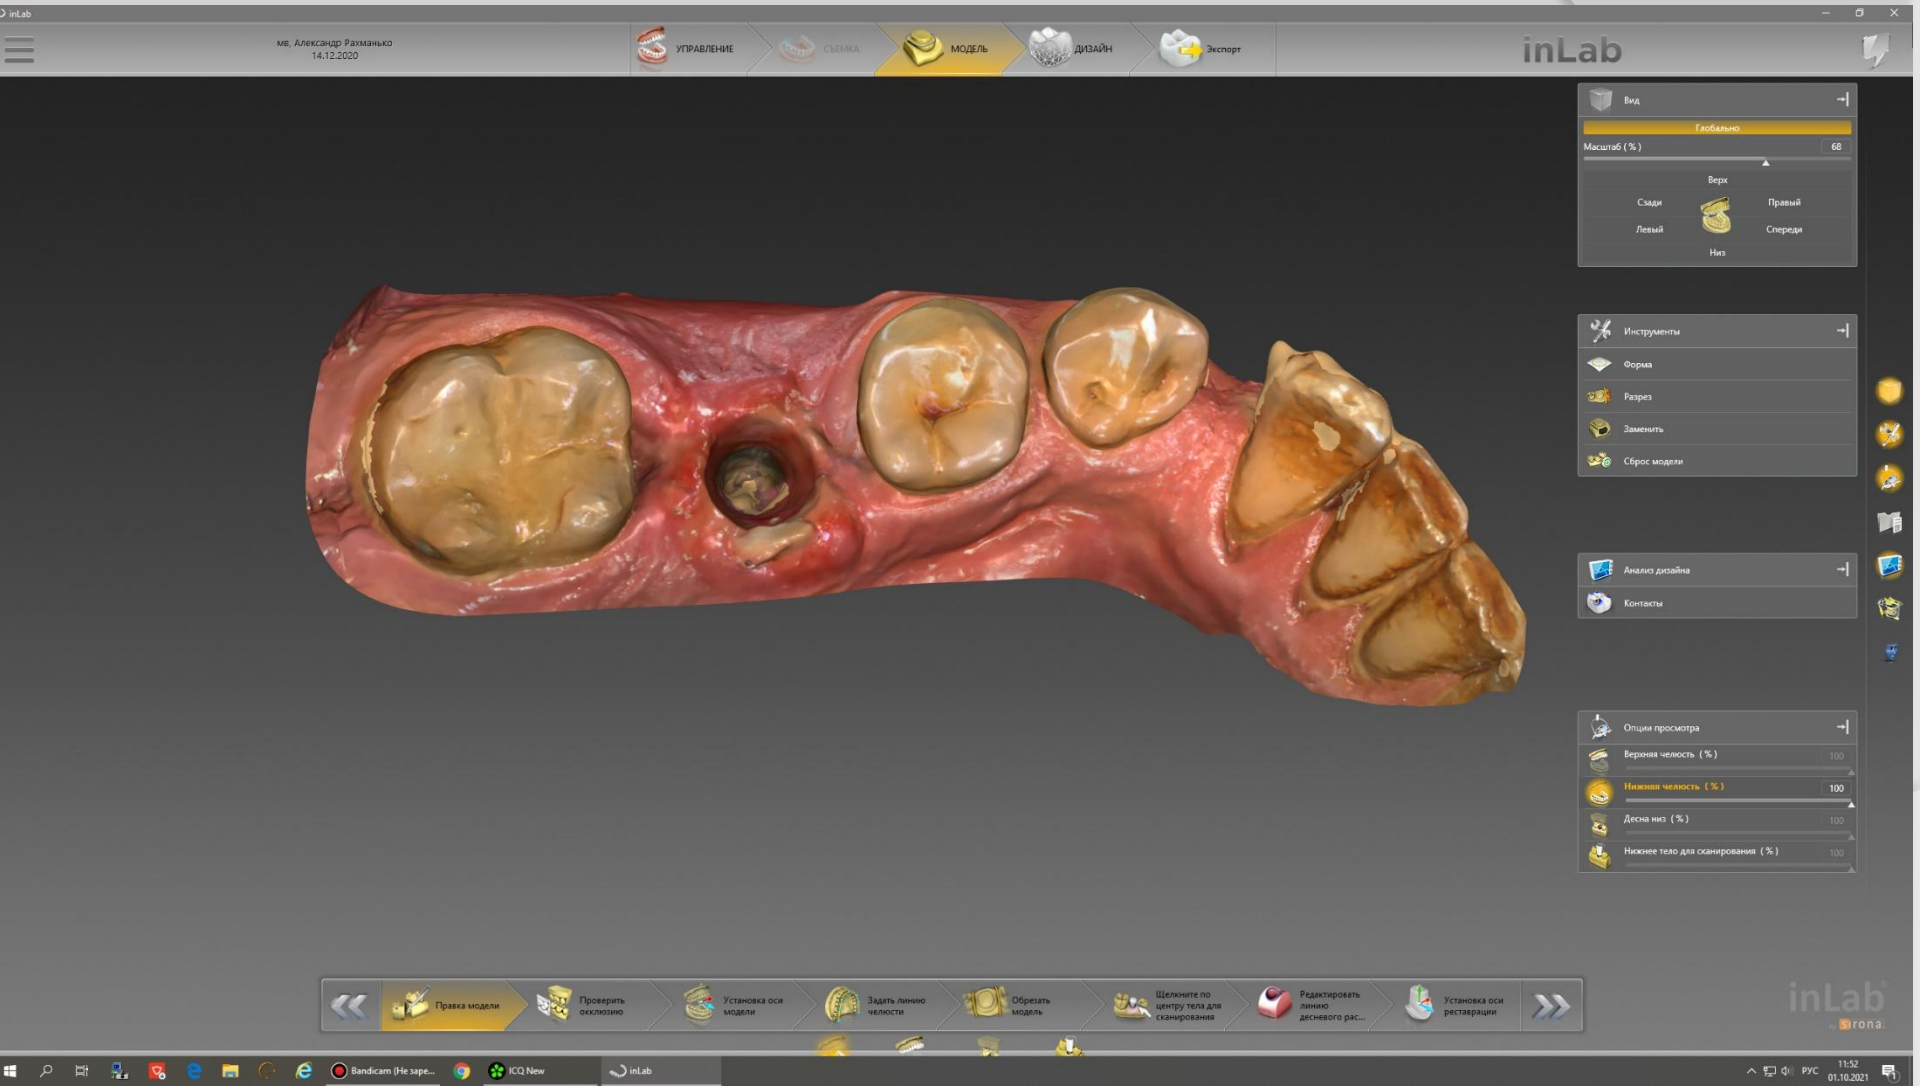
inLab
мв, Александр Рахманько
14.12.2020
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
68
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
100
Десна низ (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Sirona
Bandicam (Не запе...
ICQ New
inLab
РУС
11:52
01.10.2021

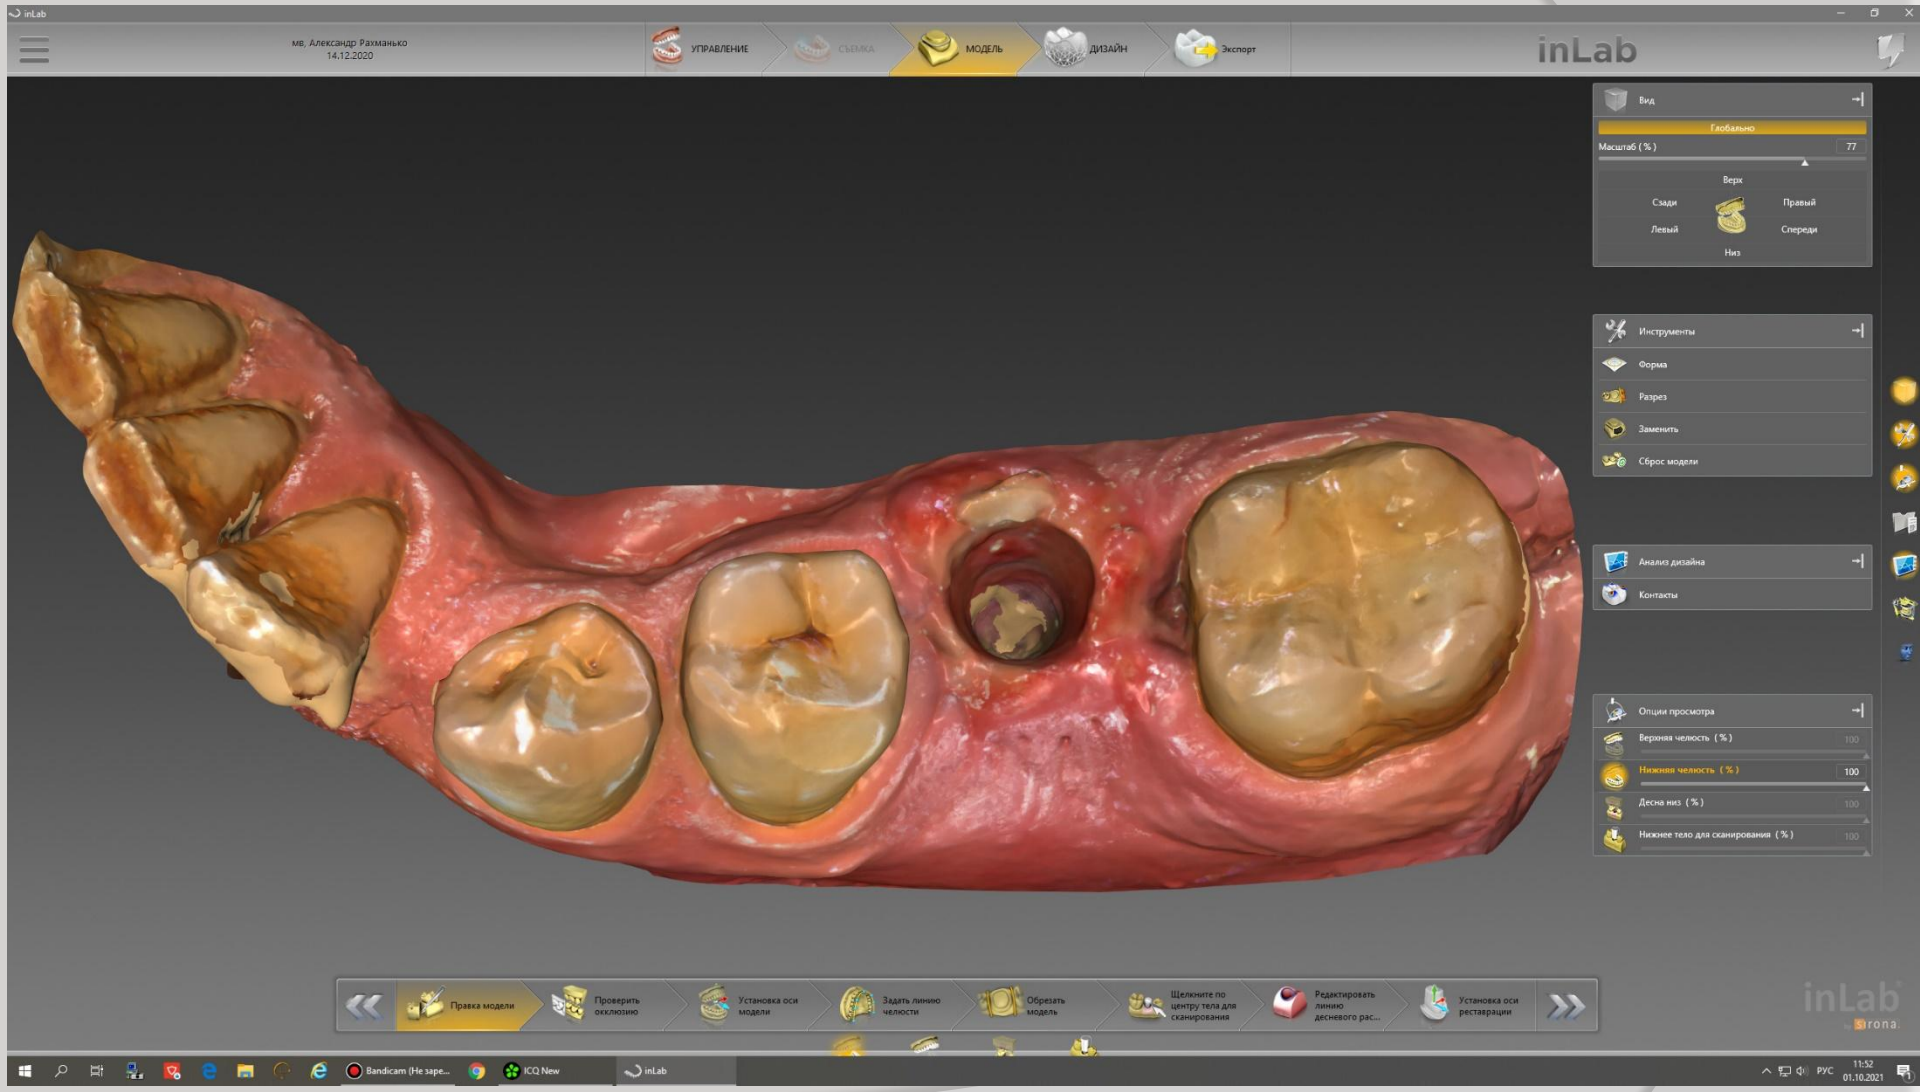
inLab
мв, Александр Рахманько
14.12.2020
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
77
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
100
Десна низ (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
Bandicam (Не запе...
ICQ New
inLab
РУС
11:52
01.10.2021

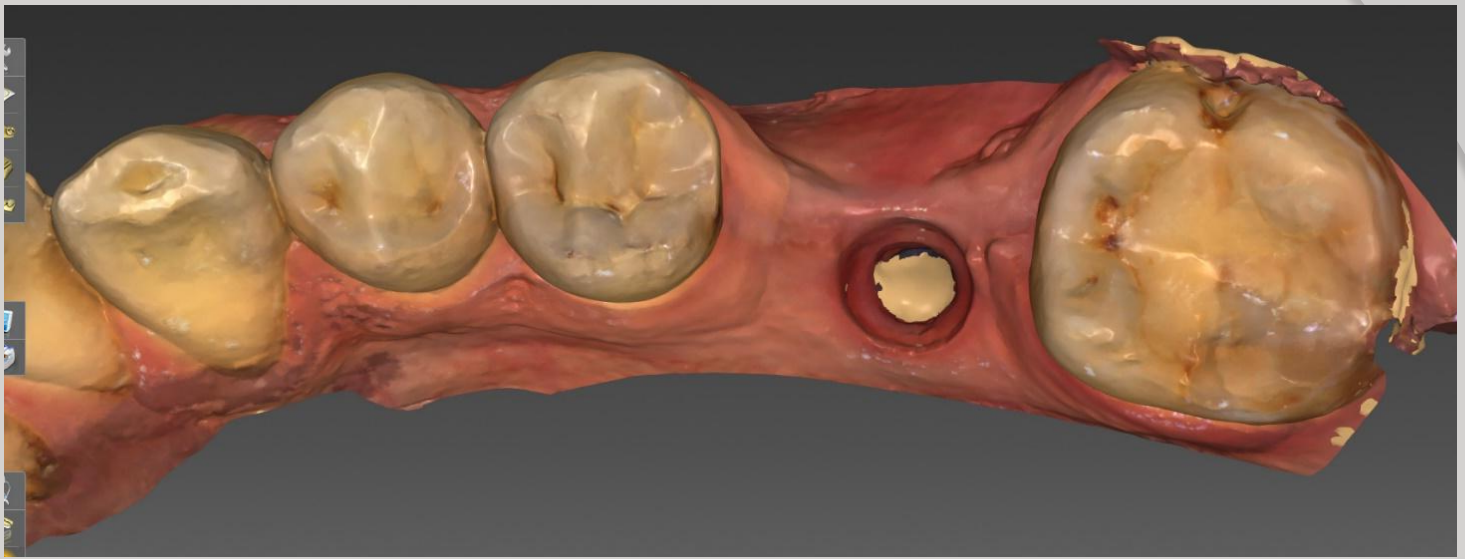

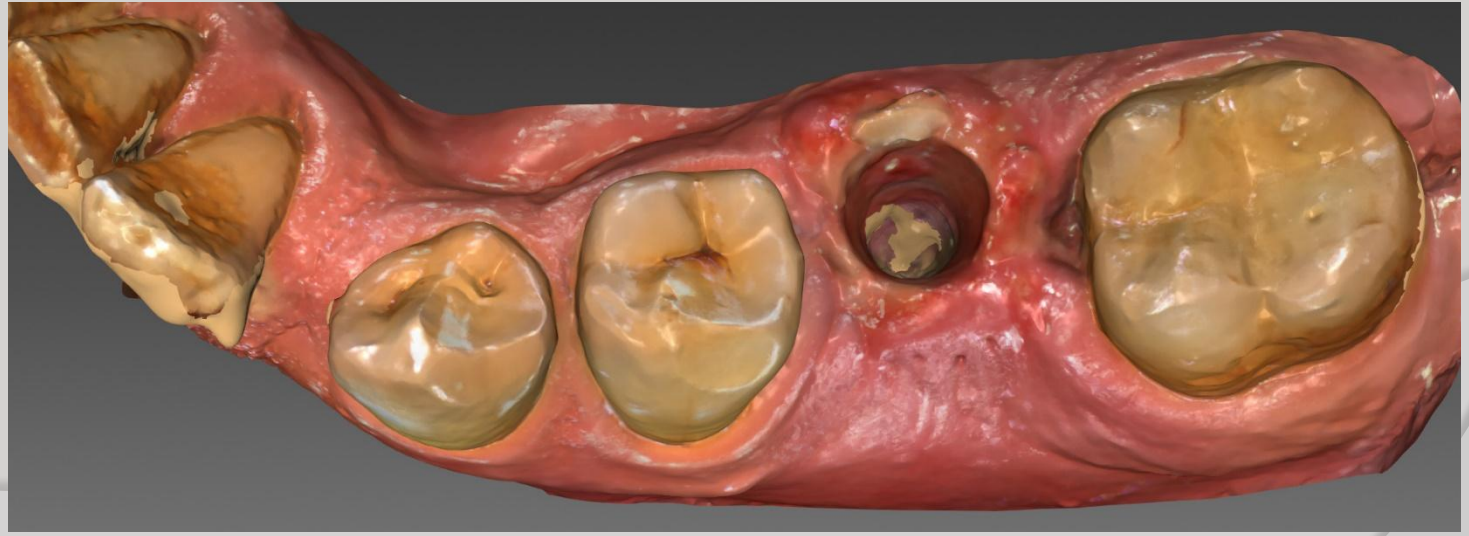

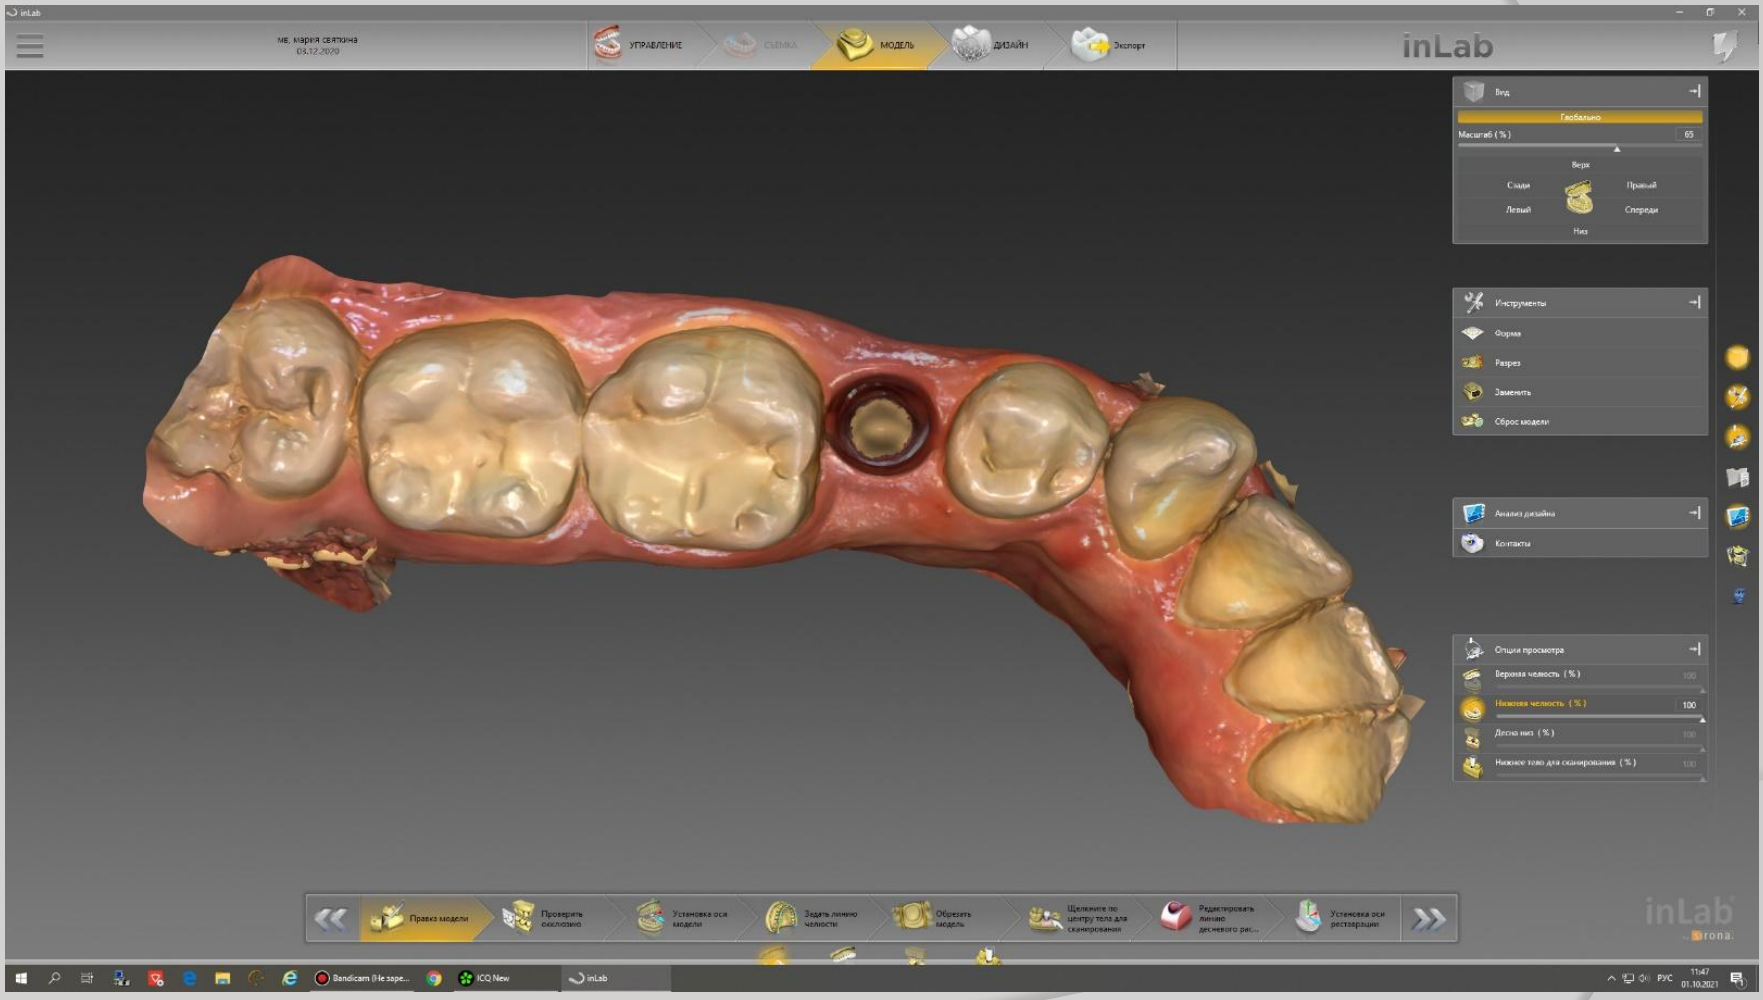
inLab
мв, мария святкина
03.12.2020
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
65
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
100
Десна низ (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:47
01.10.2021

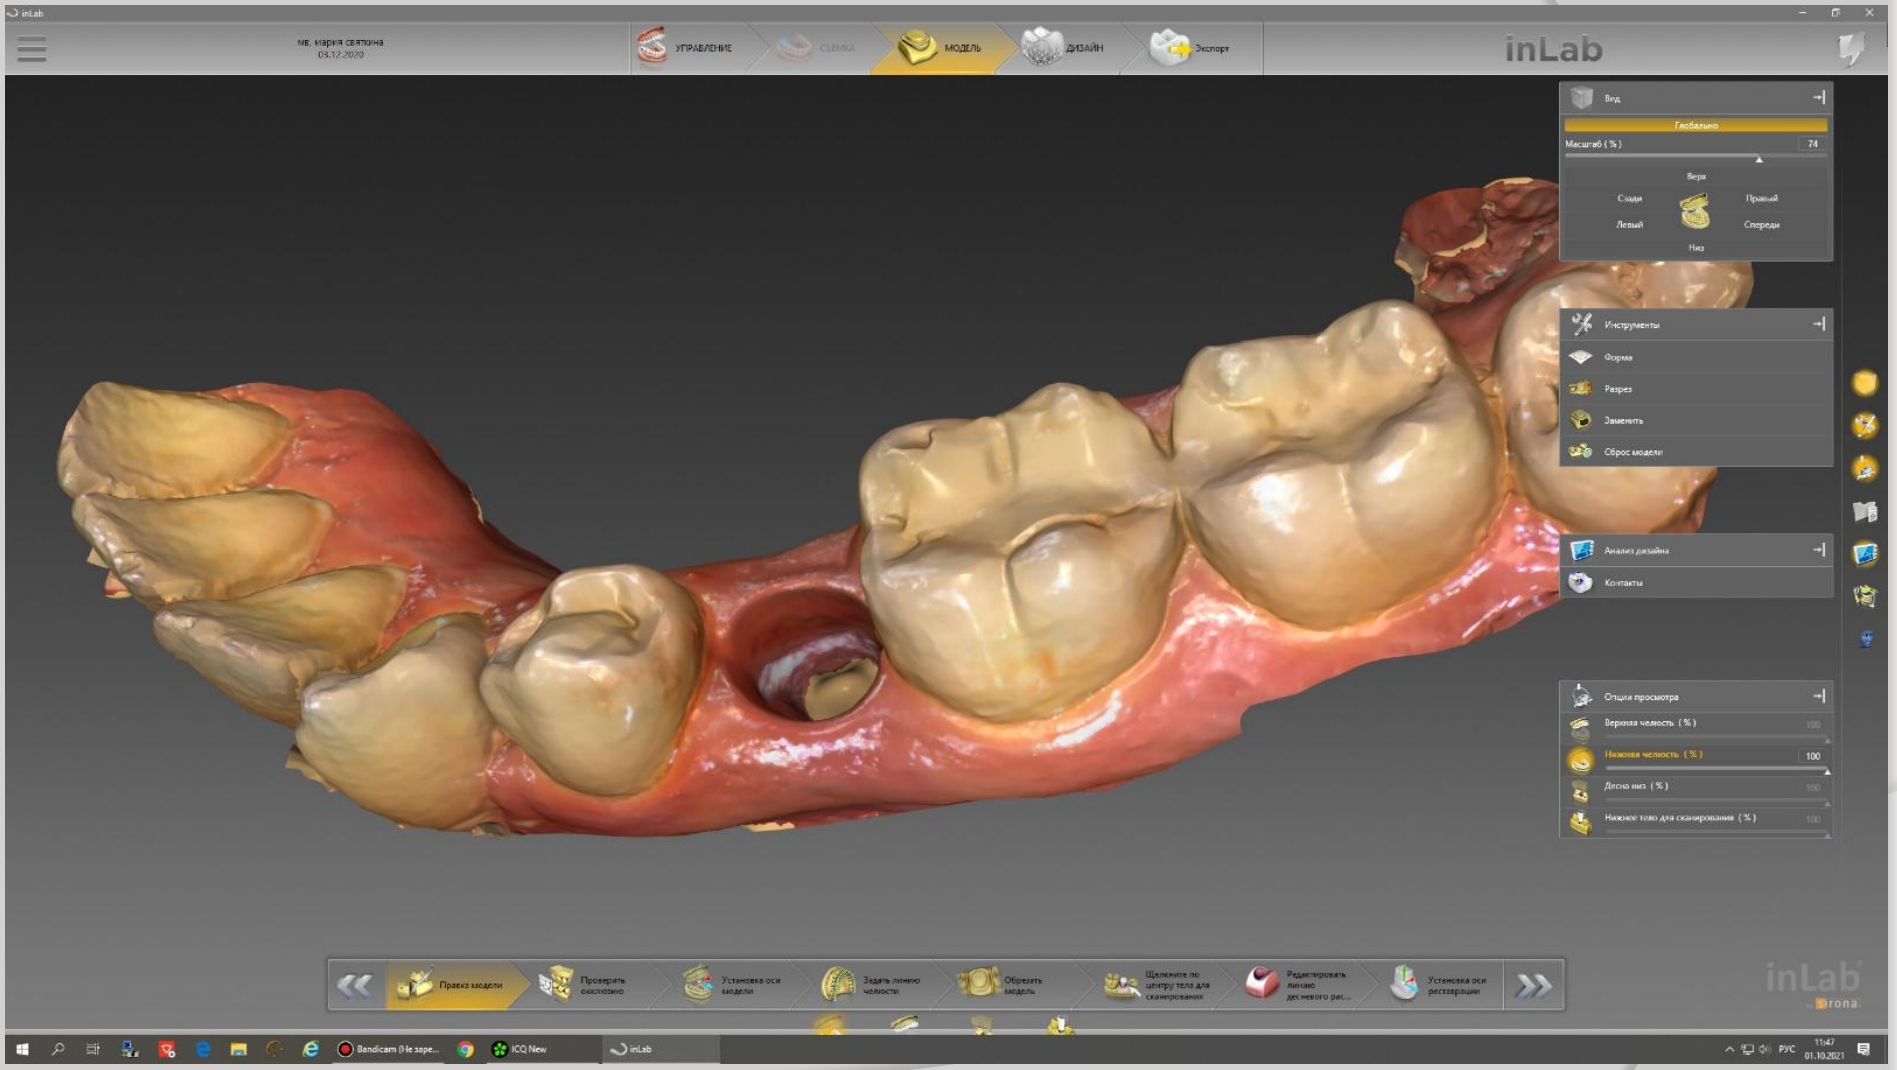
inLab
мв. мария святкина
05.12.2020
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
74
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
100
Десна низ (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рес...
Установка оси реставрации
inLab
Sirona
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:47
01.10.2021

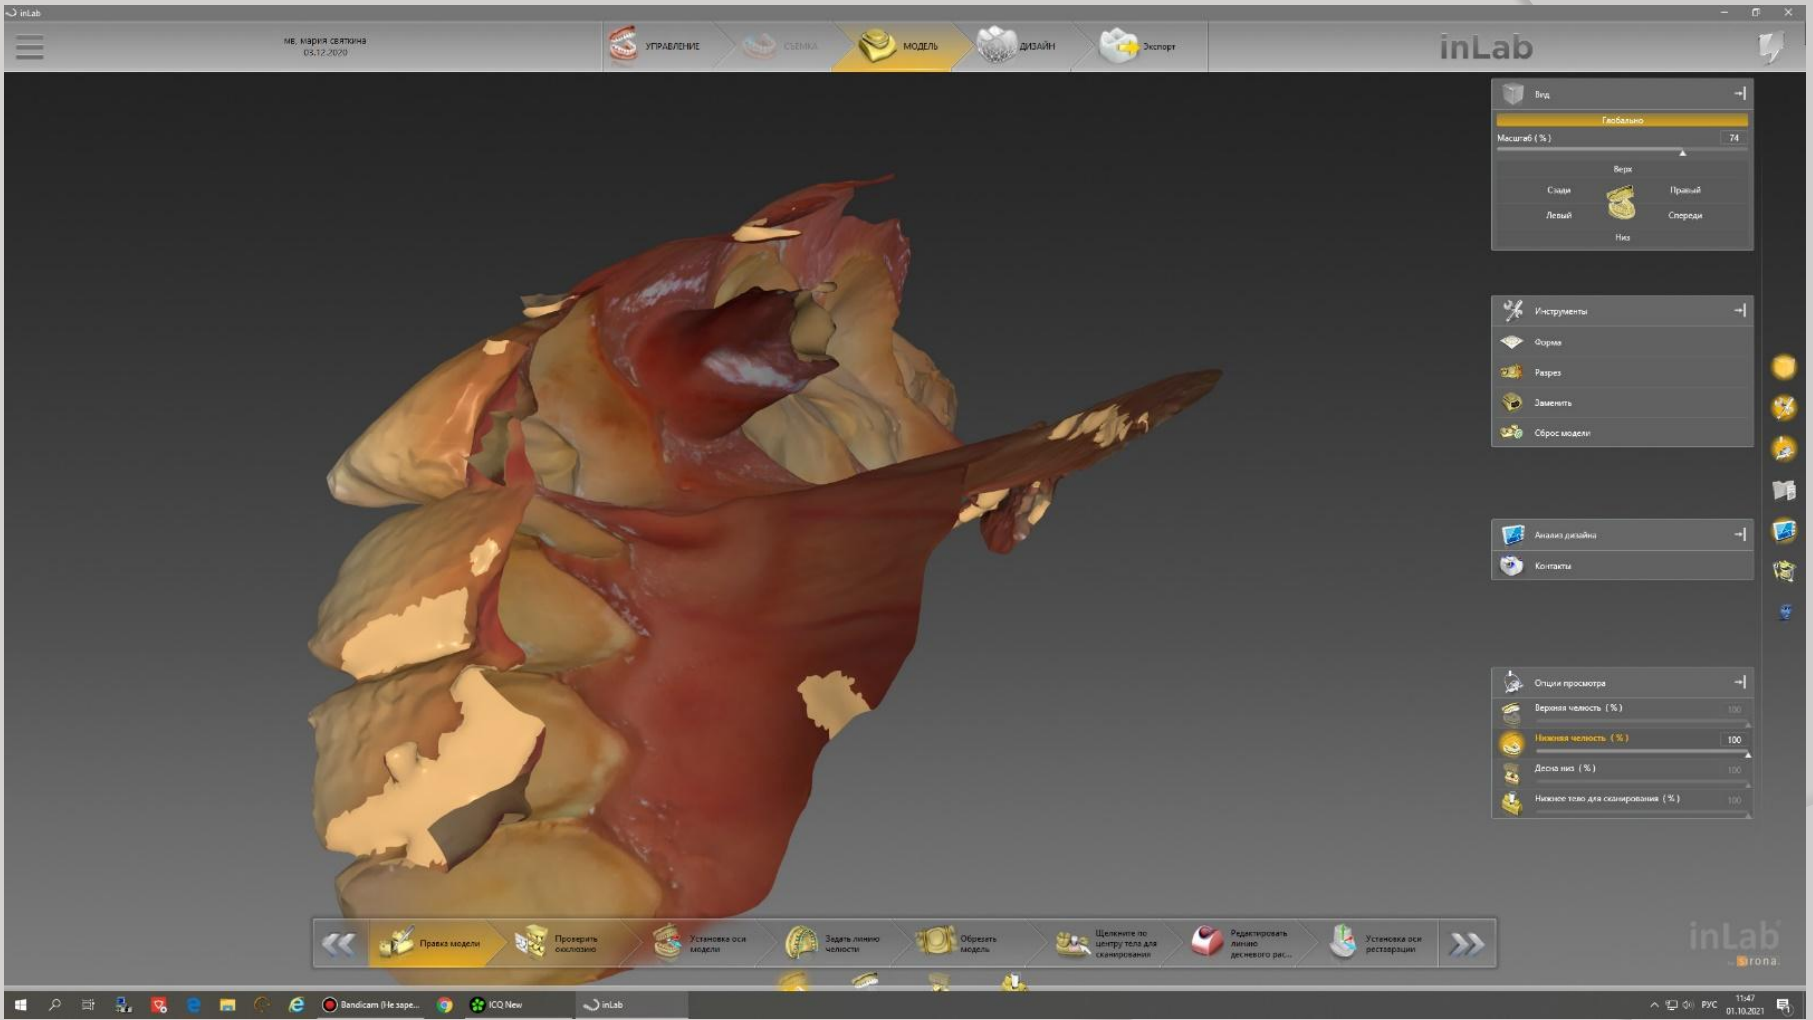
inLab
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
Вид
Глобально
Масштаб (%)
74
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
100
Десна низ (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:47
01.10.2021

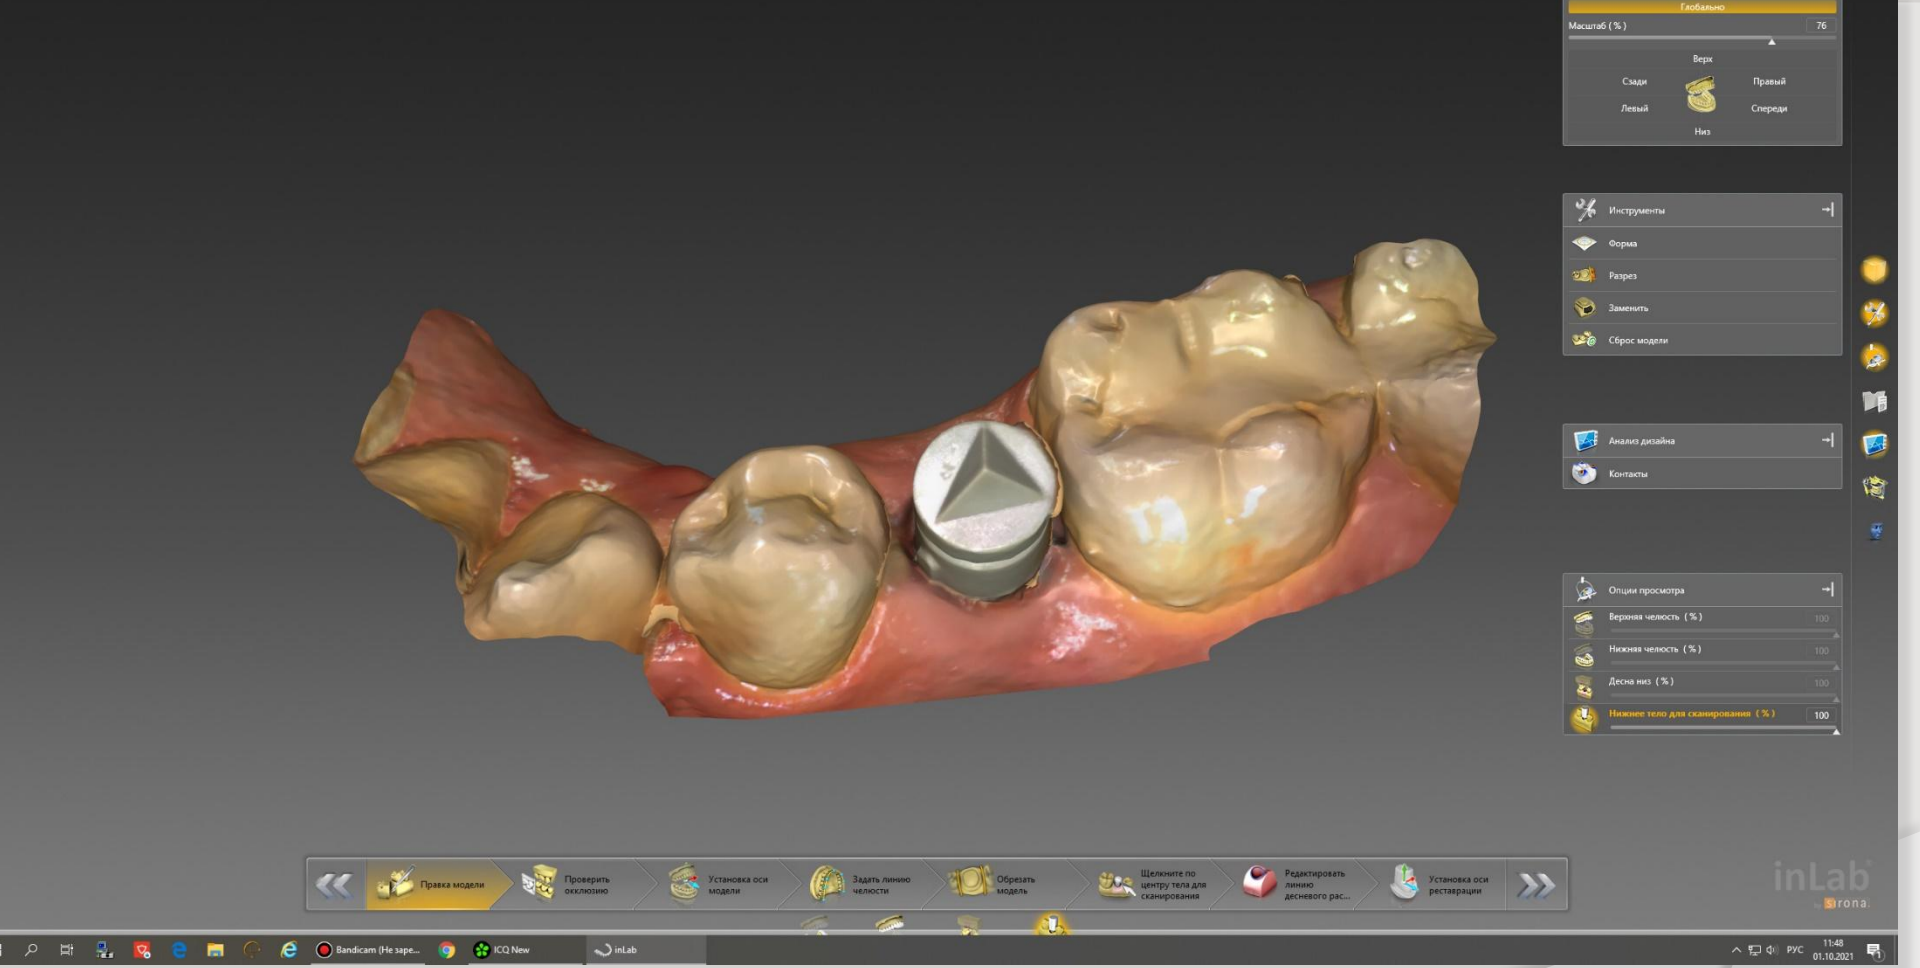
Глобально
Масштаб (%)
76
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
100
Нижняя челюсть (%)
100
Десна низ (%)
100
Нижнее тело для сканирования (%)
100
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Sirona
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:48
01.10.2021

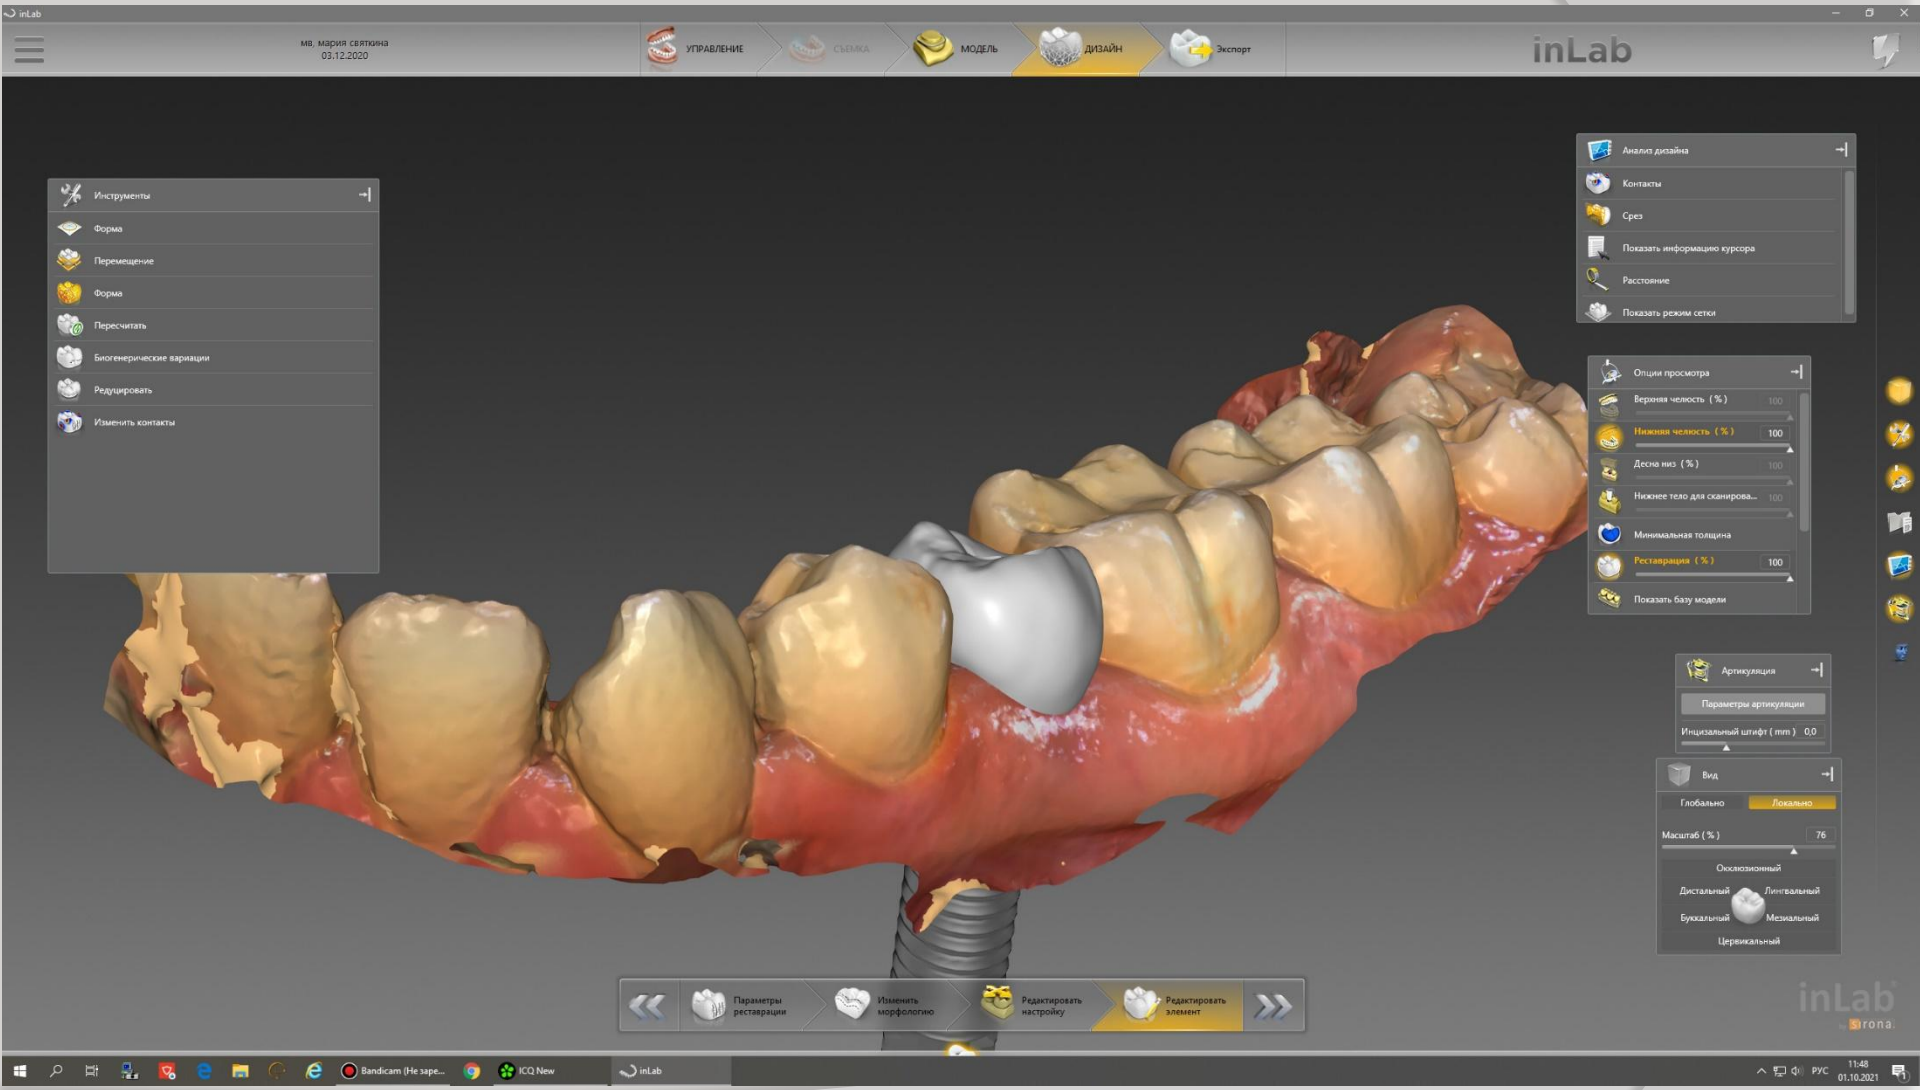
inLab
мв, мария святкина
03.12.2020
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Инструменты
Форма
Перемещение
Форма
Пересчитать
Биогенерические вариации
Редуцировать
Изменить контакты
Анализ дизайна
Контакты
Срез
Показать информацию курсора
Расстояние
Показать режим сетки
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
Десна низ (%)
Нижнее тело для сканирова...
Минимальная толщина
Реставрация (%)
Показать базу модели
Артикуляция
Параметры артикуляции
Инцизальный штифт (mm) 0,0
Вид
Глобально
Локально
Масштаб (%)
Окклюзионный
Дистальный
Лингвальный
Буккальный
Мезиальный
Цервикальный
Параметры реставрации
Изменить морфологию
Редактировать настройку
Редактировать элемент
inLab
by Sirona
Bandicam (Не запе...
ICQ New
inLab
РУС
11:48
01.10.2021

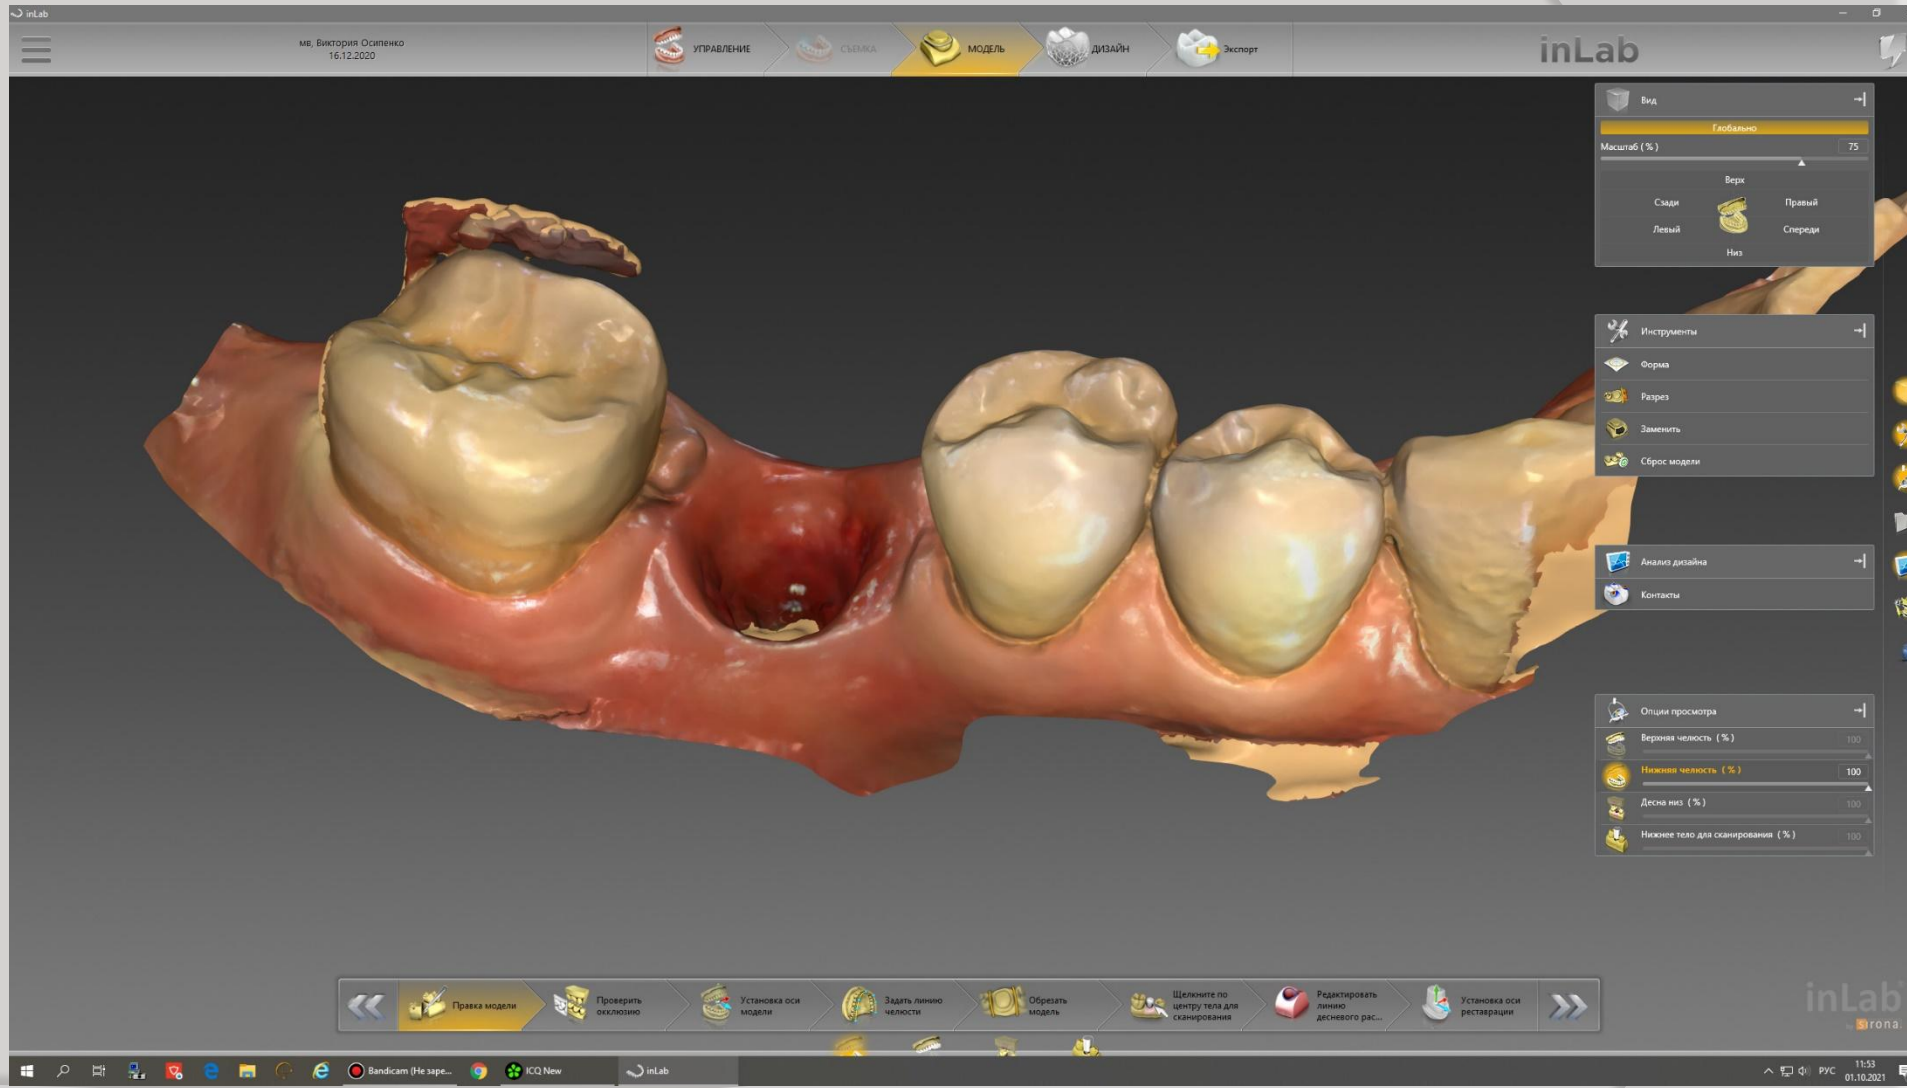
inLab
мв, Виктория Осипенко
16.12.2020
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
75
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
100
Нижняя челюсть (%)
100
Десна низ (%)
100
Нижнее тело для сканирования (%)
100
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Sirona
Bandicam (Не запе...
ICQ New
inLab
РУС
11:53
01.10.2021

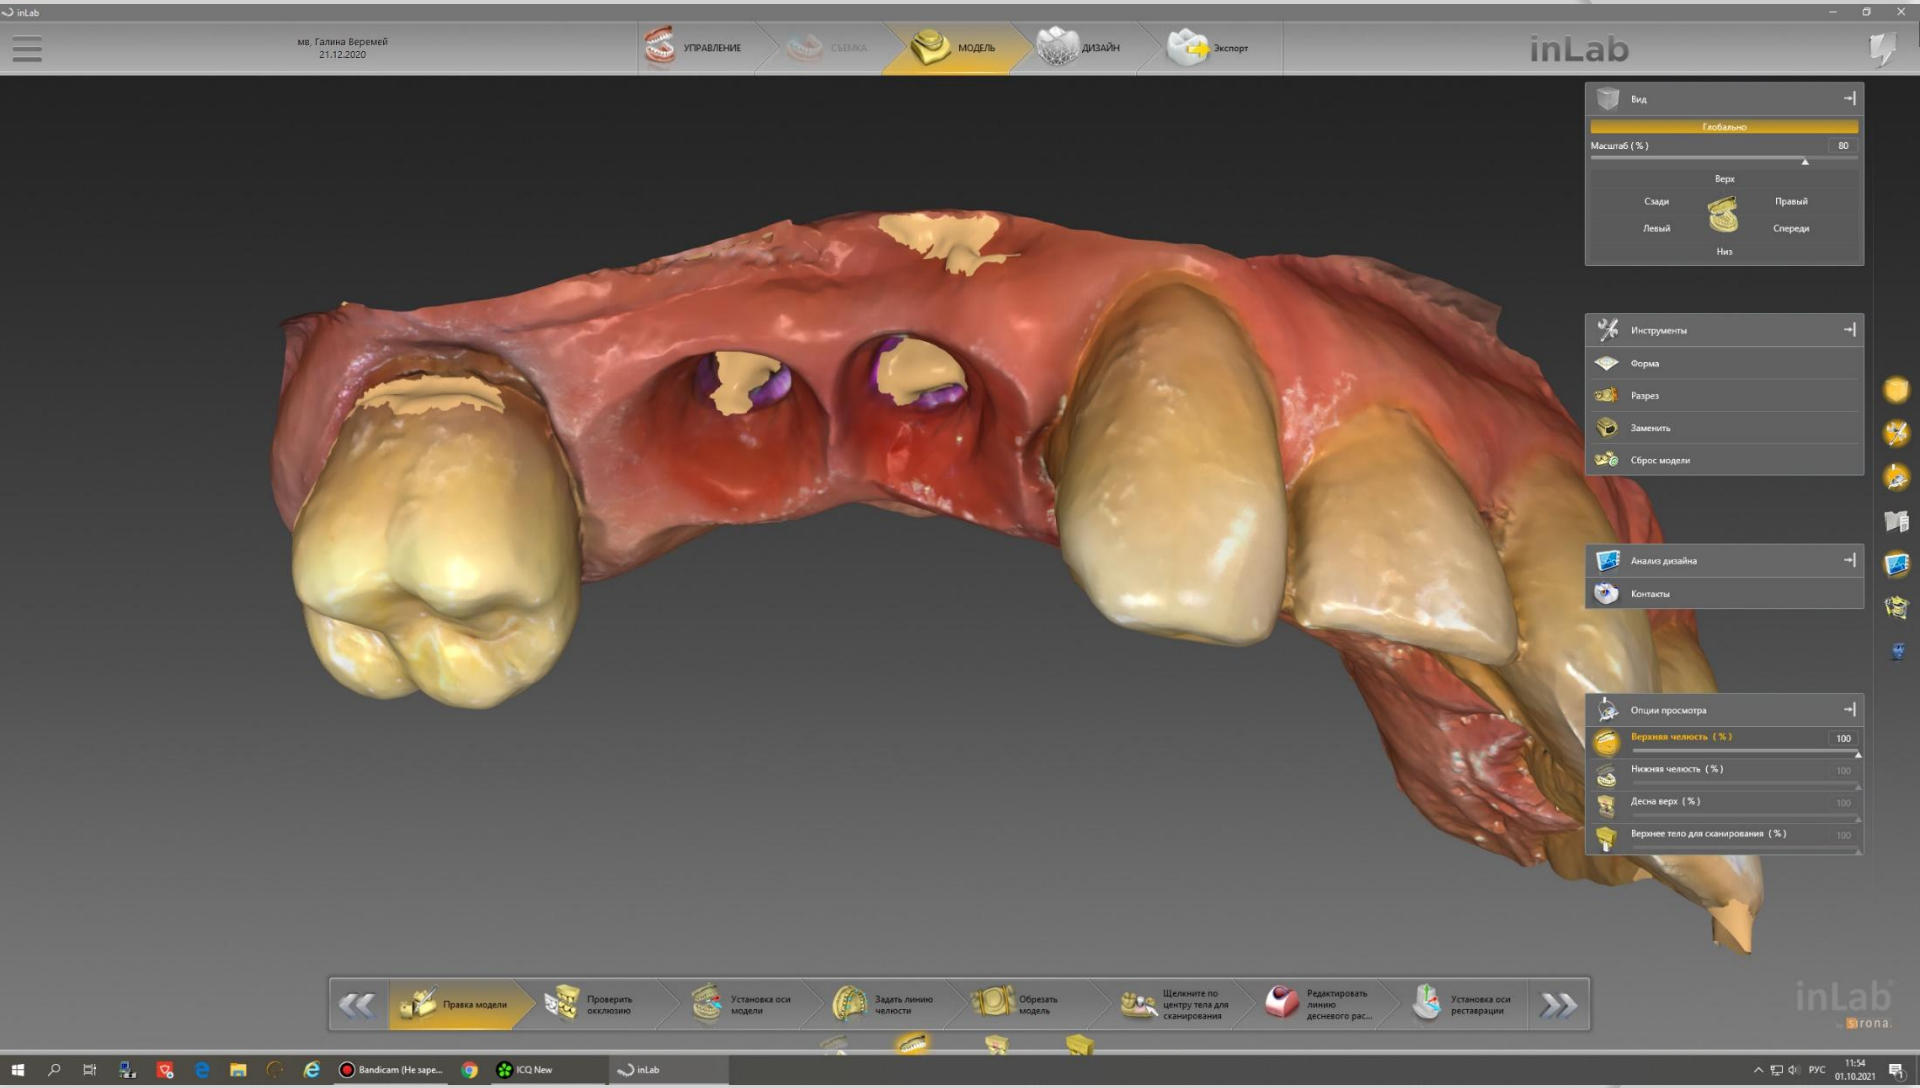
inLab
мв, Галина Веремей
21.12.2020
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
80
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
100
Нижняя челюсть (%)
100
Десна верх (%)
100
Верхнее тело для сканирования (%)
100
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Sirona
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:54
01.10.2021

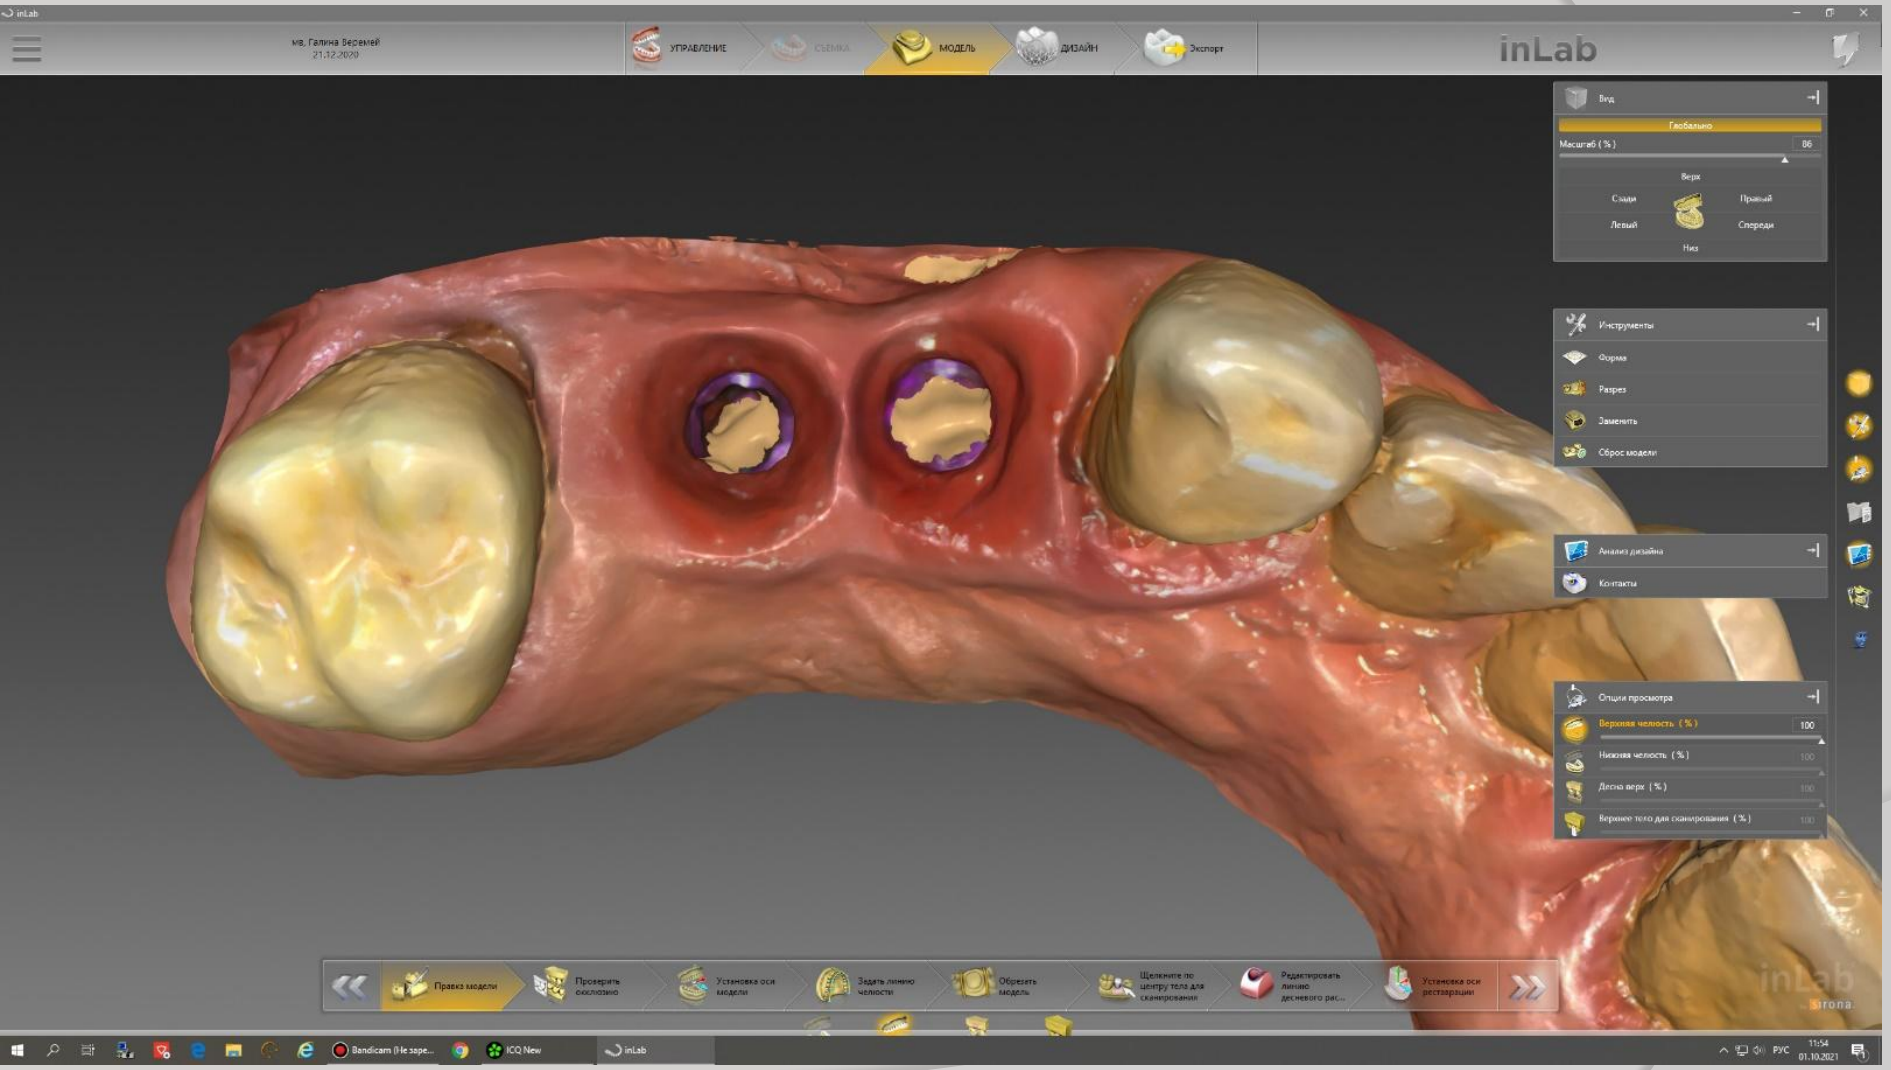
inLab
мв, Галина Веремей
21.12.2020
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
86
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Raspes
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
100
Нижняя челюсть (%)
Десна верх (%)
Верхнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Sirona
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:54
01.10.2021

Primescan

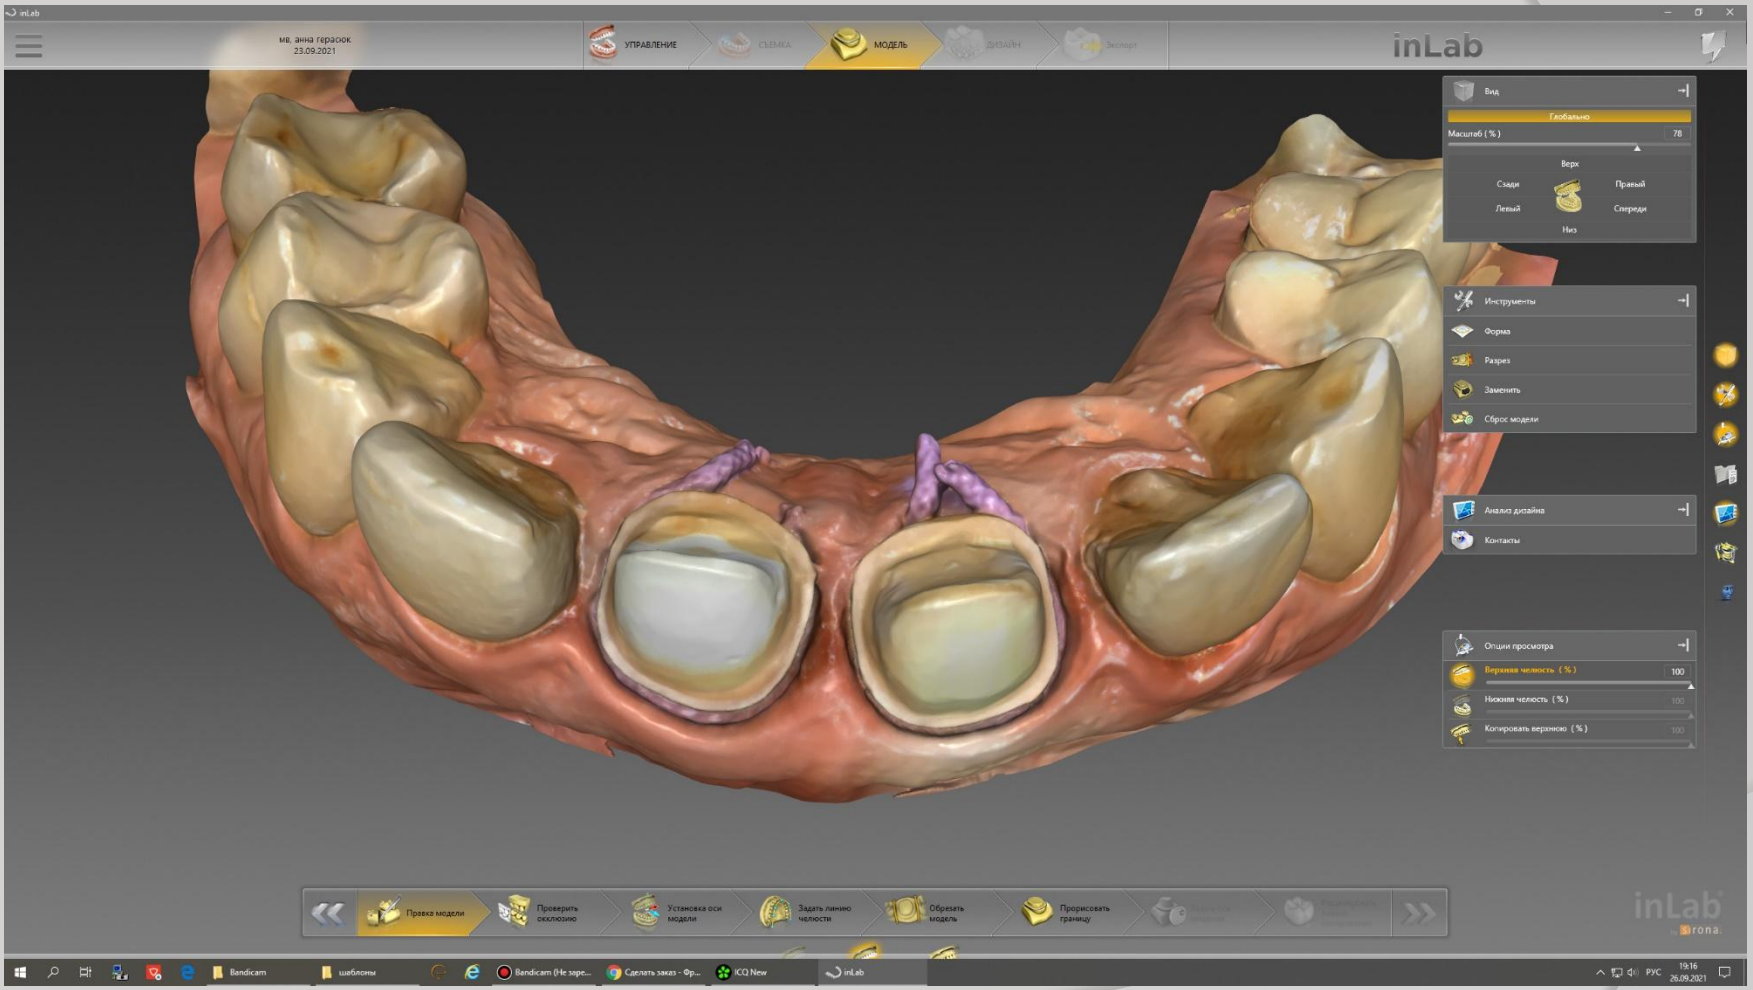
inLab
мв, анна герасюк
23.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
78
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
100
Нижняя челюсть (%)
Копировать верхнюю (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Прорисовать границу
inLab
Sirona
Bandicam
шаблоны
Bandicam (Не зарег...
Сделать заказ - Фр...
ICQ New
inLab
РУС
19:16
26.09.2021

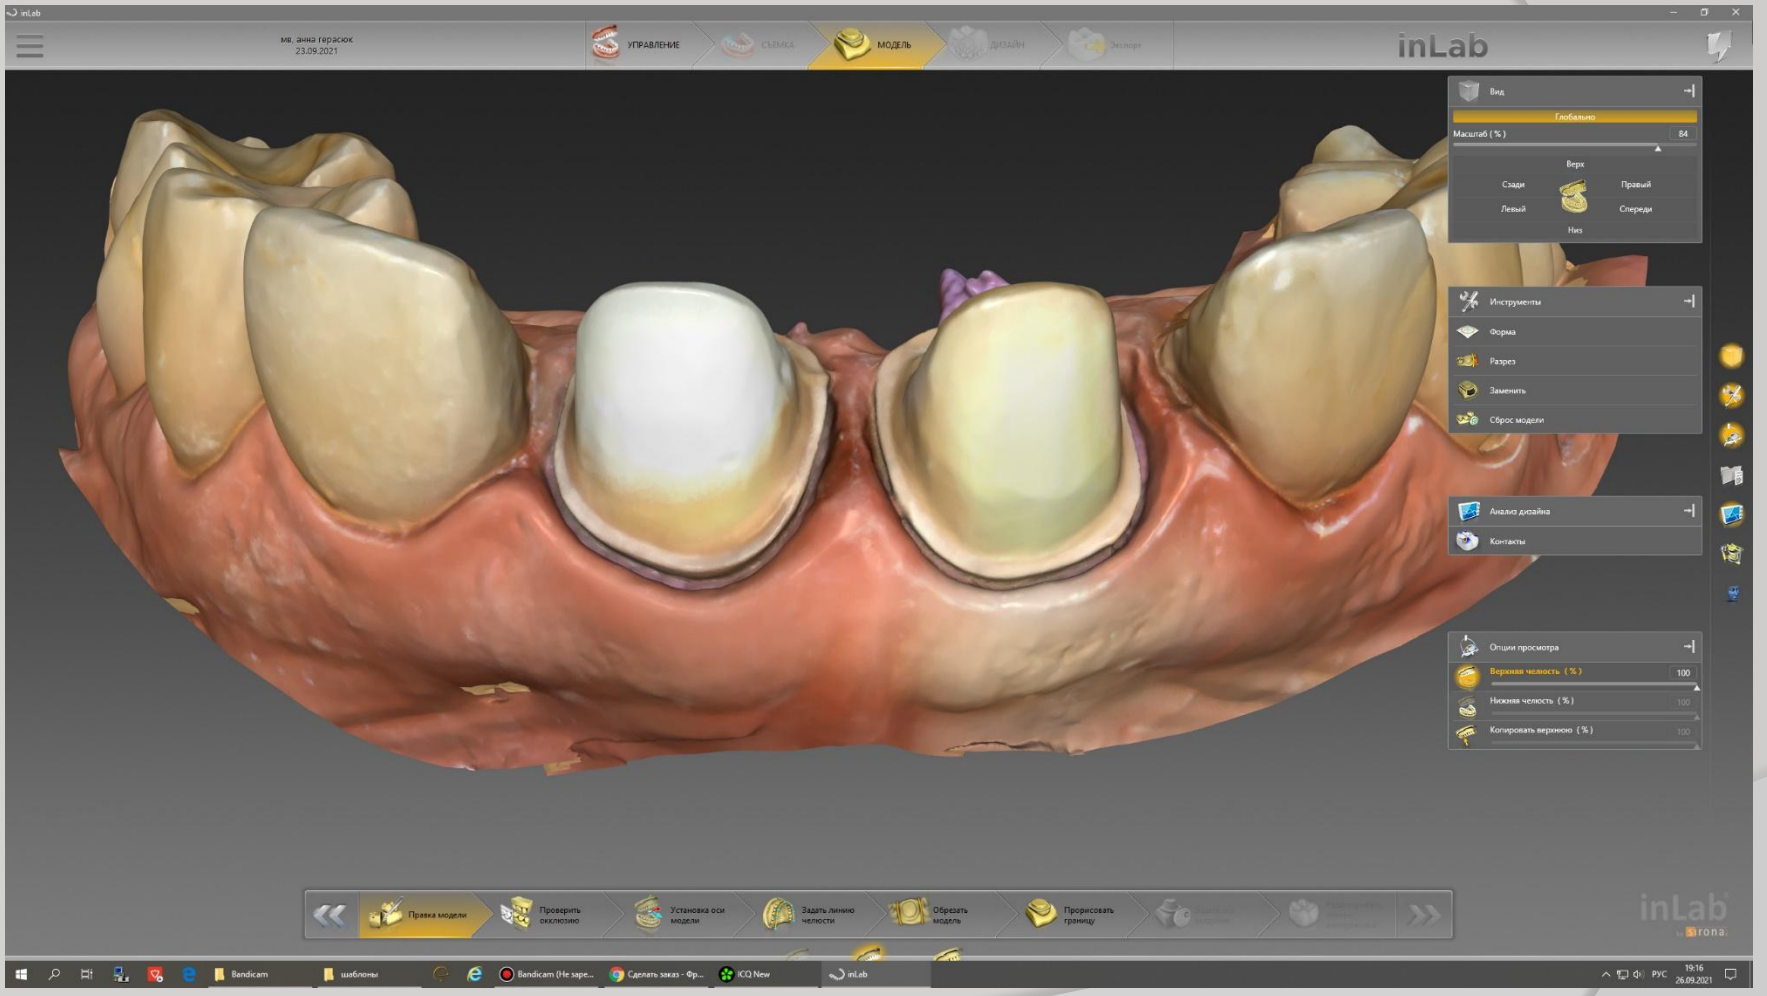
inLab
мя, анна герасюк
23.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
84
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
100
Нижняя челюсть (%)
100
Копировать верхнюю (%)
100
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Прорисовать границу
inLab
by sirona
Bandicam
шаблоны
Bandicam (Не запе...
Сделать заказ - Фр...
ICQ New
inLab
РУС
19:16
26.09.2021

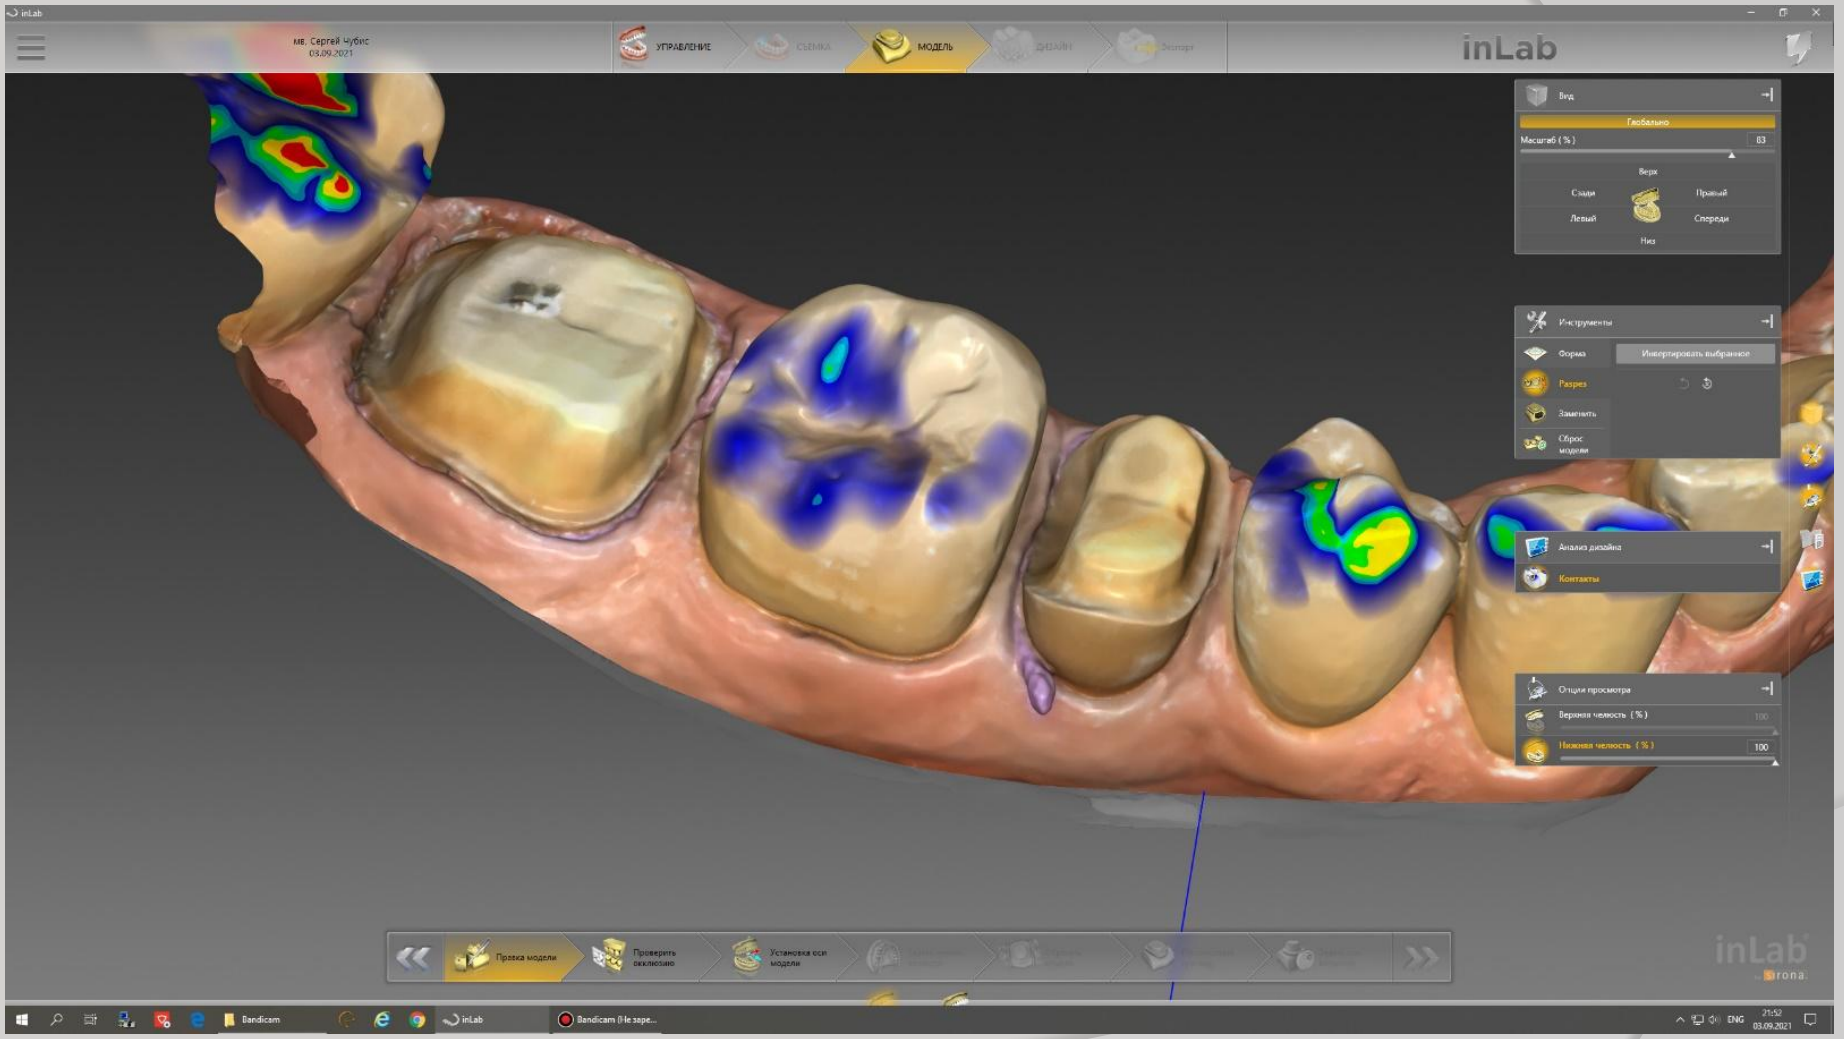
inLab
мв. Сергей Чубис
03.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
83
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Инвертировать выбранное
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
100
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
inLab
Sirona
Bandicam
inLab
Bandicam (Не зарег...
ENG
21:52
03.09.2021

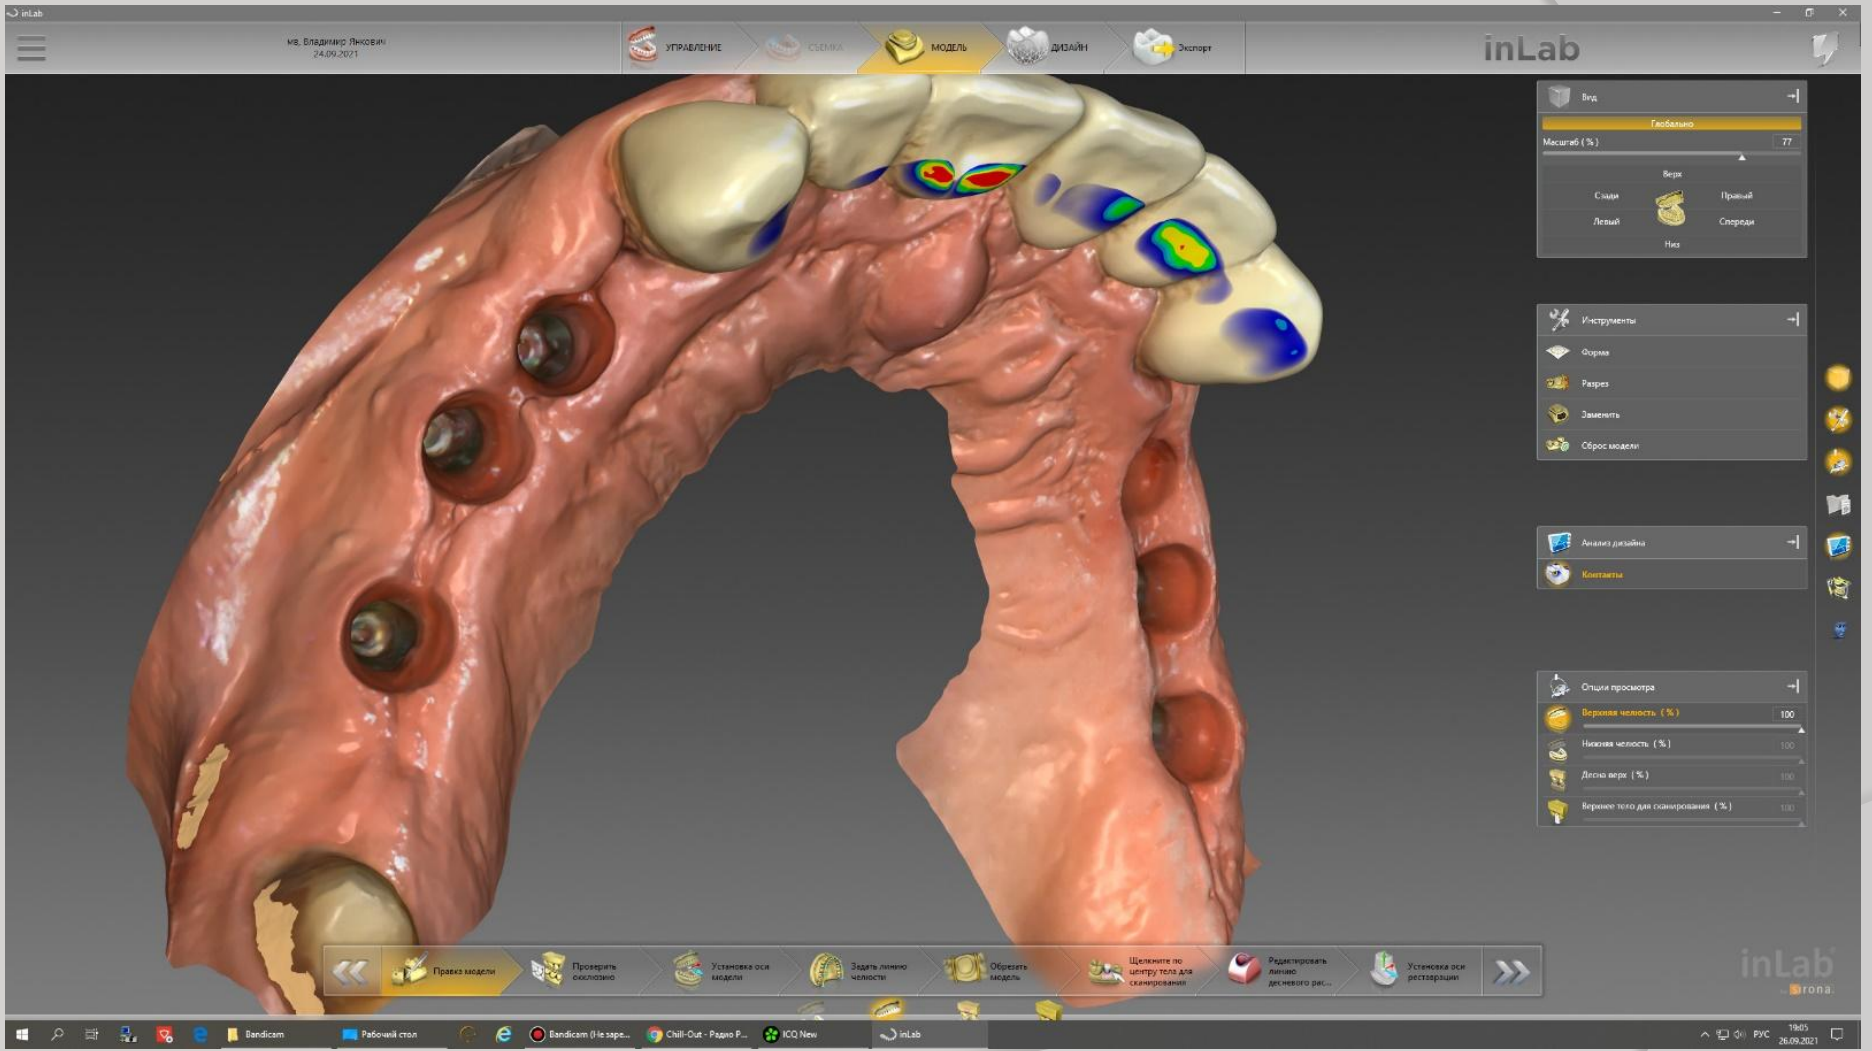
inLab
мв, Владимир Янкович
24.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
77
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
100
Нижняя челюсть (%)
Десна верх (%)
Верхнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Strona
Bandicam
Рабочий стол
Bandicam (Не зарег...
Chill-Out - Радио Р...
ICQ New
inLab
РУС
19:05
26.09.2021

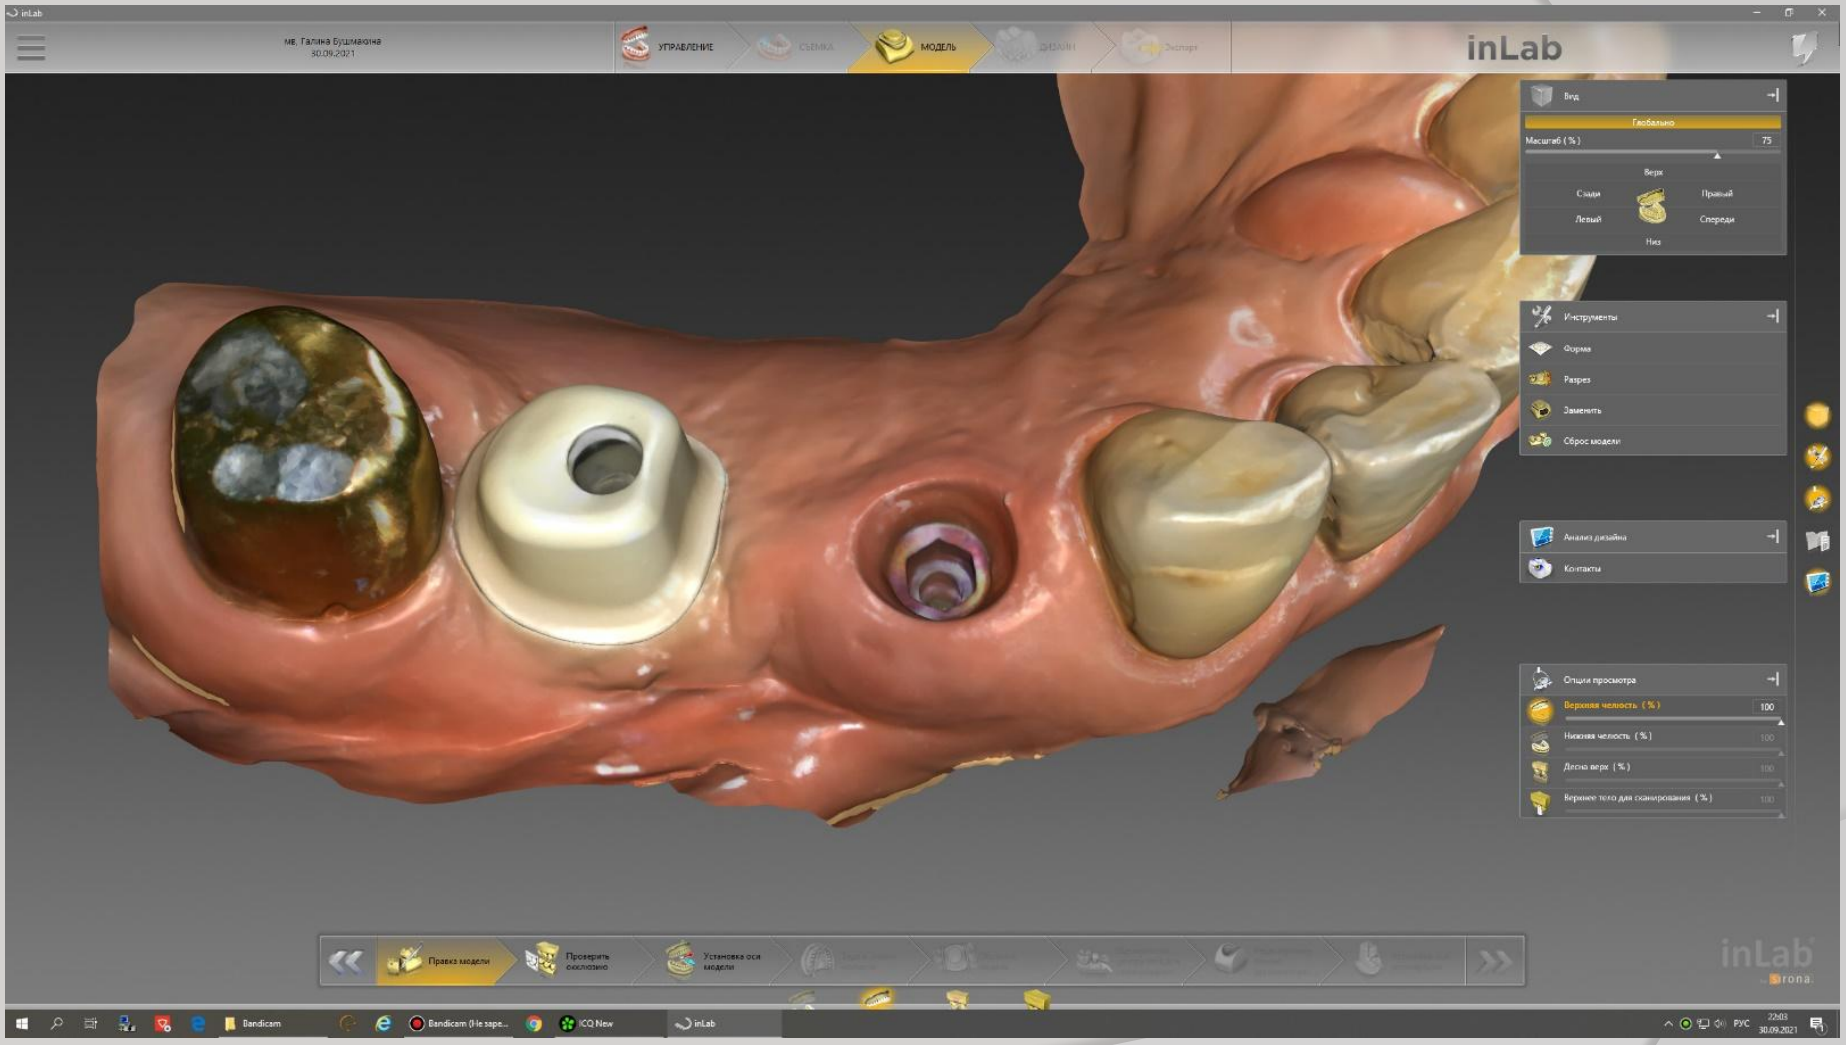
inLab
мв, Галина Бушмакина
30.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
75
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
100
Нижняя челюсть (%)
Десна верх (%)
Верхнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
inLab
by Sirona
Bandicam
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
22:03
30.09.2021

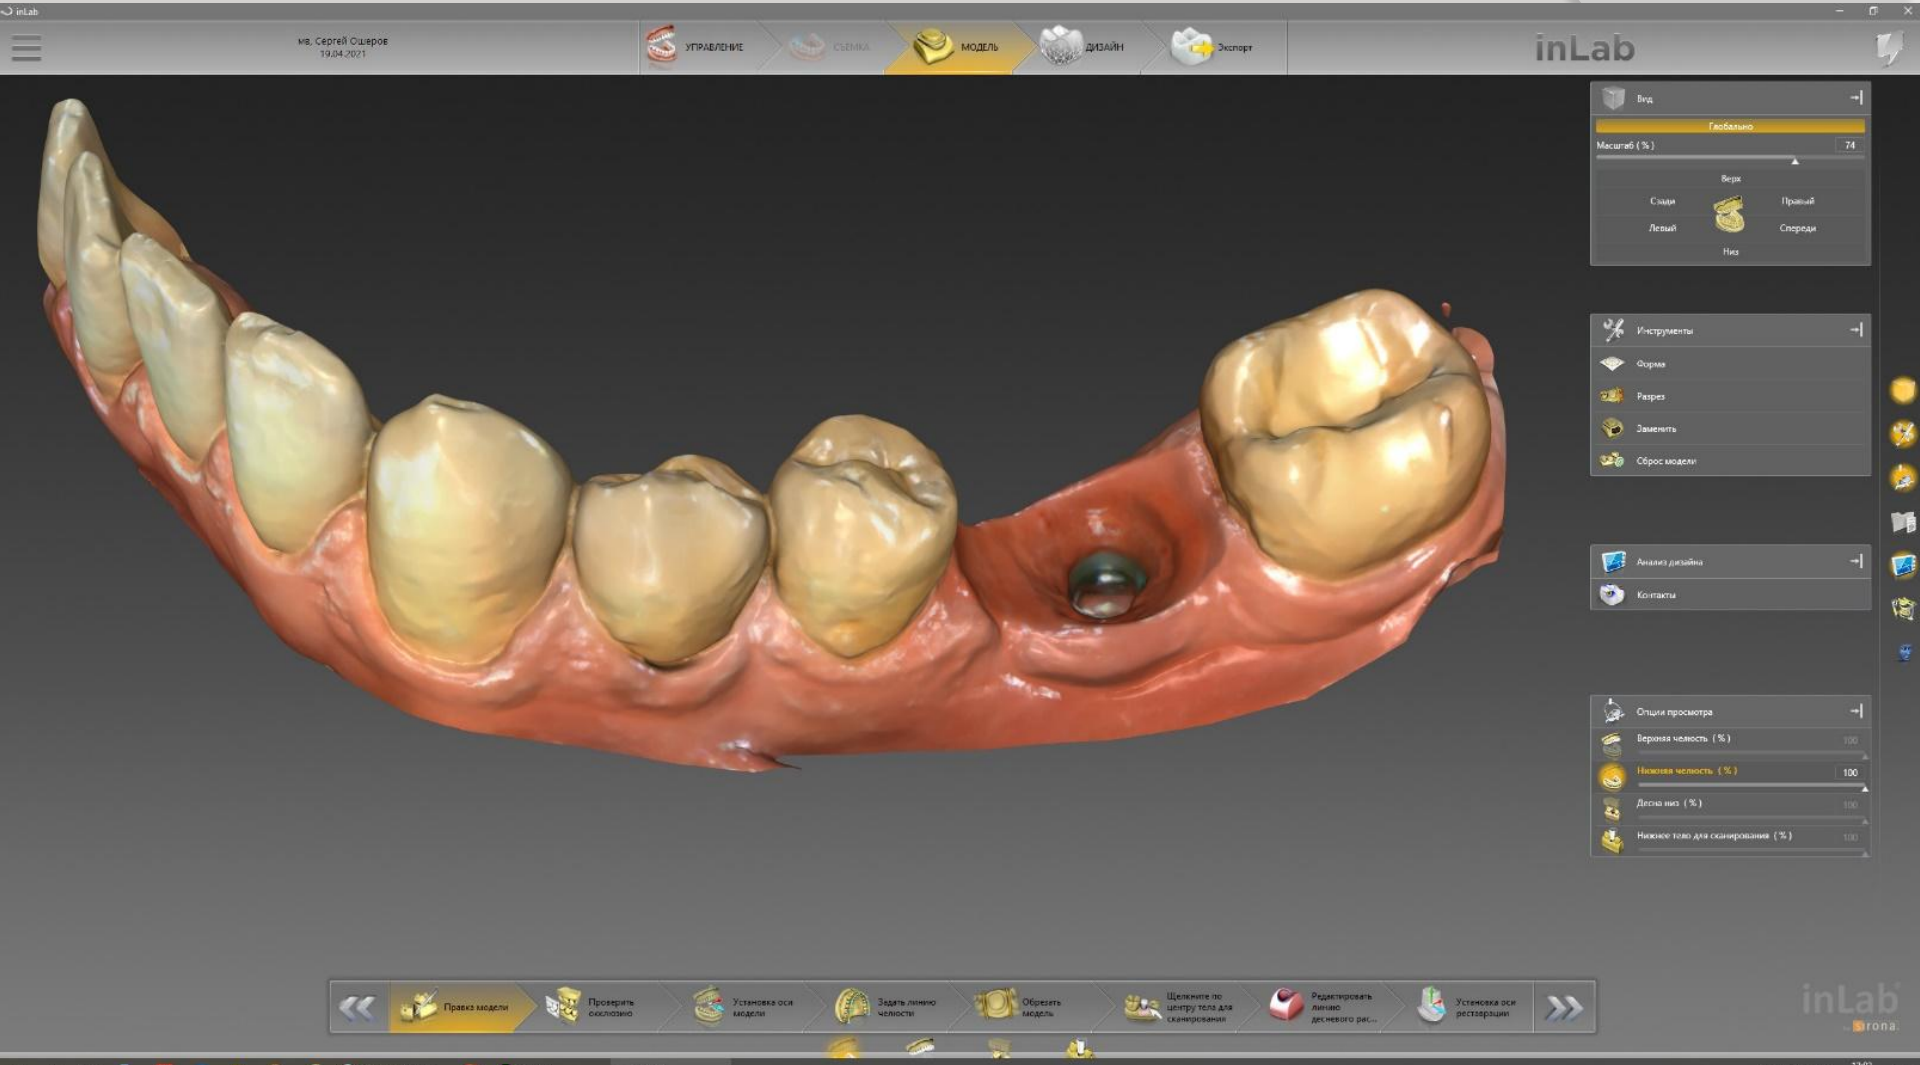
inLab
мв, Сергей Ошеров
19.04.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
74
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
100
Десна низ (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Sirona
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
12:02
01.10.2021

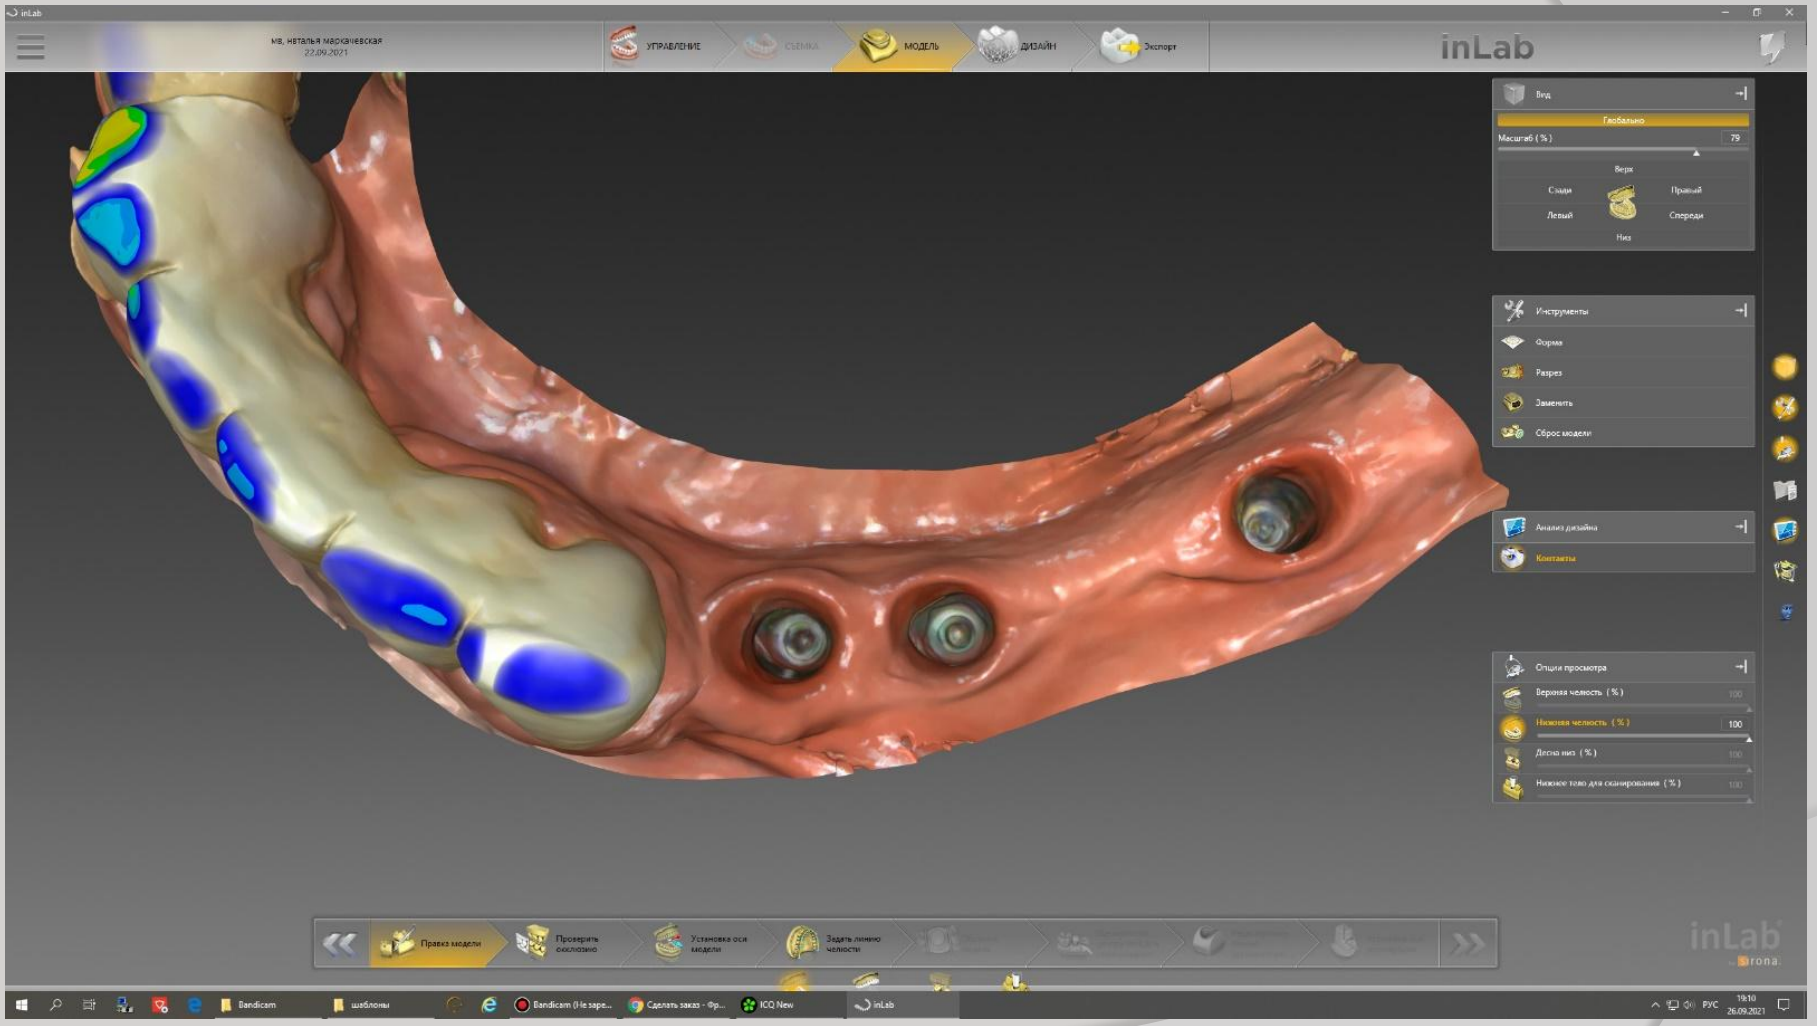
inLab
мв, наталья маскачевская
22.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
79
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
100
Десна низ (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
inLab
Sirona
Bandicam
шаблоны
Bandicam (Не запе...
Сделать заказ - Фр...
ICQ New
inLab
РУС
19:10
26.09.2021

inLab
УПРАВЛЕНИЕ
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
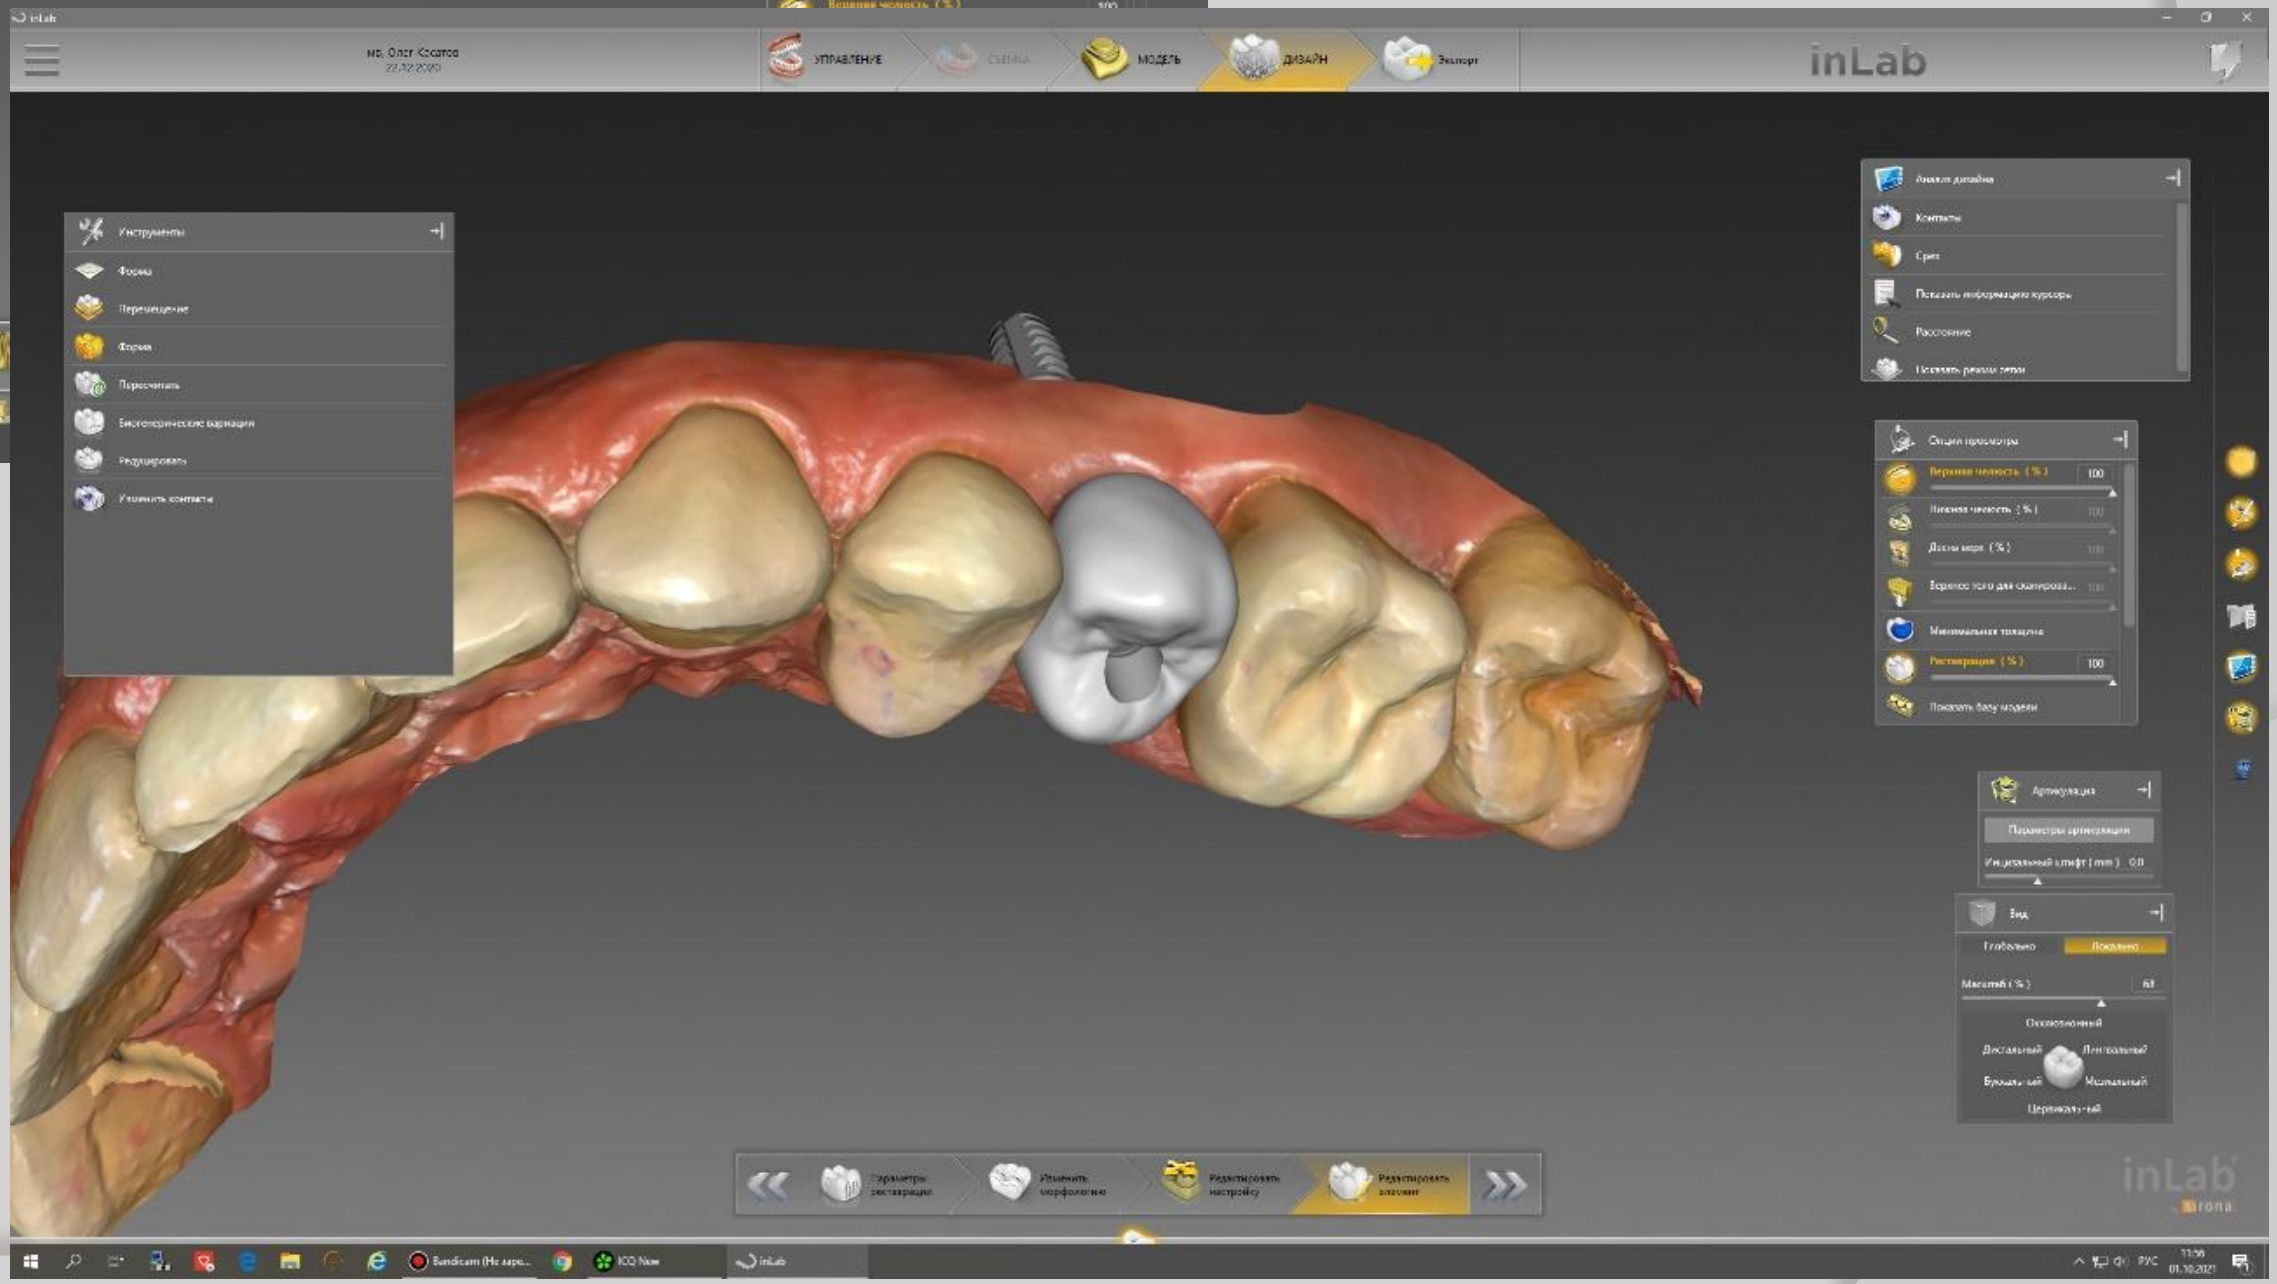
inLab

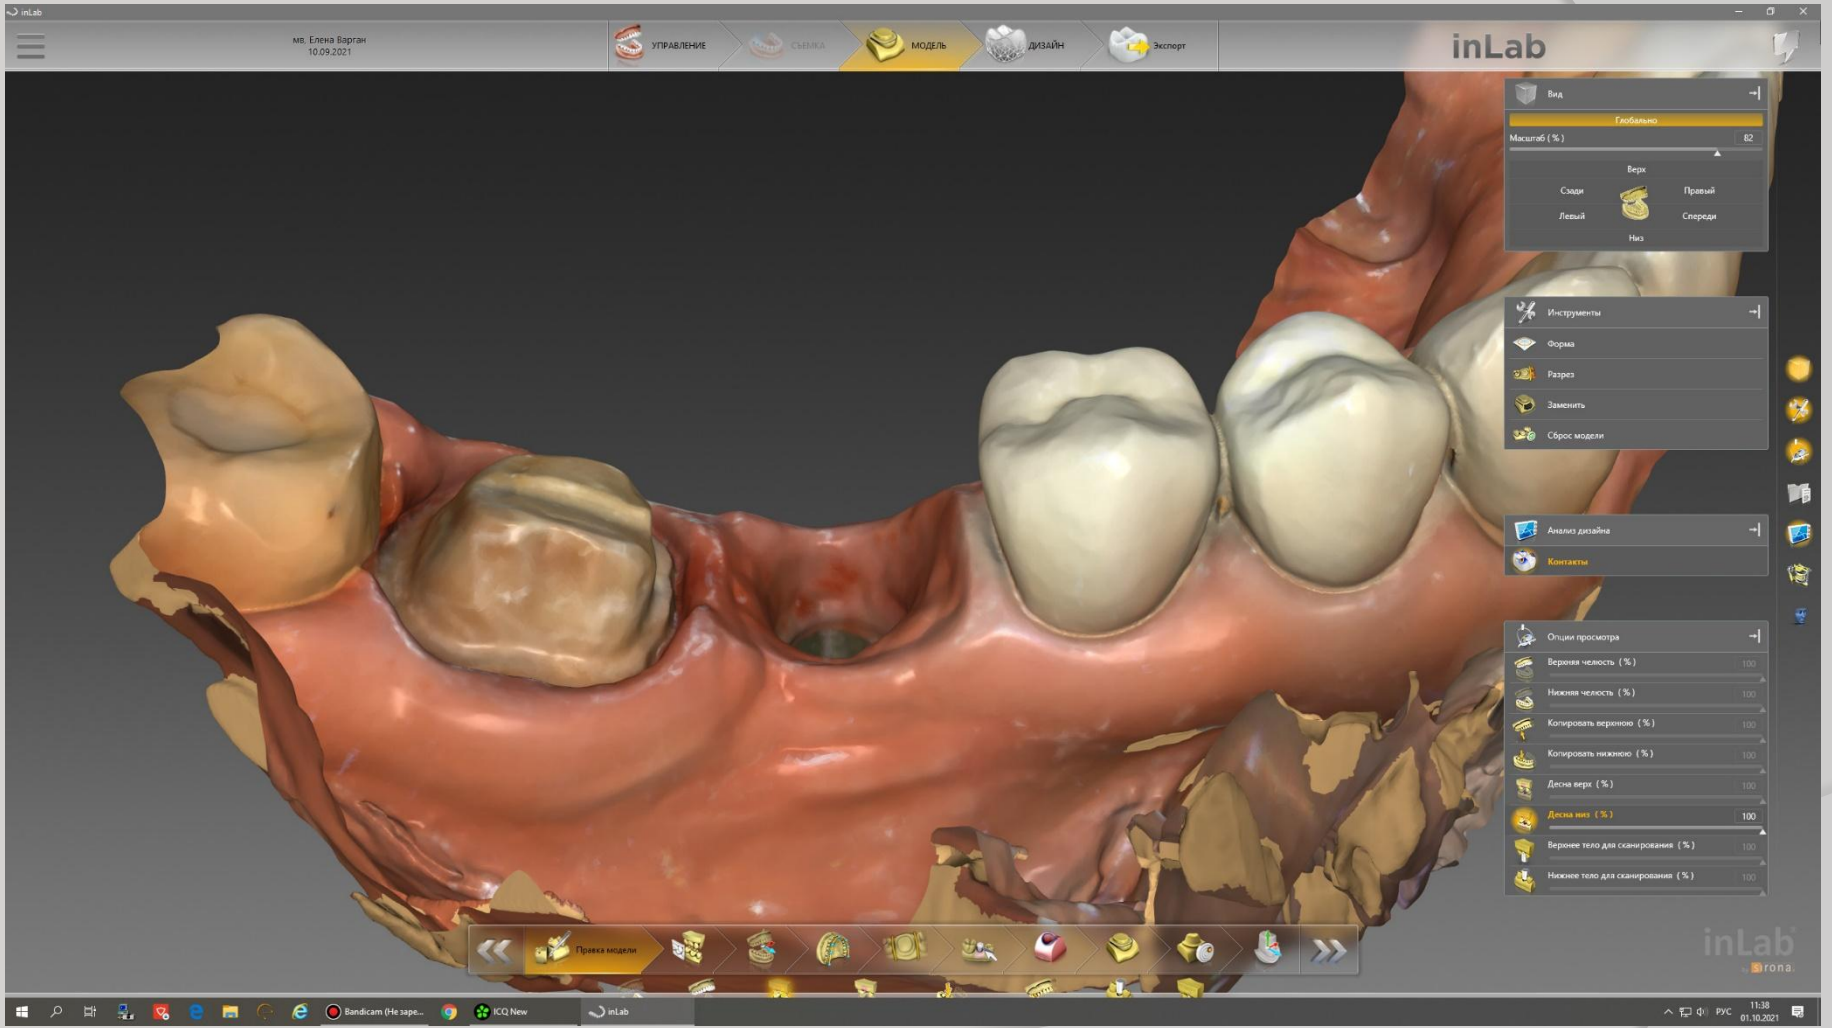
inLab
мв. Елена Варган
10.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
82
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
Копировать верхнюю (%)
Копировать нижнюю (%)
Десна верх (%)
Десна низ (%)
100
Верхнее тело для сканирования (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
inLab
Sirona
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:38
01.10.2021

inLab
мв, Елена Варган
10.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
77
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
Копировать верхнюю (%)
Копировать нижнюю (%)
Десна верх (%)
Десна низ (%)
Верхнее тело для сканирования (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:38
01.10.2021

inLab
мв, Елена Варган
10.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
77
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
Копировать верхнюю (%)
Копировать нижнюю (%)
Десна верх (%)
100
Десна низ (%)
Верхнее тело для сканирования (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
inLab
by Sirona
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:37
01.10.2021

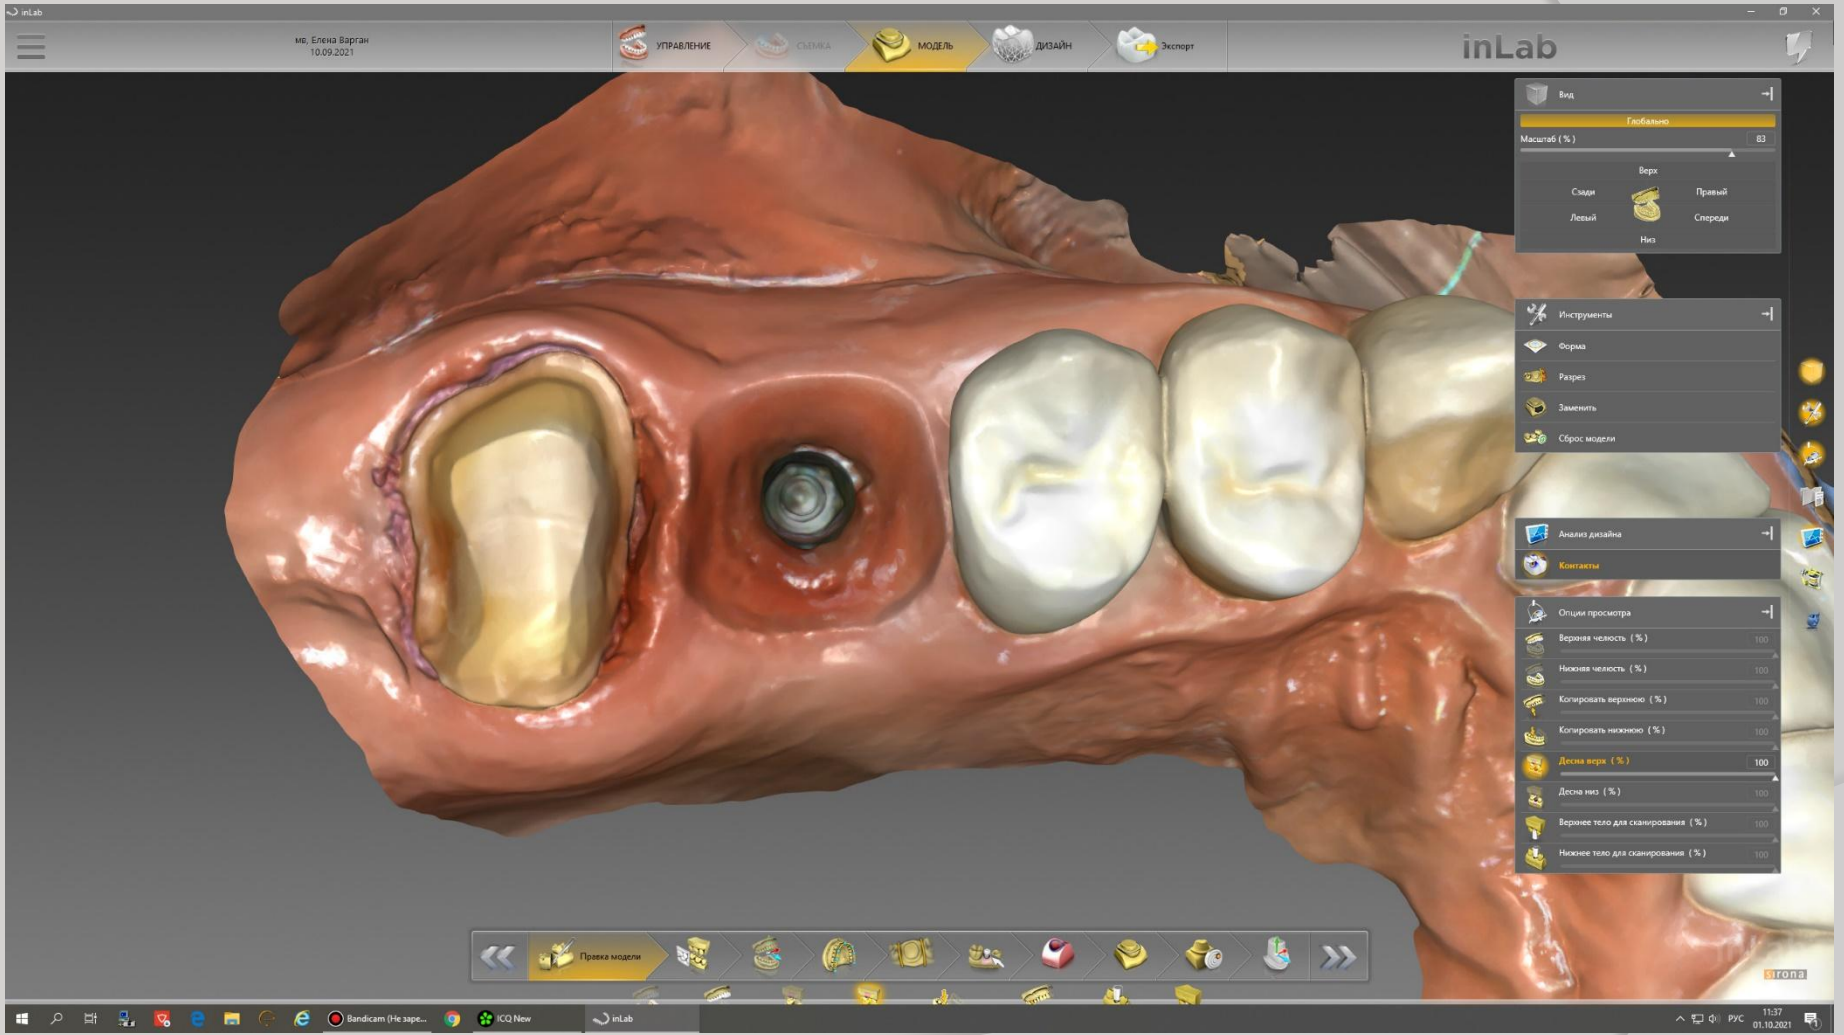
inLab
мр, Елена Варган
10.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
83
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
Нижняя челюсть (%)
Копировать верхнюю (%)
Копировать нижнюю (%)
Десна верх (%)
Десна низ (%)
Верхнее тело для сканирования (%)
Нижнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Bandicam (Не зарег...
ICQ New
inLab
РУС
11:37
01.10.2021

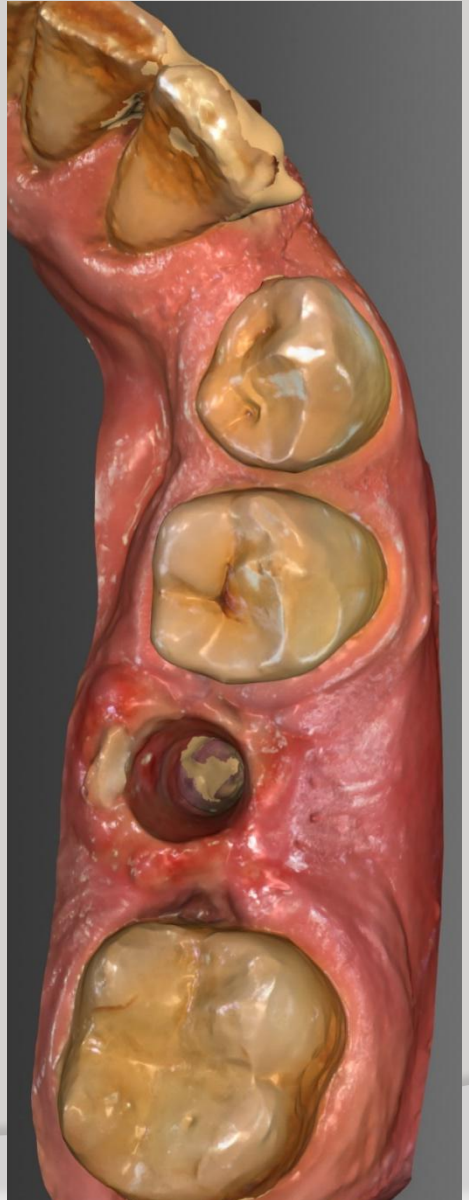
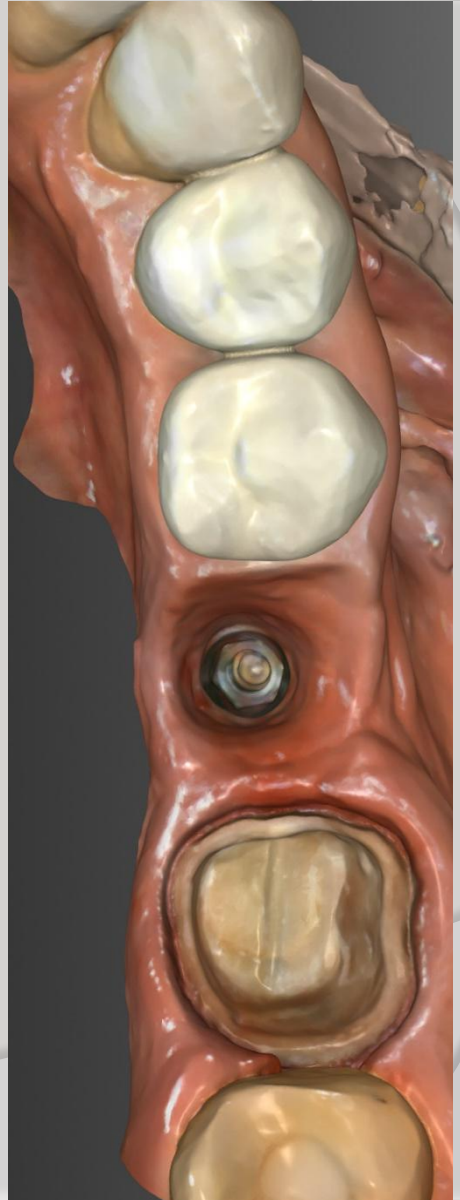

Клинические случаи

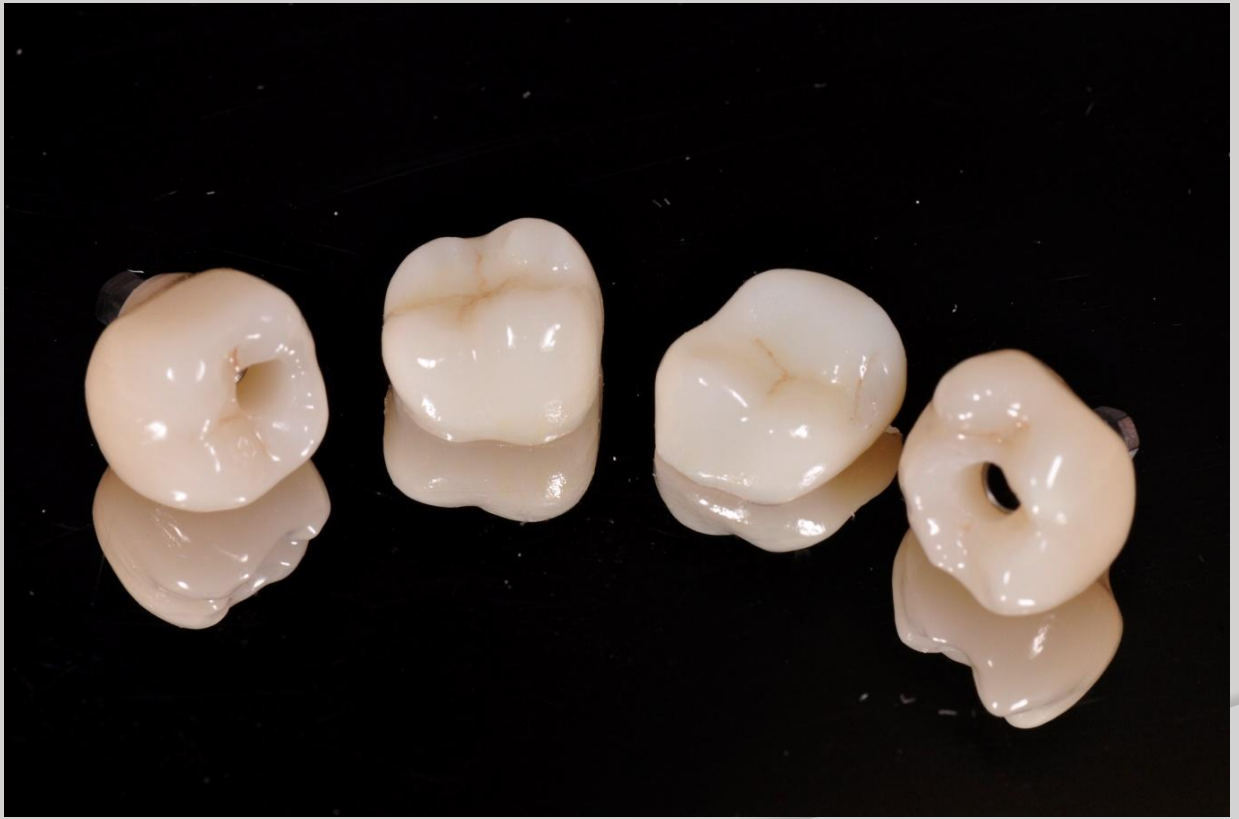

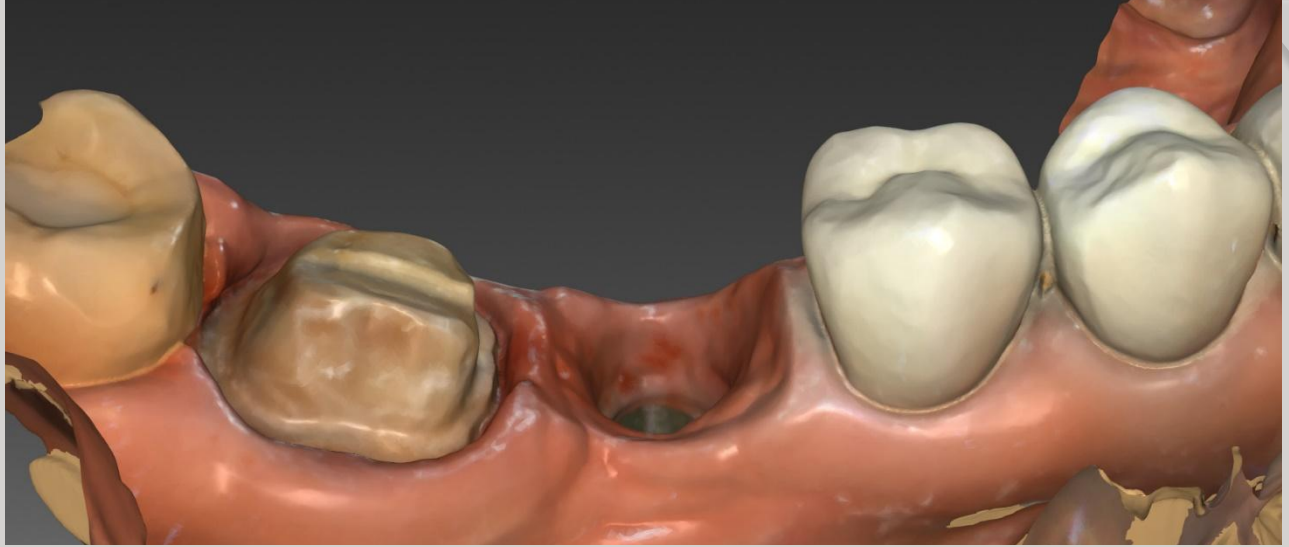

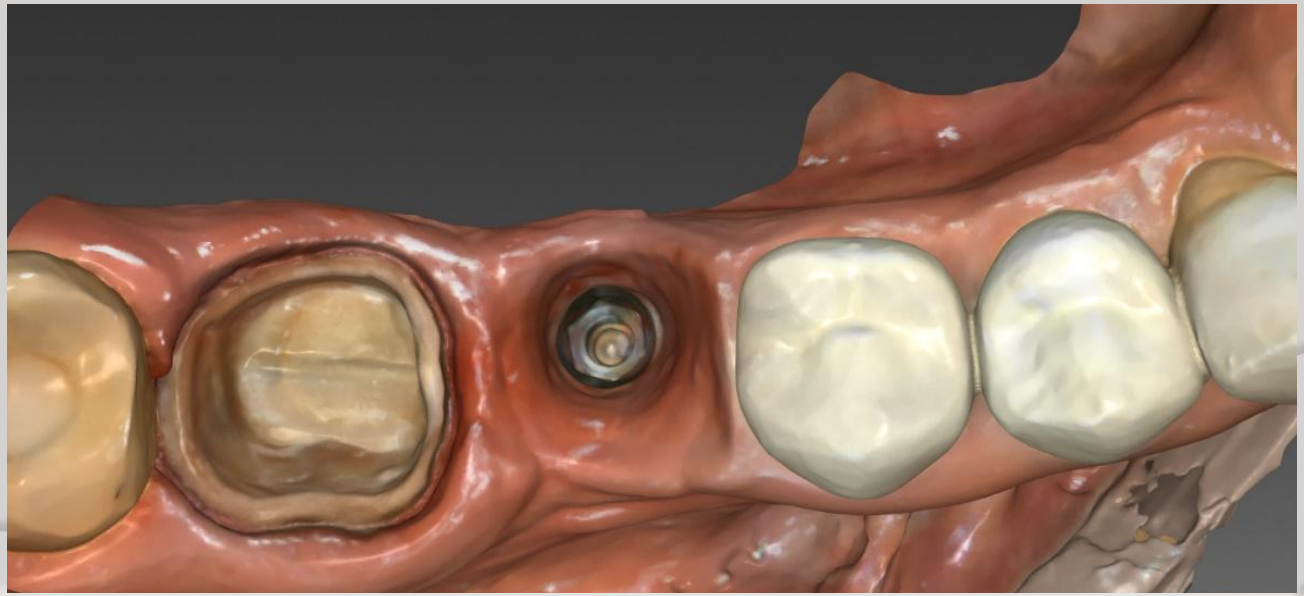

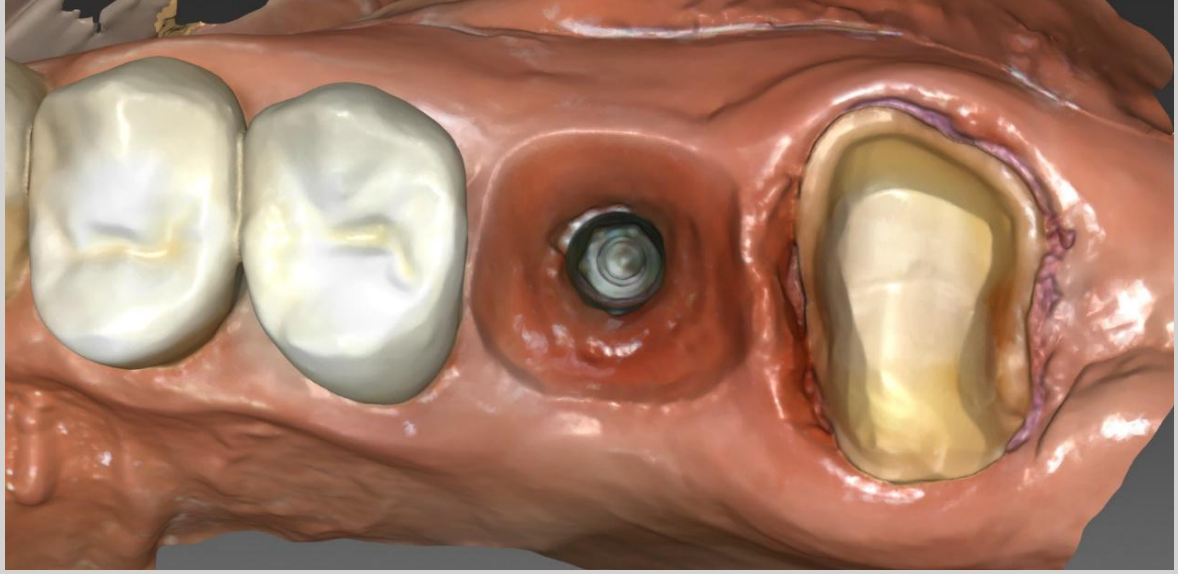

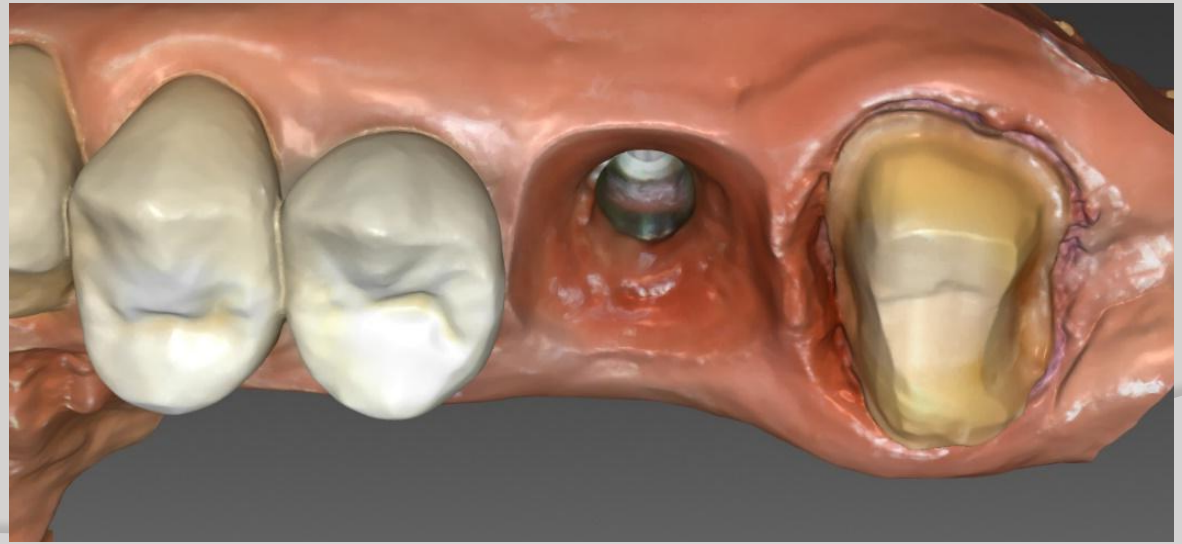

1
3
2

Буккальный
регистрат

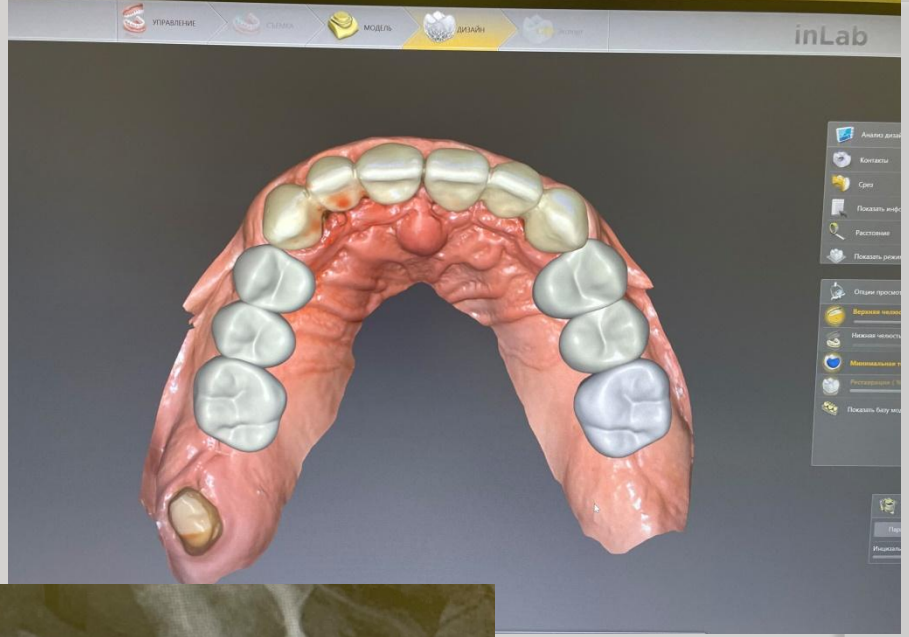
УПРАВЛЕНИЕ
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
inLab

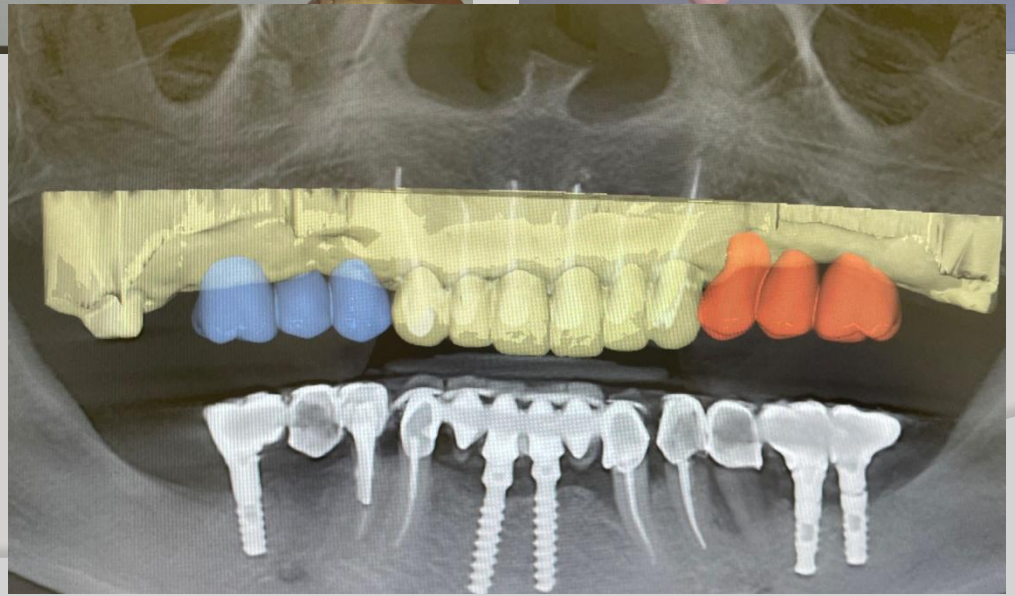

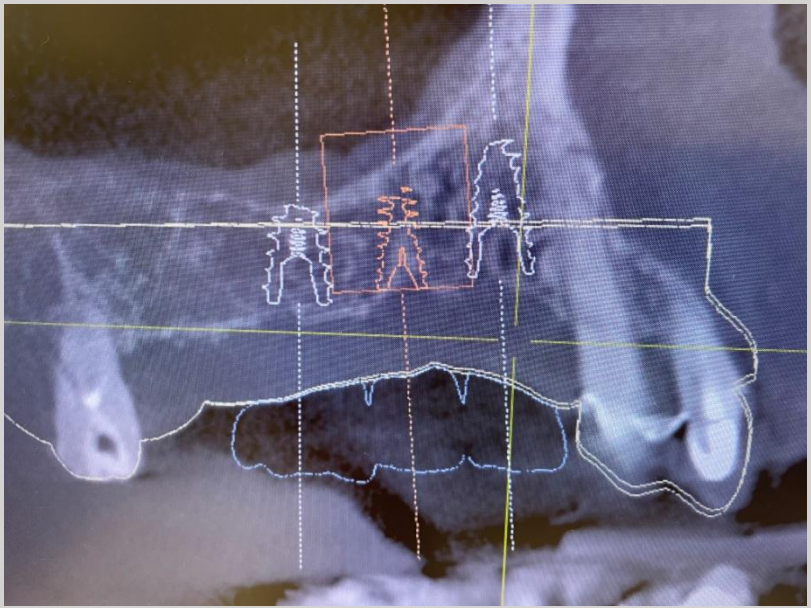

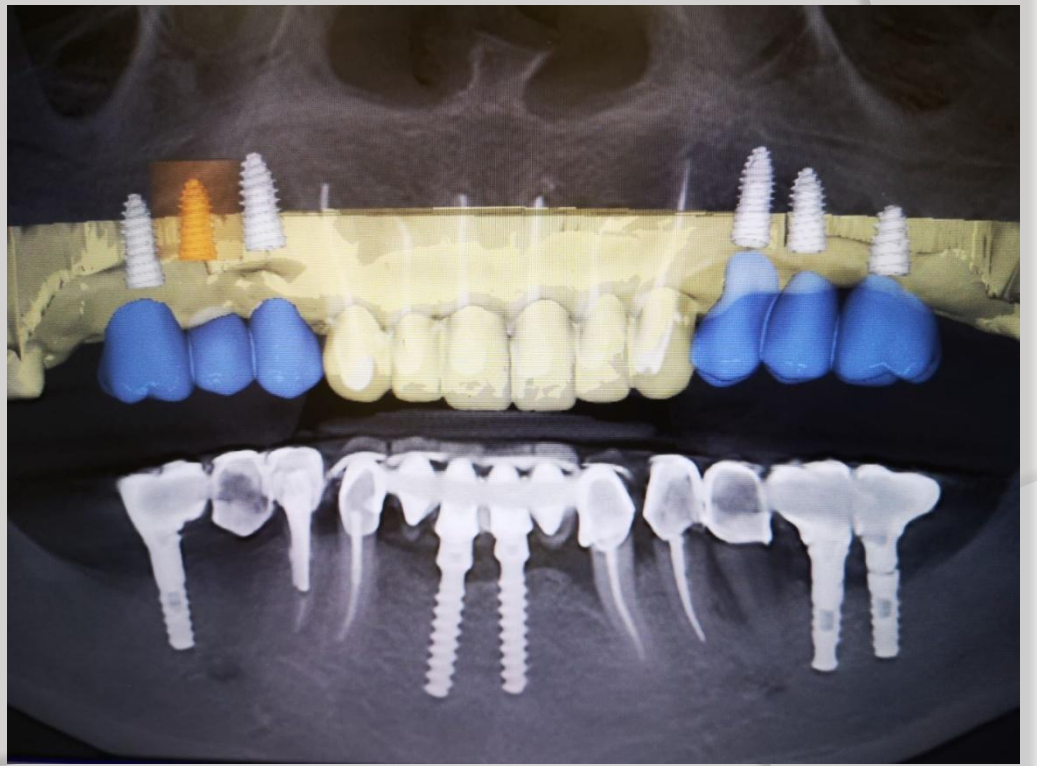

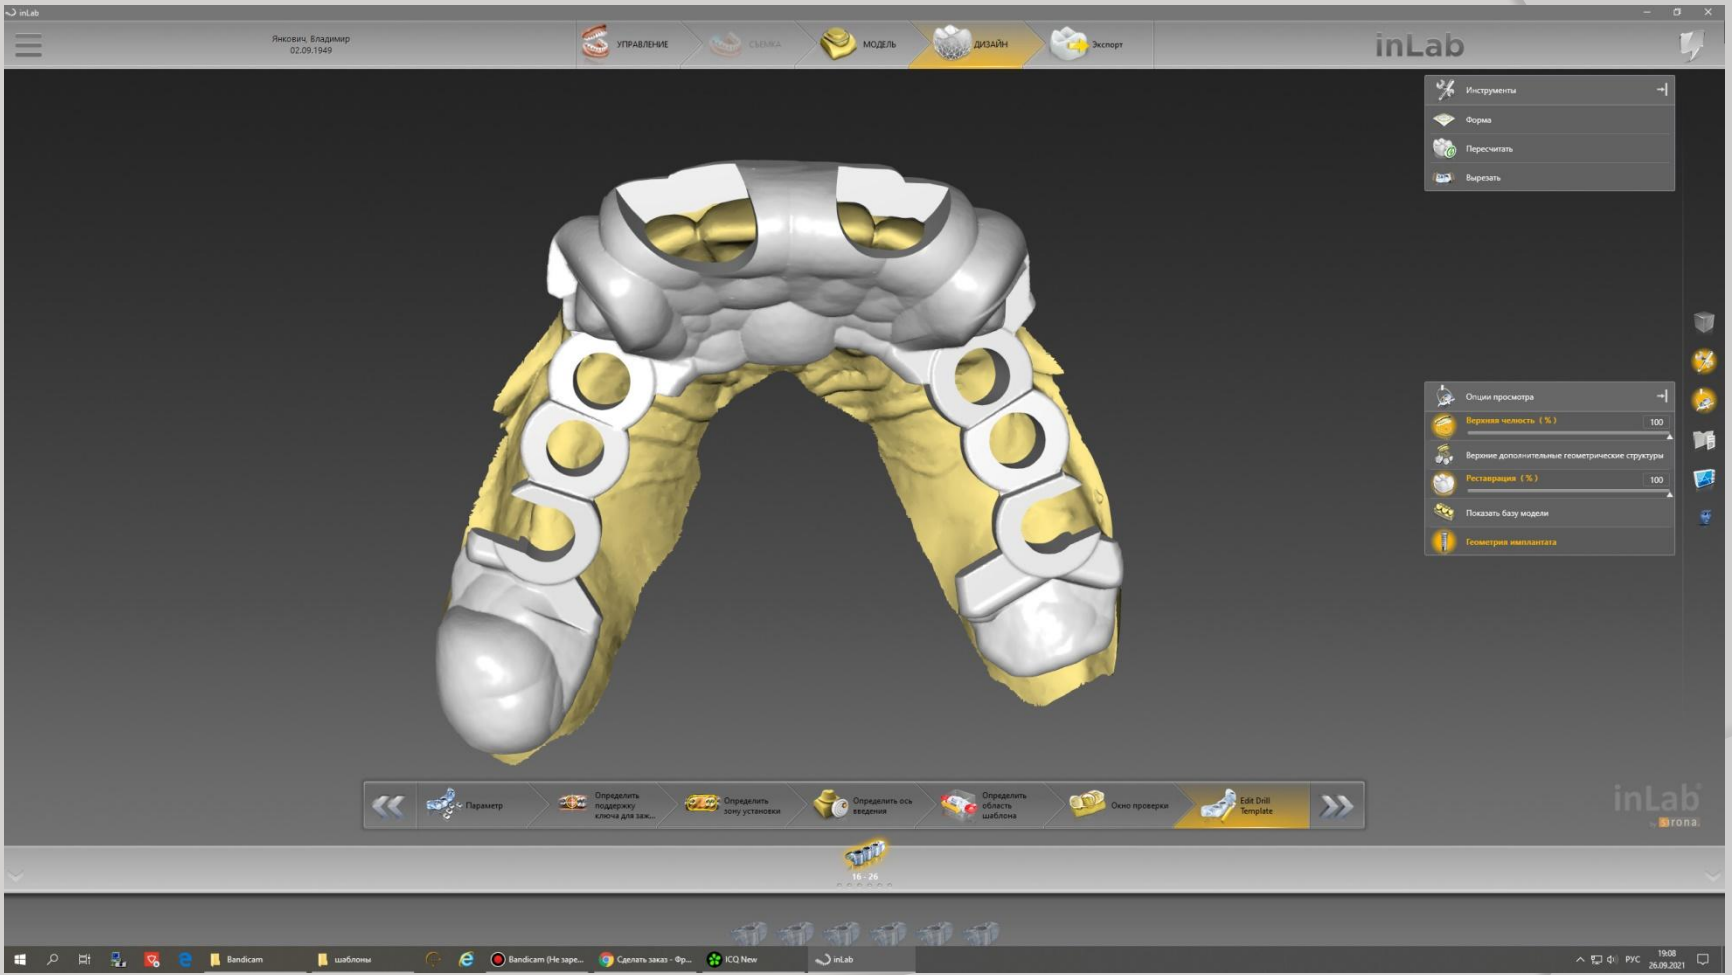
inLab
Янкович Владимир
02.09.1949
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Инструменты
Форма
Пересчитать
Вырезать
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
100
Верхние дополнительные геометрические структуры
Реставрация (%)
100
Показать базу модели
Геометрия имплантата
Параметр
Определить поддержку ключа для зах...
Определить зону установки
Определить ось введения
Определить область шаблона
Окно проверки
Edit Drill Template
inLab
Sirona
16 - 26
Bandicam
шаблоны
Bandicam (Не запе...
Сделать заказ - Фр...
ICQ New
inLab
РУС
19:08
26.09.2021

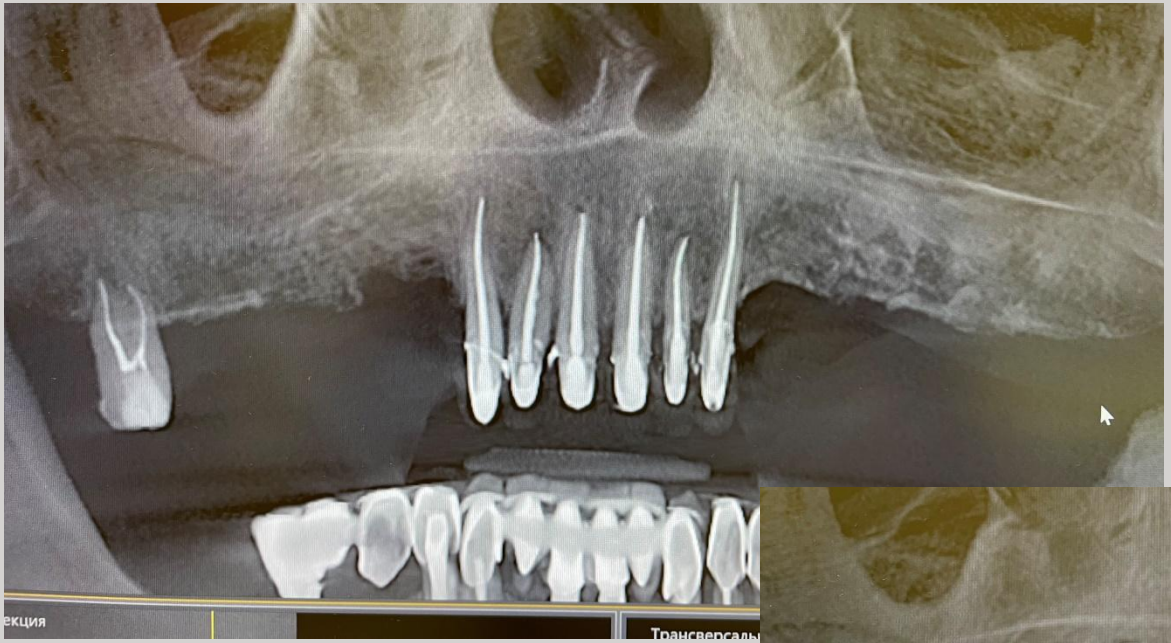

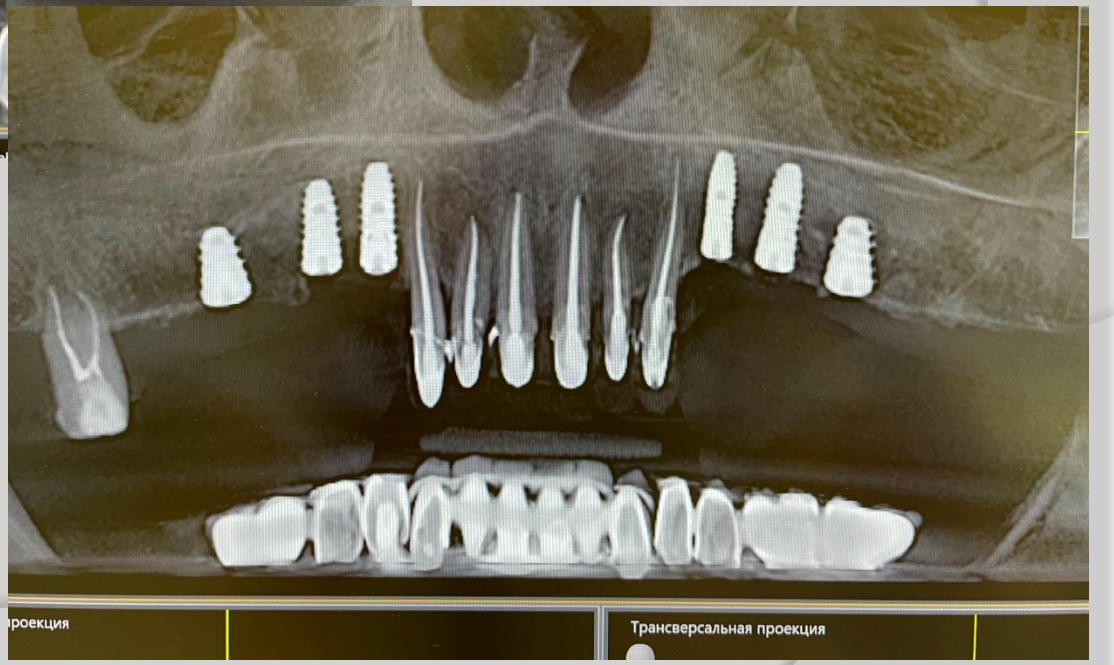
Трансверсальная проекция

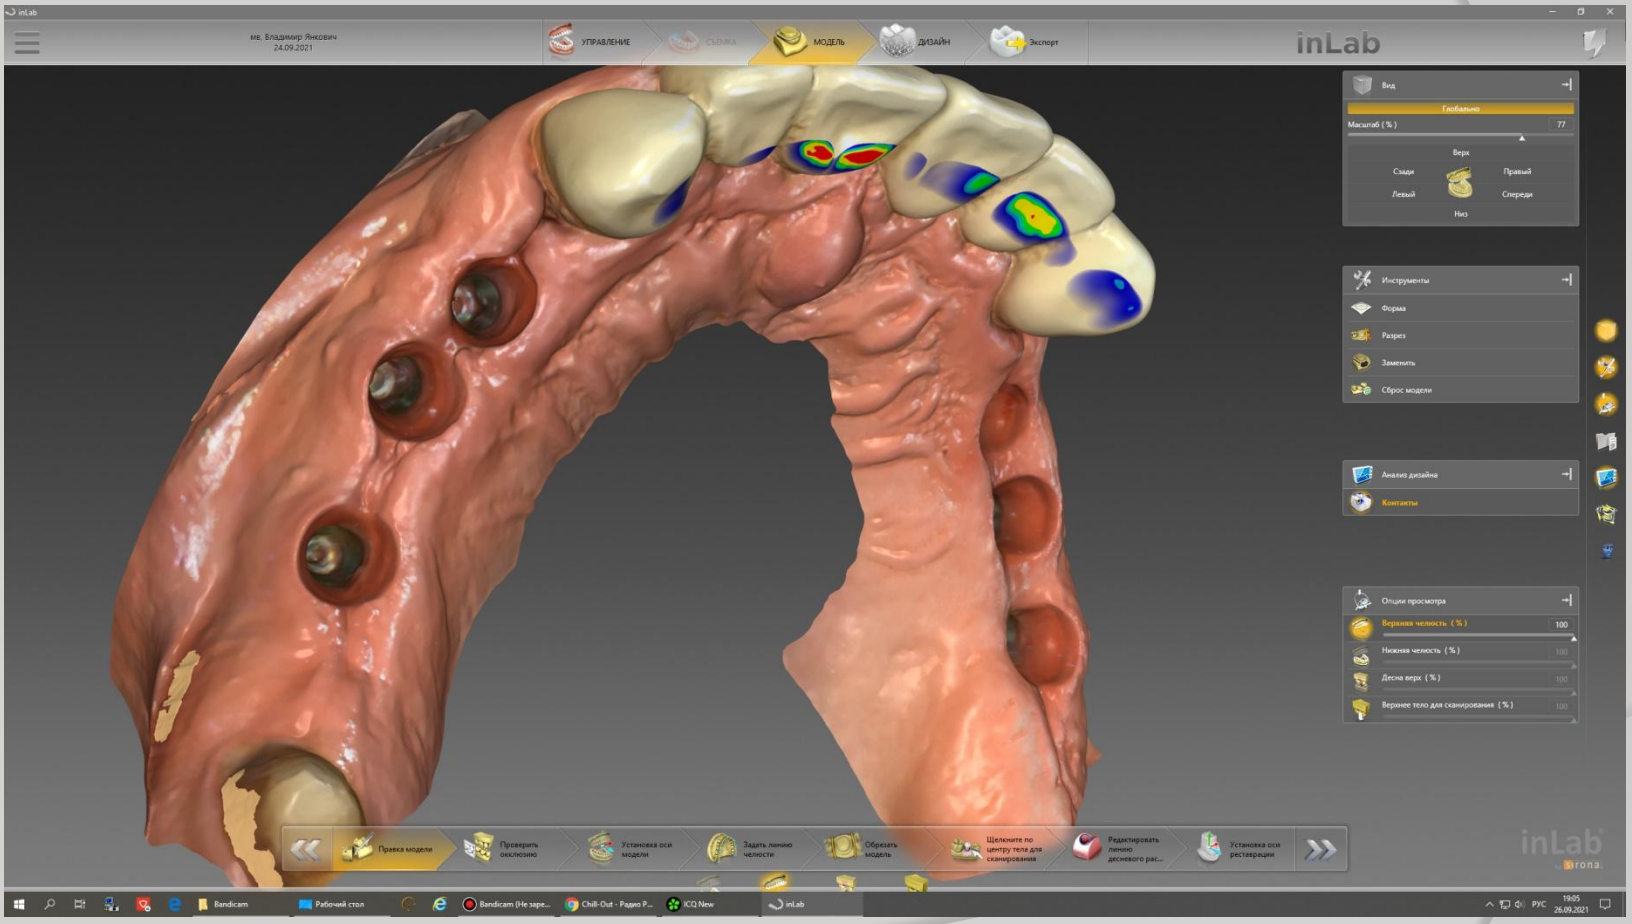
inLab
мв. Владимир Янкович
24.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Вид
Глобально
Масштаб (%)
77
Верх
Сзади
Правый
Левый
Спереди
Низ
Инструменты
Форма
Разрез
Заменить
Сброс модели
Анализ дизайна
Контакты
Опции просмотра
Верхняя челюсть (%)
100
Нижняя челюсть (%)
Десна верх (%)
Верхнее тело для сканирования (%)
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Bandicam
Рабочий стол
Bandicam (Не запи...
Chill-Out - Радио Р...
ICQ New
inLab
РУС
19:05
26.09.2021

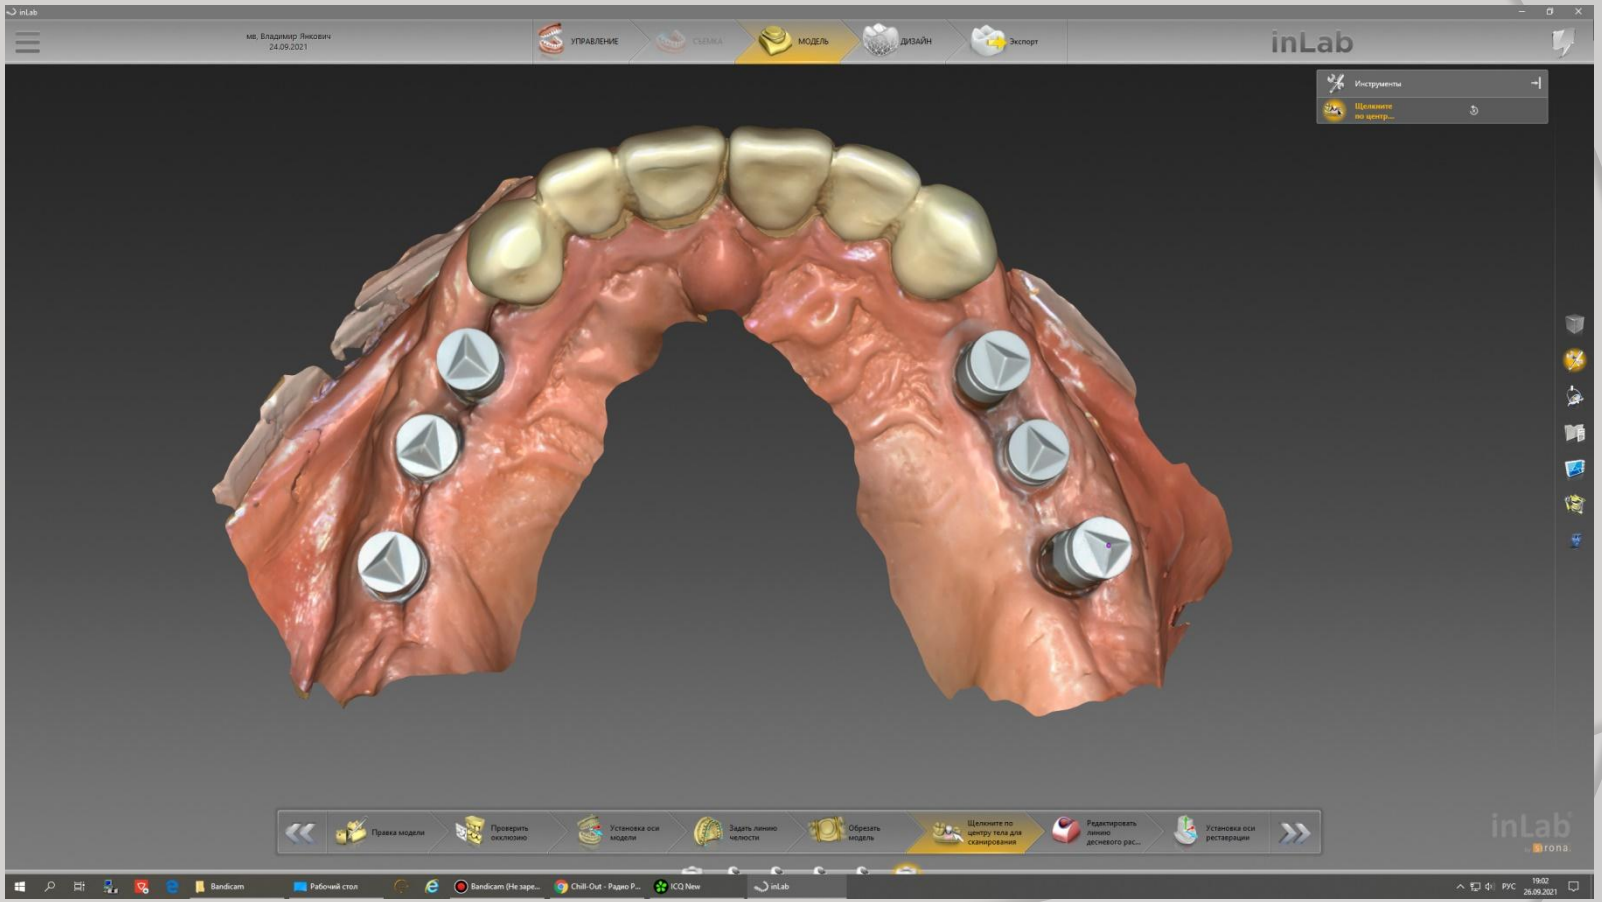
inLab
мв, Владимир Янкович
24.09.2021
УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕМКА
МОДЕЛЬ
ДИЗАЙН
Экспорт
inLab
Инструменты
Щелкните по центр...
Правка модели
Проверить окклюзию
Установка оси модели
Задать линию челюсти
Обрезать модель
Щелкните по центру тела для сканирования
Редактировать линию десневого рас...
Установка оси реставрации
inLab
Bandicam
Рабочий стол
Bandicam (Не запе...
Chill-Out - Радио Р...
ICQ New
inLab
РУС
19:02
26.09.2021

inLab

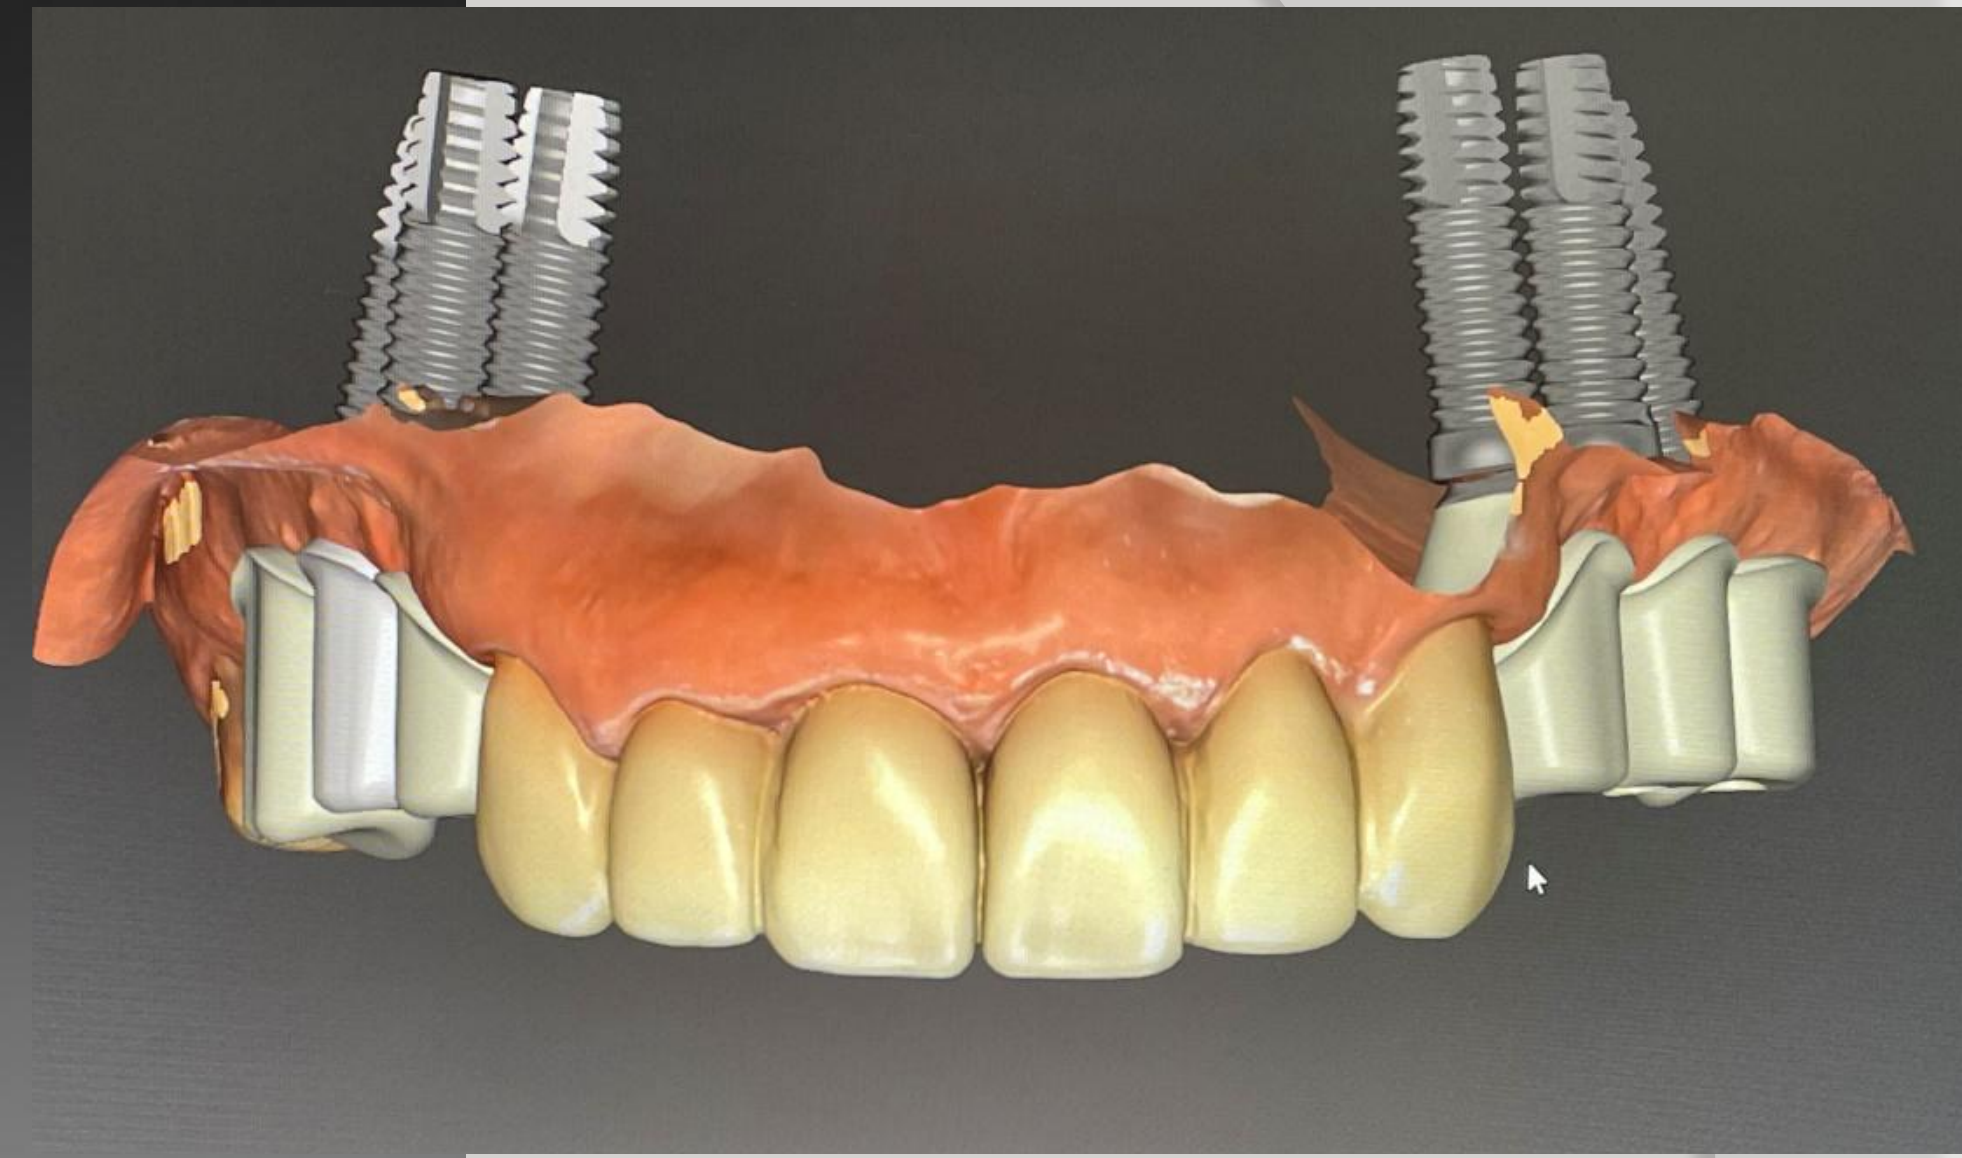

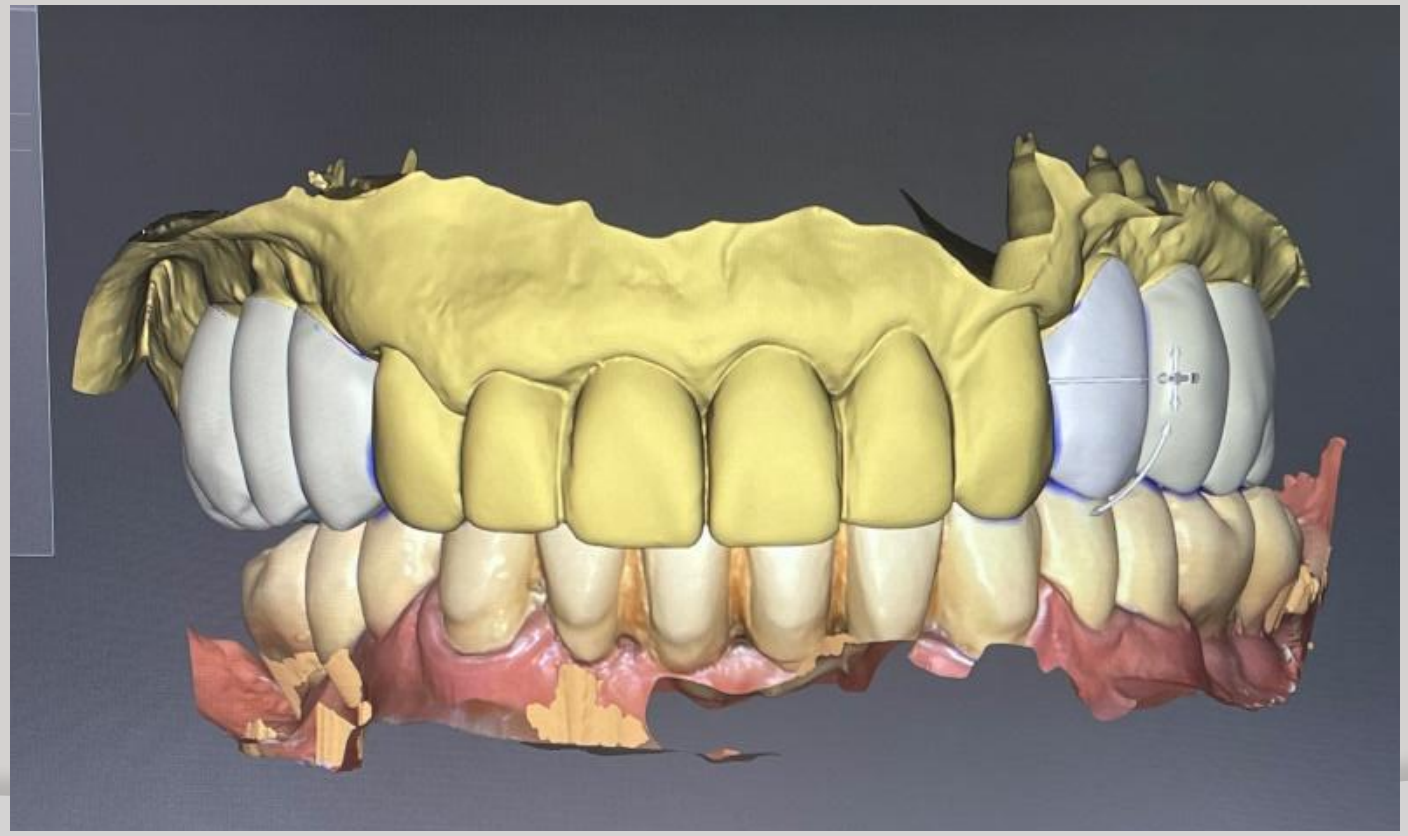

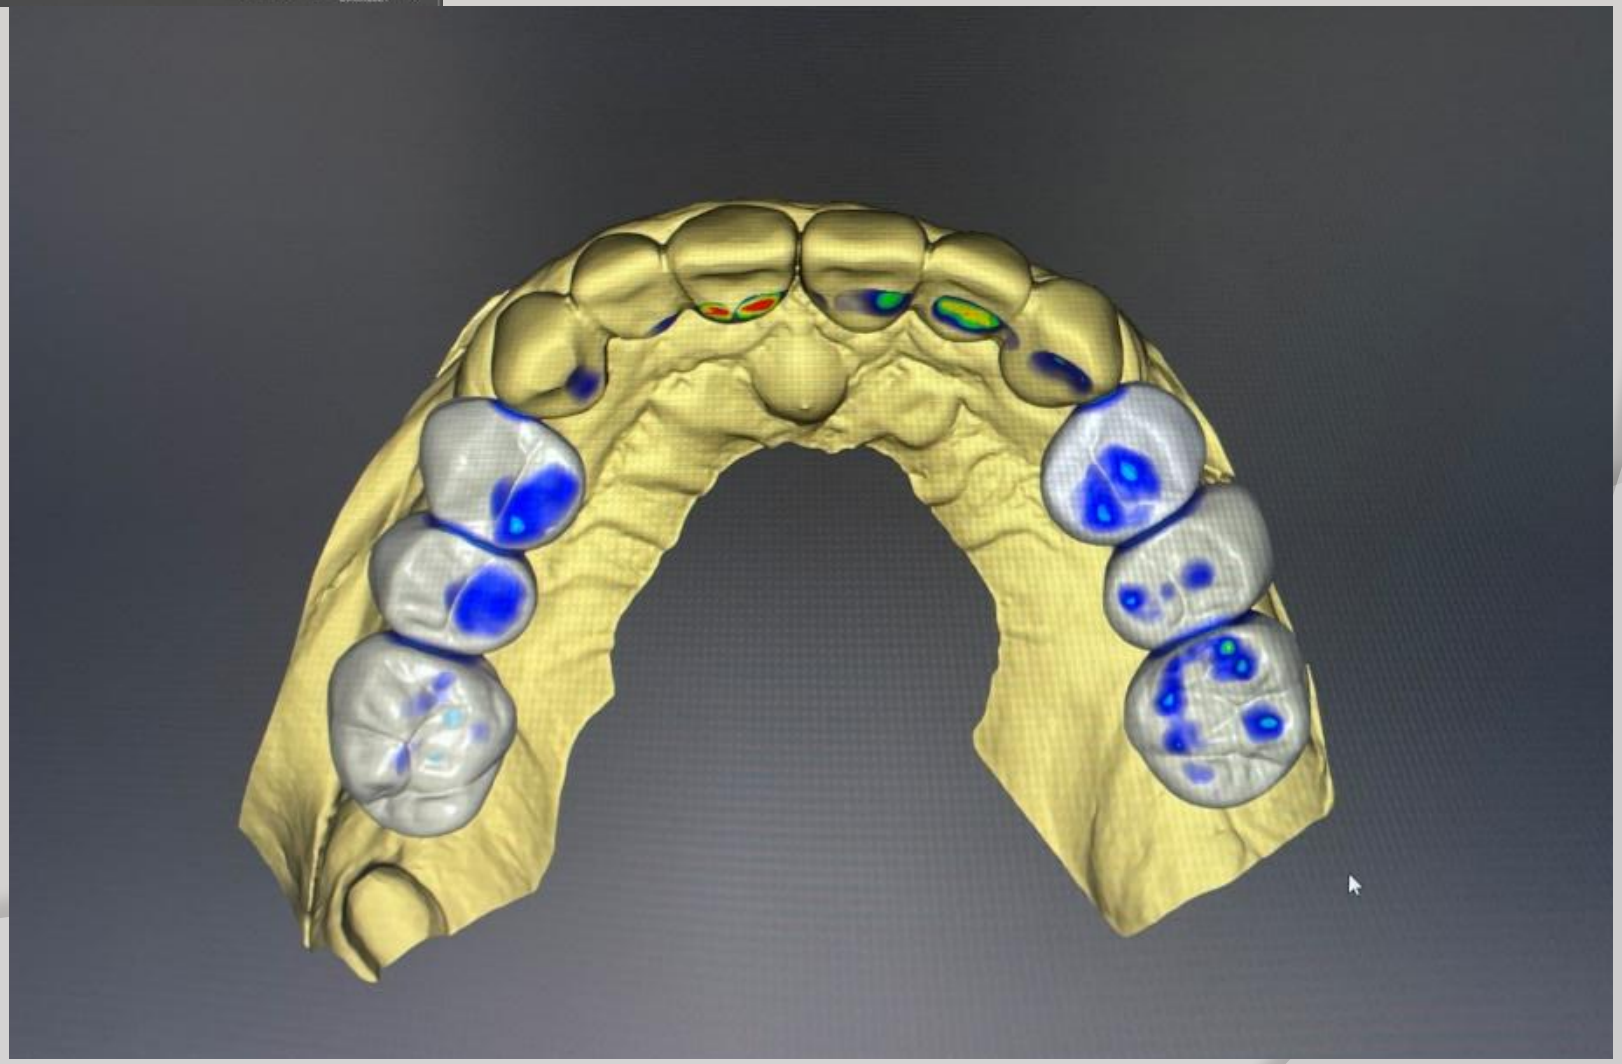

Благодарю за внимание!

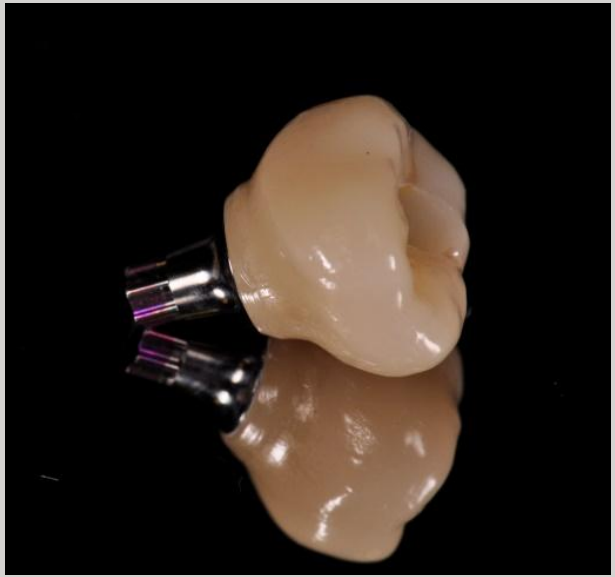

vikadent@gmail.com

vika_manatina

Вика Манатина