


ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՐԹԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՐԹԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ



The Crash Cart

ՉՄԾՕՐՉՕՐԵՆԷ ՎՊՄԱՕՆՆԱՅԻՆ ԻՉԾԱՅԻՆ ԱՉԾՉՄ



The Crash Cart -ի նմուշ

“The Crash Cart” բառացիորեն թարգմանվում է «վթարային սայլակ»: Երբեմն անվանում են **“Code Cart”**: **“Code”** բառը, ծագման ոչ հայերեն լինելով, այնուամենայնիվ մեր Կենտրոնում լայնորեն կիրառվում է մի քանի իմաստով, որոնցից առավել հաճախ կարելի է լսել.

1. **«“Code” անել»** – սիրտ-թոփային վերականգնում իրականացնել:
2. **“Code”** – սիրտ-թոփային վերականգնում:
3. **“Code”** – անհետաձգելի օգնության շարժական պահարանն իր պարունակությամբ:

ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կարող ենք օտարալեզու տերմինի փոխարեն օգտագործել հայերեն բառացի թարգմանած եզրույթը, կամ՝ ներկայացման շարադրանքն ավելի հարմար և բարեհունչ դարձնելու նպատակով մեր Կենտրոնի բժիշկների ու բուժքույրերի համար միանգամայն հասկանալի և ընդունելի «Code-պահարան»-ը, կամ պարզապես՝ «Code»-ը :

ԱՅՍ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

- Սահմանել՝ ինչից է բացկացած և ինչ է պարունակում «Code-պահարանը»
- Սովորել՝ ինչպես համալրել «Code-պահարանը» մեր Կենտրոնում ընդունված կլիինիկական աշխատանքի պահանջներին համապատասխան
- Հստակեցնել բուժֆրոջ դերը «Code-պահարանի» համալրվածության ստուգման գործընթացում

ՅԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

- «Code-պահարանը»
- «Code-պահարանի» ստեղծման պատմությունը
- «Code-պահարանի» վերաբերյալ մշակված ֆադաֆականությունը
- «Code-պահարանի» տեղադրումը, համալրվածությունը և նախապատ-րաստումը օգտագործման համար



2790


ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄԸ

- «Code-պահարանը» պետք է գտնվի հետա-
հասանելի տարածքում, այն է՝ հիվանդասրահի կամ
բաժանմունքի կենտրոնական մասում:



ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Բժիշկ Հ.Ստեֆենսոնը (նկարում՝ աջից) 1950 թվականին Նյու-Յորքի “Bellevue Hospital Center”-ում առաջին անգամ ցուցադրեց իր կողմից պատրաստված սրտային “crash cart”-ի փորձնական մոդելը:



ՖՈՒԼԿՑԻԱԼ

- «Code» – պահարանը շարժական կայան է՝ բուժաստատության ներսում մարդու կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակներում անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցողներին կենսականորեն անհրաժեշտ գործողություններ իրականացնելու նպատակով: Մոքիլ Լինելը գգալի առավելությունն է՝ բուժումը արագորեն տեղ հասցնելու համար:

ՀԱՄԱԼՐԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

- **«Code»** – պահարանում դեղամիջոցների, պարագաների, գործիքների դասավորվածությունը պետք է տվյալ բժշկական հաստատության համար ստանդարտացված լինի, այսինքն՝ ողջ տարածքում առկա բոլոր **«Code»** – պահարանները պետք է ունենան միանման դասավորվածություն և համալրում:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. «Code» – պահարանը ավագ/պատասխանատու բուժքրոջ կողմից յուրաքանչյուր հերթափոխին պետք է ստուգվի, իսկ ստուգման արդյունքը գրանցվի համապատասխան մատյանում:
2. Ստանդարտացումը պետք է պահպանվի:
3. Դեֆիբրիլյատորը պետք է սխտեմատիկորեն կամ ըստ կարիքի ստուգվի բիոինժեներական ծառայության աշխատակիցների կողմից:
4. «Code» – պահարանի բաղադրիչները ամիսը մեկ անգամ պետք է ստուգվեն պիտանելիության ժամկետների հետման նպատակով:
5. «Code» – պահարանի պարունակության յուրաքանչյուր բաղադրիչը պետք է հեշտությամբ հանվի՝ առանց ընդհանուր դասավորվածությունը խախտելու:

ԴԱՍԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

«ՆՈՒՔ-ՄԱՐԱՇ» ԲԿ-ում
ընդունված ձևով

Պահարանի վրա
դրվող սարքեր,
գործիքներ,
պարագաներ



Դեֆիբրիլյատոր՝ արտաֆին թիակներով

հատ 1

Էլեկտրահաղորդիչ գել

Փլակոն 1

Էլեկտրահաղորդիչ լաթ

փաթեթ 2

Լարինգոսկոպ մեծահասակի շեղբերով

հավաքածու 1

Լարինգոսկոպ մանկական շեղբերով

հավաքածու 1

McCoy-ի նկուն շեղբեր՝ տարբեր

հավաքածու 1



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



ԴԵՖԻԲՐԻԼՅԱՑԻԱ



Փորոքային հաճախասարտություն



ԱՄԲՈՒ - Ի ՊԱՐԿ

AMBU – AIRWAY-MASK-BAG UNIT

«Շնչուղիներ – դիմակ – պարկ միավոր»





ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՔ-ՄԱՆԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Առաջին դարակ	Adrenaline 0,18% 1ml	սրվակ 20
	Atropine 0,1% 1ml	սրվակ 20
	Calcium Chloride 10% 5ml	սրվակ 20
	Gelofusin 500ml	ժիլ 2
	Lidocaine 2% 20ml	ժիլ 2
	Na bicarbonate 8,4% 20ml	ժիլ 5
	NaCl 0,9% 500ml	փաթեթ 2
	Մարկեր ջրակայուն	հատ 2

ՉՍԻՆՏՈՒՄՆԵՐ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ՍԻՏՈՒՄՆԵՐ ԵՐԱՆՑՈՒՄԻ ՍԵՐՎԻՍՆԵՐ

ԲԵՐԱՆ-ԸՄՊԱՆԱՆՅԻՆ ՕԴԱՄՈՒՂՆԵՐ

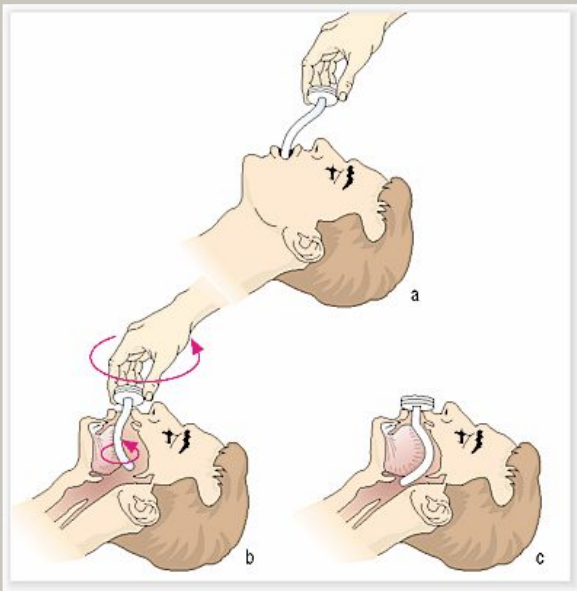



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՐԱՎՄԱՏԻԿ ԱՍԵՂՔԻ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Զորքորդ դարակ	Զեռնոց ստերիլ՝ 6; 6,5; 7; 7,5 (գույգ)	ական-2
	Զեռնոց ոչ ստերիլ	հատ 20
	Կաշուն սպեղանի մետաֆայա	հատ 1
	«Կաշուն սպեղանի «Tegaderm	փաթեթ 1
	Վիրաբուժական ատրավմատիկ ասեղ-թել	փաթեթ 4
	Բետադինի խծուծներ	հատ 100
	Թանգիֆե անձեռոցիկ ստերիլ	հատ 30
	Բետադին 10% 200մլ	շիշ 1
	Վիրաբուժական դանակ ստերիլ #10	հատ 4
	Մկրատ	հատ 1
	Ասեղբոնիչ	հատ 1
	ԷՍԽ մարսկոցով և լրացուցիչ մարսկոց	ական-1

ՉՍԹՕՐՕՐԵՔԷ սԴՍàôÂÚՉՍ ԽՃÄ²ÎՉՍ ä²Ծ²ծ²Ս

ՆԵՐՇՆԶԱՓՈՂԱՅԻՆ ԽՈՂՈԿԱԿ




Զայնալարերի առաջարկվող մակարդակի նիշը

Խողովակին նսված ներքին սրամագիծը՝ միլիմետրերով


Վերին կտրիչներից հասված խորության նիշերը՝ սանտիմետրերով

ՆԵՐՇՆՁԱՓՈՂԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԸ ՇՆՁԱՓՈՂՈՒՄ



ՆԵՐՇՆՉԱՓՈՂԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ

- Ներշնչափողային խողովակը ապահովում է օդի անցումը ստորին շնչուղիներով դեպի թոփեր և թոփերից դեպի դուրս՝ այսպիսով նպաստում օդափոխությանը:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՅՑԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԵՆՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Հինգերորդ դարակ	Ներբնչափողային խողովակ՝ 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3	ական-1
	Ստիլեո-ուղղորդիչ՝ մեծ, միջին, փոքր չափսերի	ական-1
	Ամբու>>-ի պարկ՝ մեծահասակի, մանկական>>	ական-1
	Վենտիլյացիոն դիմակ՝ մեծ, միջին, փոքր, նորածնային	ական-1
	Արտածման կաթետր շնչափողի՝ F14, F10, F8	ական-1
	Արտածման կաթետր բերանի՝ մեծ, փոքր	ական-1
	Օդամուղ խողովակ բերանի՝ մեծ, միջին, փոքր	ական-1
	Բերանլայնիչ	հատ 2
	Հարինգեալ դիմակ՝ ##3, 4, 5	ական-1

ՉՄԹՐՕՄԵՔԵ ՎԴԱՌՈՒՄԻ ԻՃԱՅԻՄ ՁԵՃՉՄ


Հ.ԳԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ



Շնչափողային արտածիչներ



Բերանի արտածիչ



Ստիլետ-ուղղորդիչ




Բերանլայնիչներ



Լարինգեալ դիֆակներ



ԴԺԿԱՐ Է ՈՒՍՍԱՆ ՄԵՉ,



ՉԵՃՏ Է ՄԱՐՏԻ ԴԱՇՏՈՒՄ