

ПРОИЗВОДСТВО
ОДНОРАЗОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
В НИЗКОЧАСТОТНОЙ
ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ






4TO 3TO

Это ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, которое имеет

неп<mark>осредственный</mark> к<mark>онтакт с кожей</mark> (поверхностный) или полостью (по<mark>лостной)</mark> паци<mark>ента и равномер</mark>но распределяет ток, поступающий от

ои<mark>зиотерапевтического апп</mark>арата.



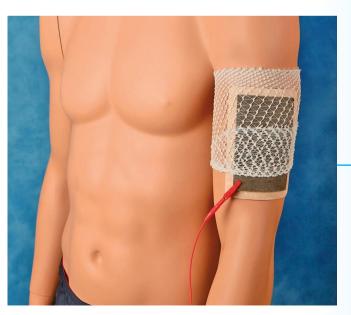




ИЗ ЧЕГО

Электрод состоит из двух слоёв:

- электропроводящего материала, который равномерно распределяет ток по всей поверхности
- электропроводную бумагу
- углеродную нить

В качестве материала для гидрофильной прокладки применяют:

- хлопок (вата)
- специализированная бумага
- Для хорошего контакта с кожей (полостью) пациента электрод должен быть хорошо смочен (вода, физраствор, лекарственный раствор).

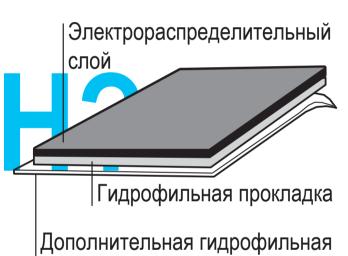

^Iпрокладка




KAK

Электрод подключается с помощью токоподводящего кабеля

Токоподводящие кабели — это электрические провода с контактами на концах, которые могут соединять физиотерапевтический аппарат с электродами. Как правило, такие кабели являются частью комплектации аппарата и выпускаются его производителем. Кабели ООО «ИНИСС-мед» являются изделиями медицинского назначения и представляют собой универсальное средство соединения. Широкий ассортимент выпускаемых кабелей, позволяет осуществить соединение электродов любых мировых производителей с любыми отечественными и многими зарубежными аппаратами. Мы предлагаем покупателям готовые решения, а в случае необходимости адаптируем наши кабели под любой аппарат.

DODUBLINE K OBEKTRODAN

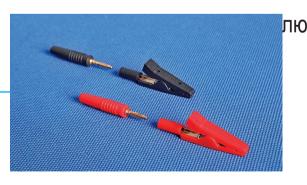



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АППАРАТАМ

Под каждый аппарат подобран соответствующий штекер



производим 2 Виды

- _ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
- _ ПОЛОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
- АДГЕЗИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ



ПОВЕРХНОСТНЫЕ

Физистеропертические электроды однократного применения продназначены для прогеденть любых видов низкочастотных электротерапевтических процедур:

- постоянными низкочастотными токами в широко распространенных методах гальванизации и лекарственного электрофореза
- всеми видами импульсных токов


Производятся ДВУХ ТИПОВ:

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ










РАЗНОФОРМАТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ













ПОЛОСТНЫЕ

Физиотерапевтические электроды однократного применения продназначены для про еден ия любых видов низкочастотных гругоров ере тев ти тести гругоров:

- постоянными низкочастотными токами в широко распространенных методах гальванизации и лекарственного электрофореза
- всеми видами импульсных токов

Производятся ТРЁХ ТИПОВ:

ДЕСНЕВОЙ ЭЛЕКТРОД

РЕКТАЛЬНО-ВАГИНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД

ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ-ЭНДАУРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД



- ПОЛОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

ДЕСНЕВОЙ ЭЛЕКТРОД

Электрод предназначен для проведения всех видов низкочастотных электротерапевтических процедур в полости рта. Производится на основе бумаги.

Электрод имеет трёхслойную структуру:


- гидрофильный компонент (белого цвета)
- электропроводный материал (серого цвета)наружный токоизолирующий слой (разноцветный)

Электрод упакован в герметичную упаковку по 10 шт. и стерилизован.

Электрод обладает высокой электропроводностью и в смоченном состоянии хорошо прилегает к слизистой десны пациента, что обеспечивает комфортность при проведении процедуры.

При необходимости, размер электрода может быть изменен при помощи ножниц.

Для подключения электрода к аппарату используется 1-х контактный или 2-х контактный

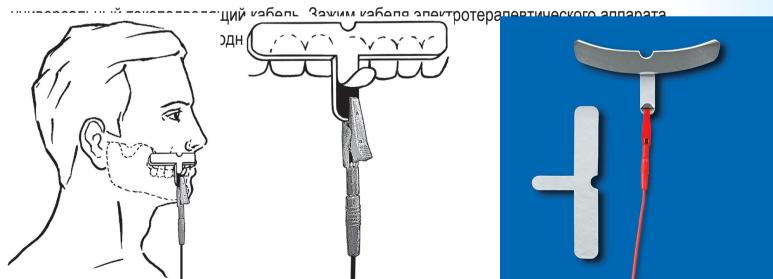



полостные


РЕКТАЛЬНО-ВАГИНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД

электрод предназначен для проведения всех видов низкочастотных электротерапевтических процедур в ректальной или вагинальной полостях.

Электрод выполнен на основе ватного тампона, во внутренней части которого по всей длине проходит электропроводный шнур, обеспечивающий равномерное распределение электрического тока. Внутри электрода проходит эластичная трубка для смачивания тампона лекарственным препаратом с помощью шприца. Электрод размещен в аппликаторе, представляющего из себя систему введения электрода в полость.

Электрод упакован в герметичную упаковку и стерилизован.



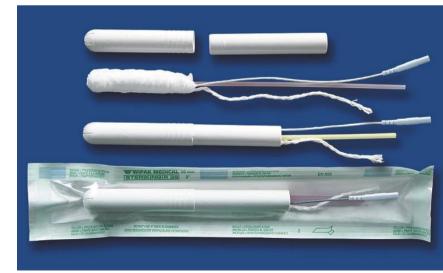




- ПОЛОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ-ЭНДАУРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД

Электрод предназначен для проведения всех видов низкочастотных электротерапевтических процедур в носовой или ушной полостях.

Электрод выполнен из ватного тампона, во внутренней части которого по всей длине проходит электропроводный шнур, обеспечивающий равномерное распределение электрического тока.

Электрод упакован в герметичную упаковку и стерилизован.









Ватный тампон

| Изоляция

Токоподводный шнур

Место подключения кабеля



АДГЕЗИВНЫЕ

Адгезивные (самоклеящиеся) электроды предназначены для проведения электроим пульстой тератии (электростимуляции) мышц и изготовлены на основе электропроводной бумаги, которая равномерно распределяет ток по всей поверхности электрода и покрыта высококачественным адгезивным электропроводным гелем (высокое качество геля обеспечивает хороший контакт с любыми типами кожи пациента и позволяет избежать процедуры эпиляции при снятии электродов после процедуры). Контакт электрода с кабелем осуществляется при помощи зажима.

Электрод имеет четырёхслойную структуру:

- наружный токоизолирующий слой из нетканого материала (разноцветный)
- электропроводная бумага (серого цвета)
- адгезивный электропроводный гель плёнка для хранения электрода











ГДЕ

ООО «ИНИСС-мед» г. Санкт-Петербург, ул. Громова, дом 4, БЦ «Громов»

тел./факс: +7 (812) 313-76-68, моб.: +7 (911) 218-44-51

e-mail: mail@iniss.ru

<u>www.иниссмед.рф</u>







