



НИЗКОЧАСТОТНАЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ


ПРОИЗВОДСТВО ОДНОРАЗОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В НИЗКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ ▶▶



ЭЛЕКТРОД В НИЗКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ ЧТО ЭТО

Это **изделие медицинского назначения**, которое имеет непосредственный контакт с кожей (поверхностный) или полостью (полостной) пациента и равномерно распределяет ток, поступающий от физиотерапевтического аппарата.

ТАКОЕ?

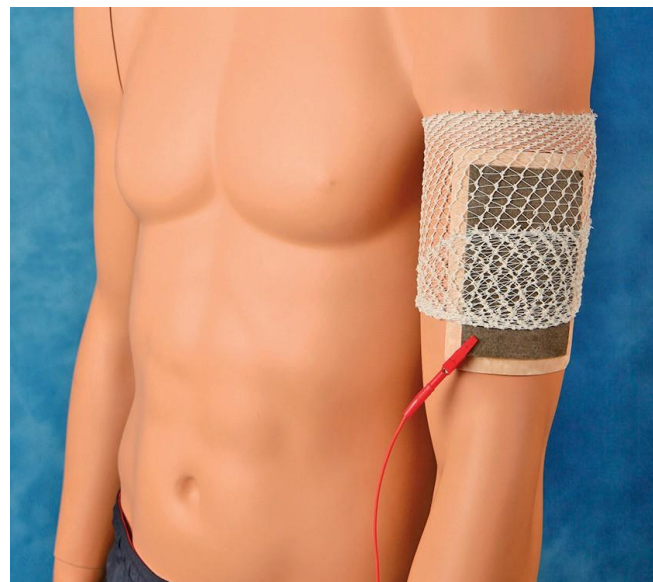

ЭЛЕКТРОД В НИЗКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ

ИЗ ЧЕГО

Электрод состоит из двух слоёв:

- электропроводящего материала, который равномерно распределяет ток по всей поверхности
- гидрофильной прокладки, которая может содержать лекарственный препарат, впитывает продукты электролиза и увлажняет зону, снижая сопротивление кожи и уменьшая риск ожога.

В качестве электропроводящего материала применяют:

- электропроводную бумагу
- углеродную нить


В качестве материала для гидрофильной прокладки применяют:

- хлопок (вата)
- специализированная бумага



Для хорошего контакта с кожей (полостью) пациента электрод должен быть хорошо смочен (вода, физраствор, лекарственный раствор).

Электрораспределительный слой

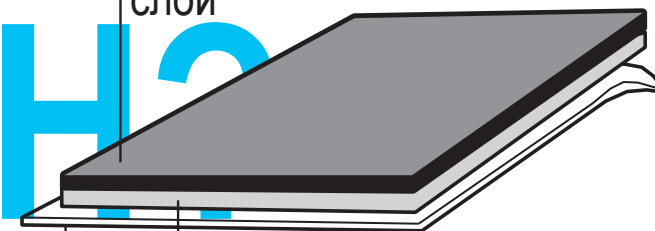

Гидрофильная прокладка

Дополнительная гидрофильная прокладка

ЭЛЕКТРОД В НИЗКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ


КАК

ПОДКЛЮЧИТЬ?


Электрод подключается с помощью токоподводящего кабеля

Токоподводящие кабели – это электрические провода с контактами на концах, которые могут соединять физиотерапевтический аппарат с электродами. Как правило, такие кабели являются частью комплектации аппарата и выпускаются его производителем. Кабели ООО «ИНИСС-мед» являются изделиями медицинского назначения и представляют собой универсальное средство соединения. Широкий ассортимент выпускаемых кабелей, позволяет осуществить соединение электродов любых мировых производителей с любыми отечественными и многими зарубежными аппаратами. Мы предлагаем покупателям готовые решения, а в случае необходимости адаптируем наши кабели под любой аппарат.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОДАМ

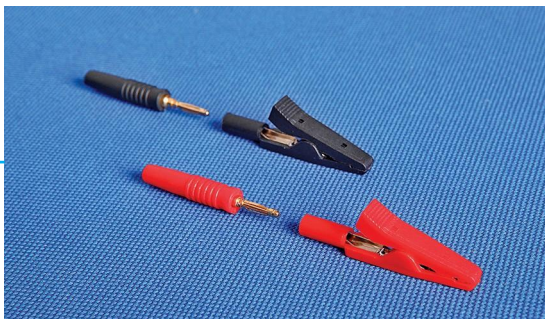

лю

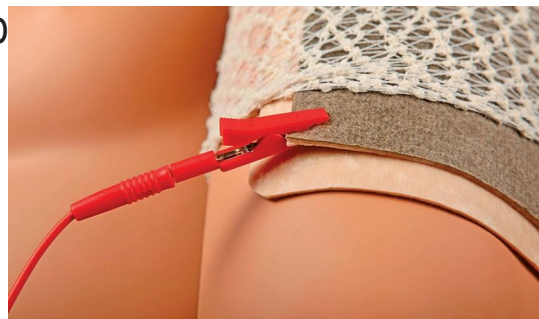

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АППАРАТАМ

Под каждый аппарат подобран соответствующий штекер

ЭЛЕКТРОД В НИЗКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ

КАКИЕ ПРОИЗВОДИМ



ВИДЫ

- ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
- ПОЛОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
- АДГЕЗИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ





■ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Физиотерапевтические электроды однократного применения предназначены для проведения любых видов низкочастотных электротерапевтических процедур:


- постоянными низкочастотными токами в широко распространенных методах гальванизации и лекарственного электрофореза
- всеми видами импульсных токов

Производятся ДВУХ ТИПОВ:

▶ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

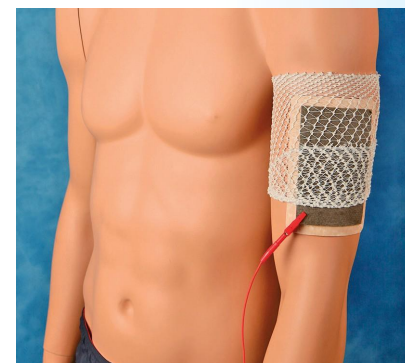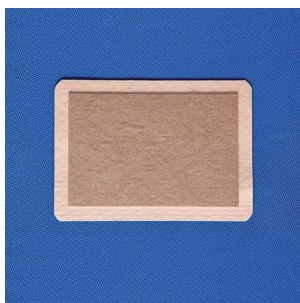

▶ РАЗНОФОРМАТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

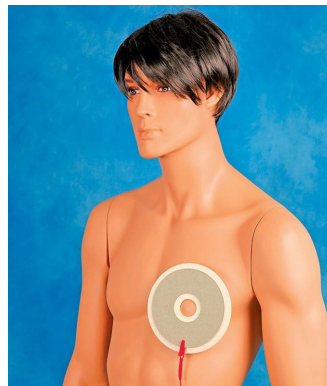

■ ПОЛОСТНЫЕ

Физиотерапевтические электроды однократного применения предназначены для проведения любых видов низкочастотных электрофизиотерапевтических процедур:

- постоянными низкочастотными токами в широко распространенных методах гальванизации и лекарственного электрофореза
- всеми видами импульсных токов

Производятся ТРЁХ ТИПОВ:

ДЕСНЕВОЙ ЭЛЕКТРОД

РЕКТАЛЬНО-ВАГИНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД

ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ-ЭНДАУРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД

ПОЛОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

▶ ДЕСНЕВОЙ ЭЛЕКТРОД

Электрод предназначен для проведения всех видов низкочастотных электротерапевтических процедур в полости рта. Производится на основе бумаги.

Электрод имеет трёхслойную структуру:

- гидрофильный компонент (белого цвета)
- электропроводный материал (серого цвета)
- наружный токоизолирующий слой (разноцветный)


Электрод упакован в герметичную упаковку по 10 шт. и стерилизован.

Электрод обладает высокой электропроводностью и в смоченном состоянии хорошо прилегает к слизистой десны пациента, что обеспечивает комфортность при проведении процедуры.

При необходимости, размер электрода может быть изменен при помощи ножниц.

Для подключения электрода к аппарату используется 1-х контактный или 2-х контактный

.....ий кабель. Зажим кабеля электротерапевтического аппарата

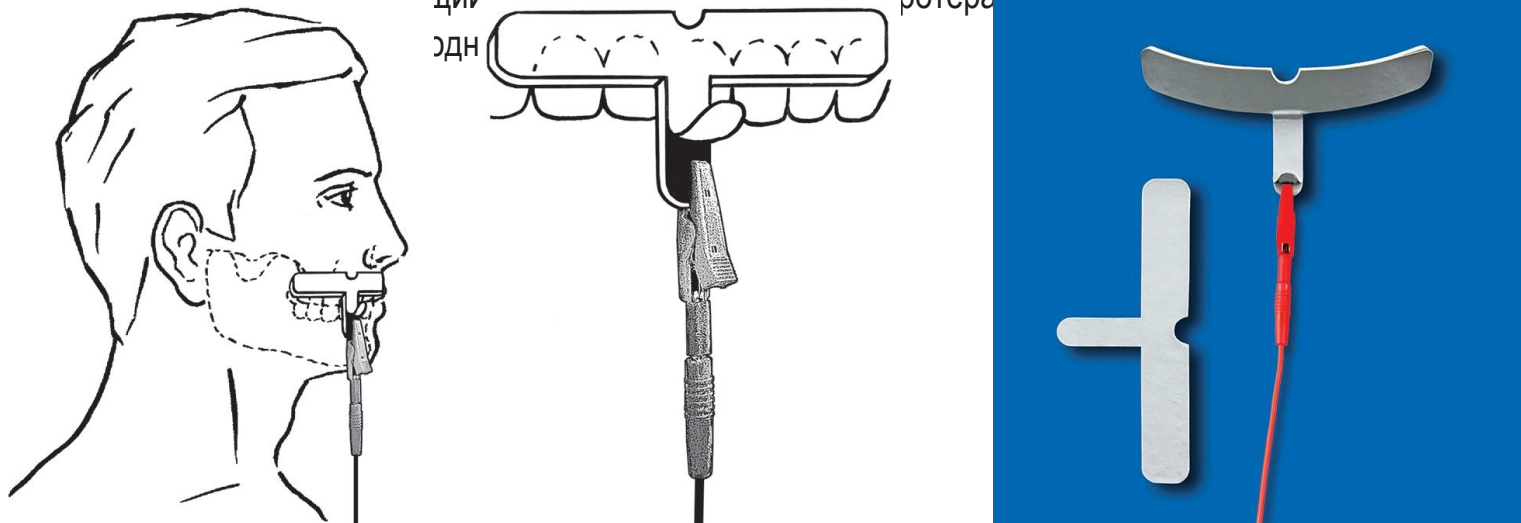

■ ПОЛОСТНЫЕ

▶ РЕКТАЛЬНО-ВАГИНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД


ЭЛЕКТРОДЫ

Электрод предназначен для проведения всех видов низкочастотных электротерапевтических процедур в ректальной или вагинальной полостях.

Электрод выполнен на основе ватного тампона, во внутренней части которого по всей длине проходит электропроводный шнур, обеспечивающий равномерное распределение электрического тока. Внутри электрода проходит эластичная трубка для смачивания тампона лекарственным препаратом с помощью шприца.

Электрод размещен в аппликаторе, представляющего из себя систему введения электрода в полость.

Электрод упакован в герметичную упаковку и стерилизован.

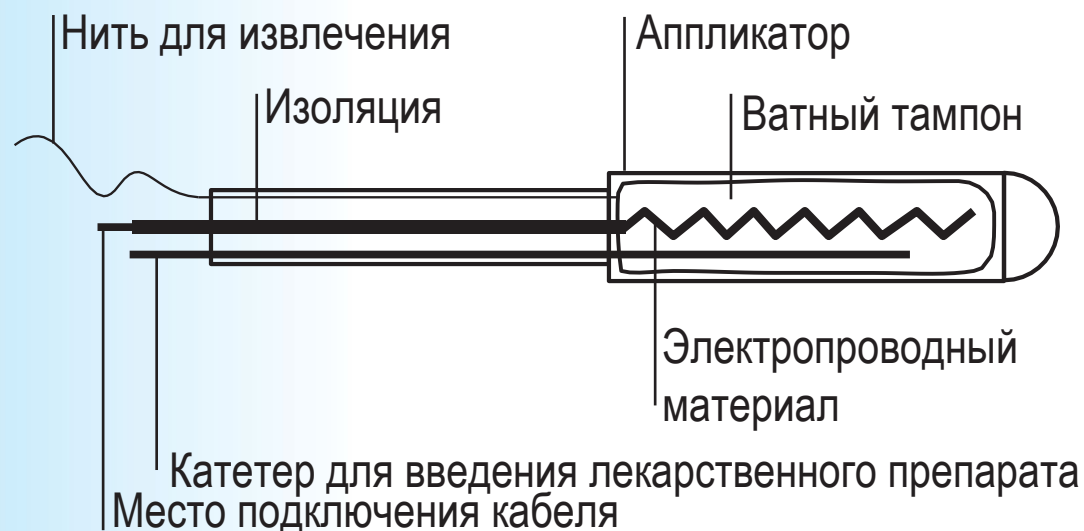



ПОЛОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ-ЭНДАУРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД

Электрод предназначен для проведения всех видов низкочастотных электротерапевтических процедур в носовой или ушной полостях.

Электрод выполнен из ватного тампона, во внутренней части которого по всей длине проходит электропроводный шнур, обеспечивающий равномерное распределение электрического тока.

Электрод упакован в герметичную упаковку и стерилизован.



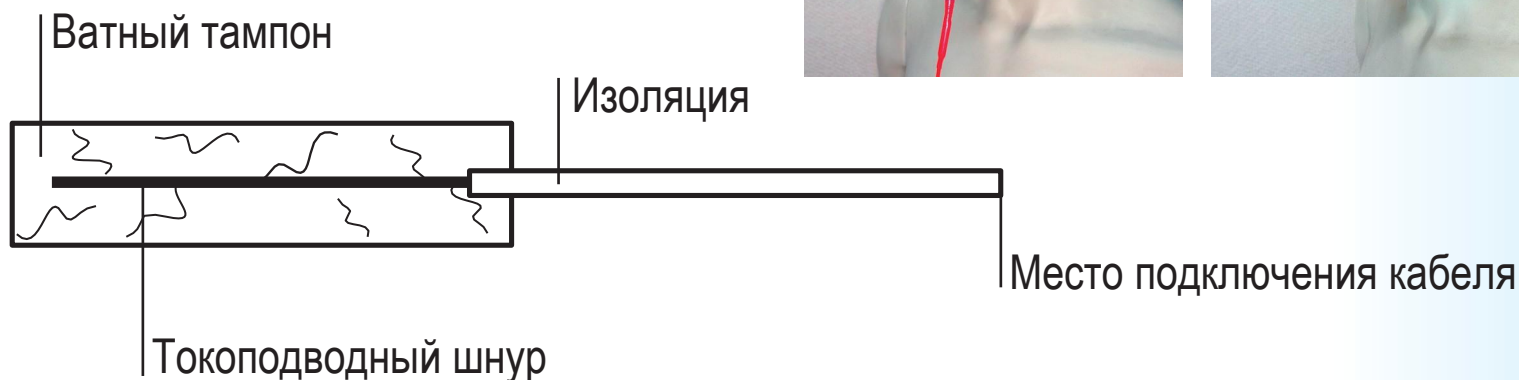
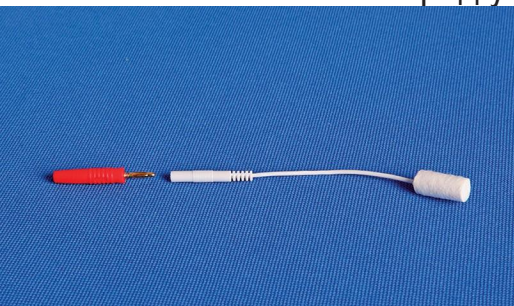


■ АДГЕЗИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Адгезивные (самоклеющиеся) электроды предназначены для проведения электроимпульсной терапии (электростимуляции) мышц и изготовлены на основе электропроводной бумаги, которая равномерно распределяет ток по всей поверхности электрода и покрыта высококачественным адгезивным электропроводным гелем (высокое качество геля обеспечивает хороший контакт с любыми типами кожи пациента и позволяет избежать процедуры эпиляции при снятии электродов после процедуры). Контакт электрода с кабелем осуществляется при помощи зажима.

- **Электрод имеет четырёхслойную структуру:**
- наружный токоизолирующий слой из нетканого материала (разноцветный)
- электропроводная бумага (серого цвета)
- адгезивный электропроводный гель
- плёнка для хранения электрода

Адгезивные электроды не подлежат никаким видам санитарной обработки

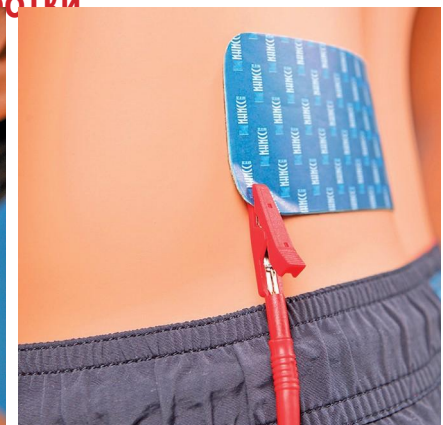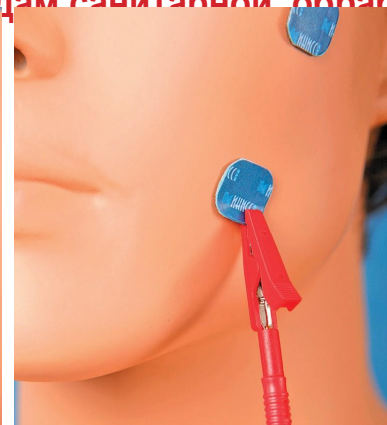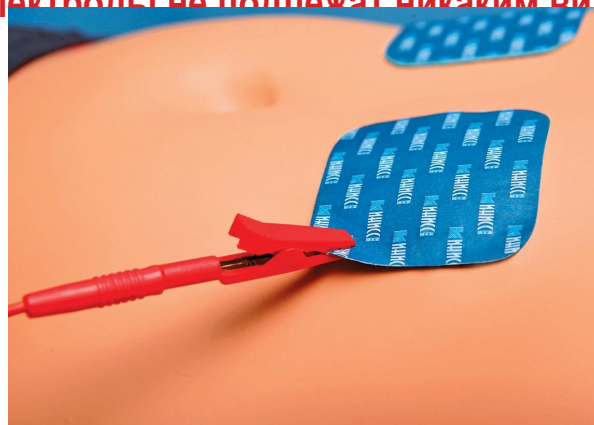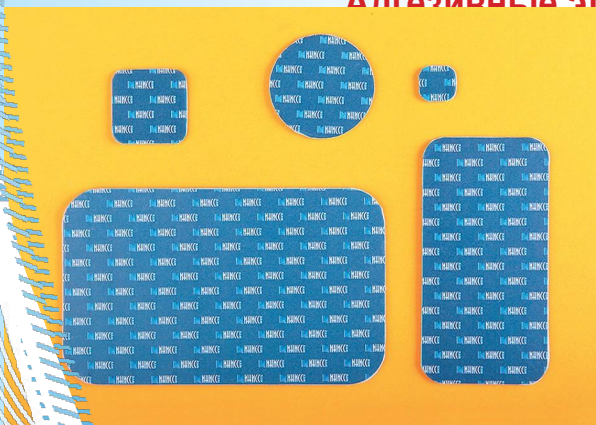

ЭЛЕКТРОД В НИЗКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ

ГДЕ

КУПИТЬ?

ООО «ИНИСС-мед»

г. Санкт-Петербург, ул. Громова, дом 4, БЦ «Громов»

тел./факс: +7 (812) 313-76-68, моб.: +7 (911) 218-44-51

e-mail: mail@iniss.ru

www.иниссмед.рф

